

全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議 特材部分第60次（111年9月）會議紀錄

時間：111年9月15日（星期四）上午9時30分

地點：健保署18樓禮堂

主席：林教授啓禎

紀錄：張淑宜

出席代表：（依姓名筆畫數排列，敬稱略）

朱益宏	張淑慧	趙素貞(干文男代理)
吳國治(請假)	連哲震	劉芝蓮
林亮光	郭萬祐(請假)	劉碧珠
林敏華(徐珮軒代理)	陳石池(請假)	蔡欣原
林聖哲(請假)	陳志強	戴文杰(請假)
胡峰賓	陳淑華	謝立韋(請假)
徐紹勛	陳瑞瑛	簡俊仁
馬辛一	童瑞龍	藍毅生
張文龍(楊玉琦代理)	黃莉茵	
張忠毅	葉宗義(羅木才代理)	

出席專家及學會代表：（敬稱略）

社團法人台灣神經外科醫學會

楊士弘

台灣兒童神經外科醫學會

周聖哲

列席人員：（敬稱略）

藥物提供者團體代表：何國梁、陳堯濱、黃柏勳

病友團體代表：柯怡謀、蕭長生

全民健康保險會：邱臻麗

衛生福利部社會保險司：梁淑政、蘇芸蒂

衛生福利部中央健康保險署：蔡淑鈴、黃育文、戴雪詠、張惠萍、張淑雅、
林其昌、簡淑蓮、黃滢云、朱秋琴、袁美霞、
裴倩倩、江錦欣、李姿玫、楊佩綺、黃昭菡、
鄭碧恩、張淑宜、蔡宛君、丁安安、蔡佳倫、

王宗曦、楊先斌

財團法人醫藥品查驗中心：侯雨辰

壹、主席致詞（略）

貳、請參閱並確認上次會議紀錄

決議：洽悉。

參、會議決議辦理情形追蹤

決議：本次會議追蹤案件共計11項，序號4、6、7、8、10解除列管，序號1、2、3、5、9、11繼續列管，其中序號1附帶決議涉及相關學會向健保署提出增修診療項目之建議，健保署迄今尚未收到學協會提案，於收到學協會向健保署提出建議前，繼續列管。

肆、討論事項：

第1案：有關現行保險對象自付差額類別之特殊材料「腦脊髓液分流系統」計15品項納入健保全額給付案。

一、說明：

- (一)詳附錄會議資料討論案第1案之報告內容。
- (二)本案特材用於水腦症病患，相較於現行健保全額給付之固定壓力式腦室腹腔引流組，本案特材可調節壓力以避免過度引流，改善病人預後。
- (三)與會專家及代表表示，本案特材可從外面調整壓力，減少手術次數，於兒童頭顱成長過程，使用本案特材可減少醫療費用及併發症，更具有效性及安全性。
- (四)在考量臨床使用、市場占率、與廠商溝通結果及健保可負擔之財務下，建議優先將「調控式腦室腹腔引流系統-流速控制型或可調式壓力閥(不具抗虹吸功能)」類別納入健保全額給付，解決健保全額給付之臨床缺口。另2類別(具抗虹吸功能及附加體位式重力閥門)建議暫維持自付差額，後續再觀察臨床使用情形。
- (五)年使用量以替代健保品95%來計算，高推估為2,871組，與會專家表

示，另2類自付差額品項主要使用於活動度高之病人，臨床上亦會建議病人最適合的引流管，爰較少會有轉移使用本次納入健保全額給付類別之可能，惟與會代表表示，仍無法排除本次納入健保全額給付類別替代其他2類自付差額品項，故以109年該2類別申報量之5%計算轉移使用量。

二、決議：

(一)本案特材具有臨床需要性，同意先將市占率最高的「調控式腦室腹腔引流系統-流速控制型或可調式壓力閥(不具抗虹吸功能)」類別納入健保全額給付。

(二)支付點數：以53,000點暫予支付。

(三)給付規定：如附件1，併同修正健保全額給付固定壓力式腦室腹腔引流組之給付規定。

(四)預估年使用量：2,916組。

(五)財務預估：約增加1.33億點。

三、附帶決議：考量111年迄至7月本會議新功能特材預算約6.61億元，尚餘1.03億，本案不足預算(約0.3億)得以112年新醫療科技預算支應。

第2案：有關耀瑞股份有限公司建議調高既有功能類別特材「“史密斯”儲液卡匣+“史密斯”延長管(含0.2 micron 過濾器)」之支付點數案。

一、說明：

(一)詳附錄會議資料討論案第2案之報告內容。

(二)與會專家表示，本案特材用於居家靜脈注射罕見疾病原發性肺動脈高血壓症患者之最後一線用藥，需24小時不間斷將藥物注入靜脈血管中。考量國際原物料成本上漲、製造成本增加，使得原健保支付點數不敷成本，建議調高支付點數。

二、決議：

(一)本案為罕見疾病原發性肺動脈高血壓症之必要醫材，具臨床需求性，同意調高支付點數。

(二)支付點數：依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第53-2條規定，經校正廠商成本，除以浮動點值(0.8823)再加計15%，以1,500點暫予

支付。

(三)給付規定：無。

(四)預估年使用量：1,260組。

(五)財務預估：約增加94.5萬點。考量111年新功能特材預算已全數用罄，爰本案預計生效日為112年1月1日，以112年新醫療科技預算支應。

伍、報告事項：

第1案：全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告共162項：(1)新增既有功能類別特材品項120項/第1-1~1-14頁；項次1~120。(2)新增既有功能類別特材自付差額品項12項/第1-15~1-16頁；項次121~132。(3)新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號30項/第1-17~1-21頁；項次133~162。

一、說明：詳附錄會議資料報告案第1案之報告內容。

二、決議：洽悉。

第2案：全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之初核情形報告共134項：

(1)醫療器材許可證註銷及刪除品項133項/第2-1~2-15頁；項次1~133。

(2)核價類別變更及價格調整品項1項/第2-16頁；項次134。

一、說明：詳附錄會議資料報告案第2案之報告內容。

二、決議：洽悉。

第3案：111年收載新功能類別特材申報情形及預算支用結果報告案。

一、說明：詳附錄會議資料報告案第3案之報告內容。

二、決議：洽悉。

第4案：108年至110年連續3年特約院所無申報量特材品項之健保給付案。

一、說明：詳附錄會議資料報告案第4案之報告內容。

二、決議：108年至110年連續3年特約院所無申報量之特材品項計601項(112家廠商)。經本次會議確認同意刪除品項計370項，確認保留品項計231項。

第5案：有關修訂健保給付特材「經導管置換肺動脈瓣膜套組」給付規定(B102-9)案。

- 一、說明：詳附錄會議資料報告案第5案之報告內容。
- 二、決議：同意比照 TAVI、無導線心律調節器，應完成個案登錄系統，個案完成植入手術後需三十天內及第十二個月內於登錄系統登錄追蹤狀況，未如期登錄，核刪本項申請之特材費用(詳附件2)。

第6案：有關英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司建議將用於治療胸主動脈瘤之「“漫孚漢”多層血流調節主動脈支架系統」及治療周邊血管之「“漫孚漢”多層血流調節周邊支架系統」計2項納入健保給付案。

- 一、說明：詳附錄會議資料報告案第6案之報告內容。
- 二、決議：本案特材目前文獻報告病例數不多且追蹤時間短，缺乏長期實證資料，臨床效果不明確，故暫不建議納入健保給付，後續依全民健保尚未納入給付特材管理作業要點辦理。

陸、臨時動議：

第1案：有關報告案第1案全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告共162項：(1)新增既有功能類別特材品項120項/第1-1~1-14頁；項次1~120。(2)新增既有功能類別特材自付差額品項12項/第1-15~1-16頁；項次121~132。(3)新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號30項/第1-17~1-21頁；項次133~162。及報告案第2案全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之初核情形報告共134項：(1)醫療器材許可證註銷及刪除品項133項/第2-1~2-15頁；項次1~133。(2)核價類別變更及價格調整品項1項/第2-16頁；項次134。建議健保署於下次會議無需舉例說明。

決議：建請健保署於下次召開本會議開始，僅需報告各類別初核情形，無需舉例說明。

柒、散會（上午11時37分）

全民健康保險特殊材料給付規定修正對照表
給付規定分類碼：I203-11
(自□年□月□日生效)

附件1

修正後給付規定	原給付規定	說明
<p>自111.O.O起生效</p> <p>一、<u>易發生 overdrainage 病人：如 normal pressure hydrocephalus, post-hemorrhagic hydrocephalus, tumor associated hydrocephalus, post-traumatic hydrocephalus, post-infective hydrocephalus 等。</u></p> <p>二、<u>其他水腦症病人，接受分流手術後發生過度引流並有下列情形之一者：</u></p> <p>(一)硬腦膜下積液</p> <p>(二)硬腦膜下出血</p> <p>(三)顱內低壓（姿勢性頭痛、影像檢查顯示廣泛腦膜顯影、靜脈竇充血、腦室變小或腰椎穿刺檢查顱內壓力偏低）。</p> <p>三、<u>十八歲以下之兒童不受上開給付規定之限制。</u></p>	<p><u>腦室腹腔引流系統-具抗虹吸裝置或體位式重力閥(自111.4.1起生效)</u></p> <p><u>給付規定：限用於腦脊髓液分流手術後發生過度引流且有下列情形之一者：</u></p> <p>一、<u>硬腦膜下積液。</u></p> <p>二、<u>硬腦膜下出血。</u></p> <p>三、<u>顱內低壓(姿勢性頭痛；影像檢查顯示廣泛腦膜顯影、靜脈竇充血、腦室變小或腰椎穿刺檢查顱內壓力偏低)。</u></p> <p>四、<u>未滿七歲兒童，引流過度造成頭顱尺寸過小。</u></p>	<p>與「腦脊髓液分流系統」之給付規定併同修訂。</p>

全民健康保險特殊材料給付規定修正對照表
給付規定分類碼：B102-9
(自□年□月□日生效)

附件2

修正後給付規定	原給付規定	說明
<p>一、符合全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準診療項目 68057B「經導管肺動脈瓣膜置換術」(Transcatheter pulmonary valve implantation, TPVI)所訂之適應症、禁忌症、醫院條件及醫師資格等之相關規定。</p> <p>二、<u>完成個案登錄系統且須事前審查。</u></p> <p>三、<u>個案完成植入手術後需三十天內及第十二個月內於登錄系統登錄追蹤狀況，未如期登錄，核刪本項申請之特材費用。</u></p>	<p>一、符合全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準診療項目 68057B「經導管肺動脈瓣膜置換術」(Transcatheter pulmonary valve implantation, TPVI)所訂之適應症、禁忌症、醫院條件及醫師資格等之相關規定。</p> <p>二、須事前審查。</p>	<p>修正第二點及新增第三點。</p>

附 錄

全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議 特材部分第 60 次（111 年 9 月）會議議程

時間：111 年 9 月 15 日(星期四)上午 9 時 30 分

地點：衛生福利部中央健康保險署 18 樓禮堂

壹、主席致詞

貳、請參閱並確認上次會議紀錄(藍本卷夾)

參、會議決議辦理情形追蹤

肆、討論提案：

第 1 案：有關現行保險對象自付差額類別之特殊材料「腦脊髓液分流系統」計 15 品項納入健保全額給付案。

第 2 案：有關耀瑞股份有限公司建議調高既有功能類別特材「“史密斯”儲液卡匣+“史密斯”延長管(含 0.2 micron 過濾器)」之支付點數案。

伍、報告事項：

第 1 案：全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告共 162 項：(1)新增既有功能類別特材品項 120 項/第 1-1~1-14 頁；項次 1~120。(2)新增既有功能類別特材自付差額品項 12 項/第 1-15~1-16 頁；項次 121~132。(3)新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號 30 項/第 1-17~1-21 頁；項次 133~162。

第 2 案：全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之初核情形報告共 134 項：
(1)醫療器材許可證註銷及刪除品項 133 項/第 2-1~2-15 頁；項次 1~133。
(2)核價類別變更及價格調整品項 1 項/第 2-16 頁；項次 134。

第 3 案：111 年收載新功能類別特材申報情形及預算支用結果報告案。

第 4 案：108 年至 110 年連續 3 年特約院所無申報量特材品項之健保給付案。

第 5 案：有關修訂健保給付特材「經導管置換肺動脈瓣膜套組」給付規定 (B102-9)案。

第 6 案：有關英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司建議將用於治療胸主動脈瘤之「“漫孚漢”多層血流調節主動脈支架系統」及治療周邊血管之「“漫孚漢”多層血流調節周邊支架系統」計 2 項納入健保給付案。

會議決議辦理情形追蹤

全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議(特材部分)決議辦理情形追蹤表

序號	編號	會議日期	案由	決定(結論)事項	辦理單位	辦理情形	列管	
							解除列管	繼續列管
1	10903_討2	109.03.19	有關於取代椎間盤之特材「人工椎間盤(Artificial Disc)」共計11項，以民眾自付差額方式納入健保給付案。	附帶決議： 請相關學會盡速向健保署提出增修診療項目之建議，以符合臨床實況。	健保署醫管組	一、尚未收到學協會提案增修相關診療項目。 二、考量台灣神經外科醫學會於108年7月3日來函表示頸椎AD屬非融合脊椎手術，健保支付標準無該術式診療項目，並與中華民國骨科醫學會、台灣脊椎外科醫學會、台灣神經脊椎外科醫學會及台灣外科醫學會皆建議比照椎間盤切除術申報費用。後續程序並依新增診療項目受理作業程序提於醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議討論，建議解除列管。	V	
2	10903_討3	109.03.19	有關於穩定椎體及促進融合之「脊椎間體護架(CAGE)」共計61項，以民眾自付差額方式納入健保給付案。	決議： 一、屬「健保尚未收載置放路徑所需CAGE」或「與健保相同置放路徑，但具臨床實證佐證其fusion rate優於健保品項」，同意採「自付差額」方式納入健保給付，健保給付比例為20%。 二、屬「與健保相同置放路徑，但臨床實證及醫材仿單無法區分與健保品項之臨床效果差異」，同意暫以「既有特材」納入給付，並調整Ti CAGE回收載時之支付點數。	健保署醫審組	一、依110年11月本會議紀錄，因本案特材迄今尚未生效，且為民眾關注之重要案件，爰繼續列管。 二、查人工頸椎椎間盤(頸椎AD)自110年12月1日生效，考量脊椎間體護架(CAGE)和人工頸椎椎間盤(頸椎AD)兩者具替代性，俟頸椎AD給付滿1年後，於112年整體評估合適之CAGE收載方式。		V 例行性列管
3	10909_討1	109.09.17	有關科舉顧問股份有限公司建議將用於治療頑固癲癇之特材「"賽玻尼斯"刺激迷走神經治療系統」共3項納入健保給付案。	附帶決議： 本案特材之診療項目83102K，限醫學中心執行後申報，考量現行區域醫院、地區醫院亦有接受完整訓練之醫師資格或團隊，得執行前述手術。請健保署醫務管理組研議上開診療項目是否得放寬區域醫院、地區醫院亦可申報。	健保署醫管組	一、本案提至111年4月全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準專家諮詢會議討論，考量診療項目放寬至區域醫院及地區醫院涉及醫療服務及特材財務衝擊，推估特材費用將增加1.15億，111年皆已無預算支應，決議待爭取112年預算後再予修訂。 二、考量後續診療項目放寬涉及特材預算，依程序應另案提至本會議討論，爰建議解除列管。	V	
4	11007_討2	110.07.15	有關壯生醫療器材股份有限公司建議調整健保給付特材「"信迪思"彈性髓內釘」之支付點數案	決議： 本案特材列入111年度特材價量調查品項，暫定112年3月於共擬會議報告價量調查結果。	健保署醫審組	已列入111年度特材價量調查品項，後續另案於112年3月本會議報告調查結果，爰建議解除列管。	V	
5	11008_討1	110.08.24	有關修正「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」(簡稱藥物支付標準)第51條、第52-2條及第53-2條文案(草案)	附帶決議： 為使健保特材能「合理」訂價，請健保署邀集本會議未代表等與會代表及相關單位討論，蒐集核價意見。	健保署醫審組	刻正彙整資料。		V 例行性列管
6	11008_討5	110.08.24	有關台灣大學醫學院附設醫院建議健保給付「內視鏡自動血管夾」之功能類別特材，改以「整匣」支付案	附帶決議： 支付方式調整生效滿1年後，列入價量調查，以瞭解「內視鏡血管夾」次分類之臨床使用情形。	健保署醫審組	110/9/16公告本案特材自110/11/1生效改以整組計價，並已列入112年價量調查之類別品項，後續另案於本會議報告調查結果，爰建議解除列管。	V	

全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議(特材部分)決議辦理情形追蹤表

序號	編號	會議日期	案由	決定(結論)事項	辦理單位	辦理情形	列管	
							解除列管	繼續列管
7	11011_報9	110.11.18	有關修訂健保「壓力感應金屬導引線(FFR)(或iFR)」給付規定(A225-2)案	附帶決議： 續追蹤壓力感應金屬導引線使用情形。	健保署醫審組	一、本案給付規定修訂已公告自111年1月1日生效。 二、有關無需使用adenosine之iFR、DFR及RFR測量參數均屬健保給付範圍，前開參數互為競合關係，爰俟生效日半年後進行報告。 三、本案特材今年1至6月申報量共計981組，推估全年使用量為1,962組，與110年度申報量2,112組相比未超出，建議解除列管。	V	
8	11101_討2	111.1.20	有關健保收載「人工頸椎椎間盤」之給付規定，由「事前審查」修正為「特殊專案審查」案	附帶決議： 為追蹤本案後續執行情形，於給付規定施行6個月後進行檢討	健保署醫審組	一、本案特材給付規定修正案已於111年2月14日公告，並自同年3月1日生效。 二、本案特材今年1至6月申報量共計368顆，推估全年使用量為736顆，未超過預估年使用量1,000顆，且本案特材已納入Power BI持續監控使用量，建議解除列管。	V	
9	11103_討4	111.3.17	有關健保尚未納入給付「脊椎骨水泥」共計32項納入健保給付案	附帶決議： (一)考量本案財務預估具有不確定性，本案以HTA財務評估之相關推估預算，暫以2億框定預算，並請CDE重新推算預估使用人次。 (二)於納入給付後3個月監控追蹤臨床使用情形，於本會議提出報告，以修正預算支用情形。	健保署醫審組	本案特材自111年7月1日納入健保給付，於納入給付後3個月監控追蹤臨床使用情形，預計於111年11月本會議提出報告。		V
10	11105_討11	111.5.19	有關修訂健保給付特材「眼用染劑(白內障手術用)」給付規定(H206-2)案	決議： (一)同意修訂眼用染劑(白內障手術用)」給付規定(H206-2)如附件10，另請中華民國眼科醫學會及台灣眼科學教授學術醫學會將本次會議代表建議可以照片表列來訂給付規定意見攜回學會研參。 (二)健保署說明：未來中華民國眼科醫學會及台灣眼科學教授學術醫學會所提檢附照片標準一致性之建議，因屬臨床審查參考準則非支付標準，後續可於本保險審查注意事項作業修訂，以利審查作業。 附帶決議：請於下次本會議對本案執行情形做報告。	健保署醫審組	一、已於111年6月8日函請中華民國眼科醫學會及台灣眼科學教授學術醫學會提供過熱型白內障照片標準及說明。 二、111年6月27日及同年7月11日已分別接獲中華民國眼科醫學會及台灣眼科學教授學術醫學會函復提供過熱型白內障照片及定義說明，後續依程序辦理本保險審查注意事項作業修訂事宜，爰建議解除列管。	V	
11	11107_討3	111.7.21	有關壯生醫療器材股份有限公司建議將手術中用於切斷、切除及縫合特材「愛惜康」愛喜龍可彎式高階定位電動血管縫合器」納入健保給付再提會案。	附帶決議： 請健保署與小兒外科醫學會再確認本案給付規定中兒科手術對應之診療項目代碼。	健保署醫審組	於111年8月9日發文請小兒外科醫學會提供本案給付規定中對應之診療項目，迄今尚未接獲學會回復意見。		V

討論案 1

有關現行保險對象自付差額類別之特殊材料「腦脊髓液分流系統」計 15 品項納入健保全額給付案。

腦脊髓液分流系統之特材

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第60次(111年9月)會議
111年9月15日

提案摘要(1)

說明：有關現行保險對象自付差額類別之特殊材料「腦脊髓液分流系統」計15品項納入健保全額給付案。

依據：按111年5月份特材專家諮詢會議結論辦理。

說明：

1. 本案特材適用於水腦症病患，於104年6月1日納入健保，屬保險對象自付差額特材。
2. 經統計本案特材之申報量，其自付差額占率於105年及106年分別已達74%及76%，107年至109年達八成以上，已為臨床常規普遍使用，且為健保會密切關注及追蹤要優先研議納入健保全額給付之項目，爰重啟研議。

提案摘要(2)

3. 經111年5月份特殊材料專家諮詢會議，結論：

- 1) 與會專家表示，本案特材較健保全額給付固定壓力式腦室腹腔引流組具有優點，可從外面調整壓力及可抵抗虹吸、重力造成的水腦問題，改善病人預後，減少併發症及手術等。
- 2) 腦炎病患在治療上需使用本案特材，特別是Covid-19導致兒童腦炎情形。另在兒童頭顱成長過程，若治療時未使用可調壓的本案特材，可能造成頭位過小或腦室過小，產生不可逆的併發症。

建議：考量本案特材已為臨床常規使用，且可改善病人預後，特別是兒童更具有效性及安全性，與會專家一致建議全額納入健保給付。

3

本案品項-類別(1)

□ 調控式腦室腹腔引流系統-流速控制型或可調式壓力閥(不具抗虹吸功能)

廠商	項次	品名	許可證字號	給付上限
博暘	1	“英特佳”內植用腦積水引流管組	衛署醫器輸字第012626號	7,127點
美敦力	2	“美敦力”史卓塔腦脊髓液可調式壓力閥-NSC	衛署醫器輸字第023018號	
	3	“美敦力”史卓塔腦脊髓液引流組-STRATA NSC控制閥	衛署醫器輸字第014308號	
科舉	4	“美的思”柯特曼霍金斯引流閥系統-可調式引流閥	衛署醫器輸字第007778號	
	5	“柯特曼”霍金斯引流閥系統-霍金斯可調式引流閥	衛署醫器輸字第012548號	
	6	“美的思”柯特曼史特斯引流閥-附配件及抗菌導管	衛部醫器輸字第025303號	
	7	“美的思”柯特曼史特斯引流閥-附配件及導管	衛部醫器輸字第025303號	

本案品項-類別(2)

□ 調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(具抗虹吸功能)

廠商	項次	品名	許可證字號	給付上限
科舉	8	“柯特曼”霍金斯引流閥系統-霍金斯可調式引流閥(具抗虹吸裝置)	衛署醫器輸字第012548號	7,127點
	9	“美的思”柯特曼史特斯引流閥-具抗虹吸裝置	衛部醫器輸字第025303號	
	10	“美的思”柯特曼史特斯引流閥-附配件、抗菌導管及具抗虹吸裝置	衛部醫器輸字第025303號	
	11	“美的思”柯特曼史特斯引流閥-附配件、導管及具抗虹吸裝置	衛部醫器輸字第025303號	
美敦力	12	“美敦力”史卓塔腦脊髓液可調式壓力閥	衛署醫器輸字第023018號	
	13	“美敦力”史卓塔腦脊髓液引流組-STRATA II 控制閥	衛署醫器輸字第014308號	

5

本案品項-類別(3)


□ 調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥 (附加體位式重力閥門)

廠商	項次	品名	許可證字號	給付上限
台灣柏朗	14	雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統	衛署醫器輸字第018600號	7,127點
	15	雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統	衛部醫器輸字第028478號	

疾病簡介

□ 水腦症 (Hydrocephalus)

- 📖 腦脊髓液循環中若發生：1.腦脊髓液產生過多，2.腦脊髓液吸收回收過少，3.腦脊髓液流動受阻...等原因引起腦壓升高使腦部受到壓迫，即為水腦症。
- 📖 任何會影響腦脊髓液流通的疾病都可能造成水腦症，譬如：頭部外傷、腦中風、腦膜炎、腦瘤、先天性畸形...等。「慢性水腦症」會使病人反應遲鈍、步態緩慢顛簸、小便失禁；「急性水腦症」則可能使病人反應遲鈍以至昏迷。

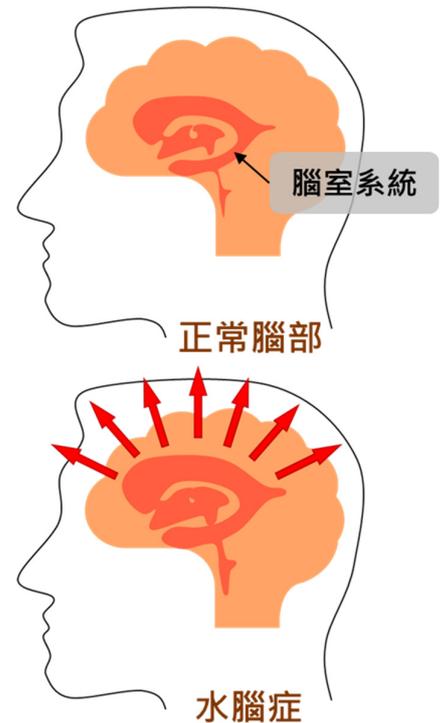

7

治療方式簡介



□ 腦室腹腔分流手術

- 📖 當腦脊髓液產生過多或腦脊髓液流動受阻時，導致腦壓升高使腦部受到壓迫，造成水腦，可利用分流手術，將脊髓液引流到腹腔，以減輕腦部內的壓力。
- 📖 利用單向引流管銜接腦室經皮下接通至腹腔，當腦室內壓力升高到一定程度，可將腦脊髓液引流至腹腔。

本案特材簡介(1)

□ 調控式腦室腹腔引流系統-流速控制型或可調式壓力閥(不具抗虹吸功能)

📖 本品特材是一種植入性或可於體外調節腦脊髓液引流程度的系統，具多段次的壓力調節設定，可以依病人病情於體內或體外調節腦脊髓液引流量，使腦室壓力維持恆定。





圖片出處：本案特材仿單

9

本案特材簡介(2)

□ 調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(具抗虹吸功能)

📖 本品特材是應用於腦室腹腔分流術之抗虹吸閥門分流系統，其閥門為結合抗虹吸原理之引流閥，可避免過量的腦脊髓液引流。



圖片出處：本案特材仿單



討1-5
8

10

本案特材簡介(3)

□ 調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥 (附加體位式重力閥門)

📖 本品特材屬體位式重力閥門分流系統，結合抗重力閥門，可依病人姿勢改變按三角函數原理調整開啟引流壓力，緩解改善過度引流症狀。



圖片出處：本案特材仿單

11

本案特材簡介(4)

□ 本案特材與健保已給付特材之比較

比較項目	本案特材	健保已給付特材
	調控式腦室腹腔引流系統	固定壓力式腦室腹腔引流組
壓力調整方式	直接於體外調整成合適的壓力。	需手術更換不同壓力範圍之引流系統。
住院期間費用	較低，依病人症狀調整，避免多次手術，因此減少病人創傷機率及住院醫療費用。	較高，因如果病人腦壓改變，需多次手術，增加住院天數及醫療成本。
使用年限	永久。	如病人腦壓改變，需重置。

資料來源：廠商建議書

相關診療項目

診療項目代碼	中文項目名稱	英文項目名稱	支付點數
83049B	腦室腹腔分流手術	V-P shunt	13,378
83055B	腦脊髓液分流管重置	Revision of CSF shunt	10,560


13

醫療科技評估摘要-療效評估(1)

□ 主要醫療科技評估組織之給付建議

📖 至2022年6月10日止，查詢加拿大CADTH、澳洲MSAC、英國NICE，未尋獲與本案特材相關的評估報告或給付規定。

📖 澳洲私人保險、日本、韓國均有收載可調式壓力閥或流速控制之調控式腦室腹腔引流相關特材；腦脊髓液分流系統之分類方式如下所示：

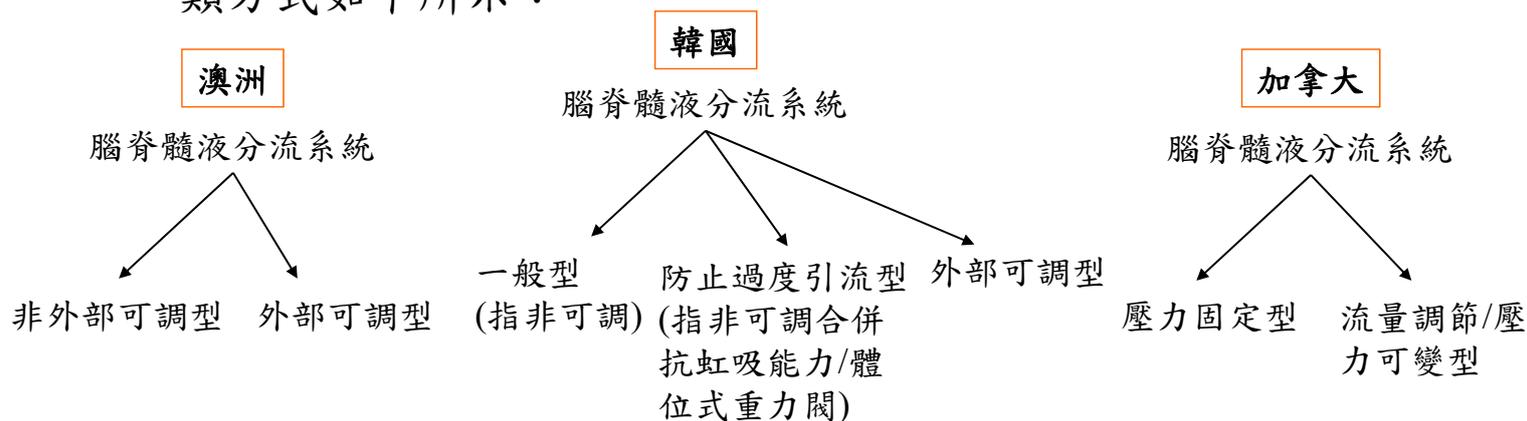

討1-7
10

14

醫療科技評估摘要-療效評估(2)

□相對療效

- 📖 2項系統性文獻回顧納入多篇觀察性研究進行統合分析，結果顯示可調式引流系統相較於非可調式引流系統有統計上顯著較低的再次手術重置率與過度引流或引流不足的發生風險。
- 📖 1項系統性文獻回顧僅納入1篇隨機對照試驗，結果顯示兩者有相似的重置率、不良事件發生率。
- 📖 另1項系統性文獻回顧與統合分析同時納入隨機對照試驗與觀察性研究之結果顯示，兩者在硬腦膜下積液、硬腦膜下積液需以手術排除以及術後感染上無統計顯著差異。
- 📖 上述證據的確定性均屬於低度。

15

醫療科技評估摘要-療效評估(3)

□相對療效

- 📖 在8項相關之回溯性研究中，有4項探討「手術重置率」，其中，2項研究結果顯示調控式腦室腹腔引流系統與非可調式腦室腹腔引流系統有相似的手術重置率，另2項研究結果顯示調控式引流系統有較低的手術重置率。
- 📖 進一步嘗試以其中4項有探討「手術重置率」的研究進行統合分析，結果顯示調控式腦室腹腔引流系統相比非可調式腦室腹腔引流系統有較低的重置率（risk ratio=0.75, 95% CI 0.58 至0.97），但基於納入統合分析之研究均屬回溯性、觀察性對照研究，故應保守解讀分析結果。

醫療科技評估摘要-療效評估(4)

□ 相對療效

📖 在8項相關之回溯性研究中，有1項研究結果顯示調控式腦室腹腔引流系統相比非可調式腦室腹腔引流系統有較少比例的病人需以手術介入移除腫塊或重置引流系統(30% vs. 90%, $p < 0.001$)。

📖 在8項相關之回溯性研究中，有1項研究納入使用腦式腹腔引流系統的兒童病人，結果顯示可調式引流組相比不可調式引流組有顯著較長的重置平均時間(37.1個月 vs. 31.0個月)。

17

相關參考價格彙整

項次	品項類別	公立醫院及醫學中心採購價				醫材比價網				國際價格(換算台幣)		
		家數	中位數	平均數	最低價	家數	中位數	平均數	最低價	日本	韓國	澳洲
(1)	調控式腦室腹腔引流系統-流速控制型或可調式壓力閥(不具抗虹吸功能)	46	49,432	51,581	31,270	124	58,000	60,157	34,273	61,914 ~78,260	26,058	49,602
(2)	調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(具抗虹吸功能)	26	58,000	64,534	40,425	99	68,473	74,525	50,267	72,413 ~96,320	26,058 ~27,125	55,732 ~62,121
(3)	調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(附加體位式重力閥門)	12	69,500	61,555	50,961	59	81,083	76,541	52,000	104,104	--	--

建議支付點數

□採計方式

 以全民健康保險藥物給付項目及支付標準第52-2條第1項第2款第1目及第3目規定為原則，以公立醫院及醫學中心之採購決標價格之中位數除以浮動點值及國際價格最低價，與廠商溝通。

編號	功能核價類別	與廠商溝通結果
1	調控式腦室腹腔引流系統-流速控制型或可調式壓力閥(不具抗虹吸功能)	2家廠商(市占率67%)表示願意以53,000點供貨；1家廠商(市占率3%)表示因原廠成本及國際運費調漲不願意以前述點數供貨。
2	調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(具抗虹吸功能)	2家廠商(市占率18%)皆表示其產品設計與其他功能類別不同，暫希望維持自付差額。
3	調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(附加體位式重力閥門)	廠商(市占率12%)表示其產品調整時較其他類別產品具更高精確度，並具有較佳的MRI相容性，暫希望維持自付差額。

19

健保署意見(1)

□建議優先將「調控式腦室腹腔引流系統-流速控制型或可調式壓力閥(不具抗虹吸功能)」類別納入健保給付。

 查本案特材3類別110年申報量，以「調控式腦室腹腔引流系統-流速控制型或可調式壓力閥(不具抗虹吸功能)」類別之使用占率(70%)最高。

 為瞭解3類特材之臨床使用差異，經洽臨床專家表示「調控式腦室腹腔引流系統-流速控制型或可調式壓力閥(不具抗虹吸功能)」類別設計簡單，可隨兒童成長過程調整，適用兒童、活動度較小的病人；「調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(具抗虹吸功能)」(占率18%)及「調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(附加體位式重力閥門)」(占率12%)主要用於因突然姿勢改變及活動度高而導致過度引流之病人。

健保署意見(2)

- 📖 現健保全額給付之固定壓力式腦室腹腔引流組無法調節壓力，本案特材可調節壓力以避免過度引流，減少後續併發症及所需之醫療費用。爰在考量臨床使用、市場占率、與廠商溝通結果及健保可負擔之財務下，建議優先將「調控式腦室腹腔引流系統-流速控制型或可調式壓力閥(不具抗虹吸功能)」類別納入健保全額給付，解決健保全額給付之臨床缺口。
- 📖 「調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(具抗虹吸功能)」及「調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(附加體位式重力閥門)」類別建議暫維持自付差額，後續再觀察臨床使用情形。

21

建議給付規定(1)

- 依111年5月份特材專家會議建議本案特材給付規定如下：
1. 易發生overdrainage病人：如normal pressure hydrocephalus, post-hemorrhagic hydrocephalus, tumor associated hydrocephalus, post-traumatic hydrocephalus, post-infective hydrocephalus 等。
 2. 其他水腦症病人，接受分流手術後發生過度引流並有下列情形之一者：
 - 1) 硬腦膜下積液
 - 2) 硬腦膜下出血
 - 3) 顱內低壓(姿勢性頭痛、影像檢查顯示廣泛腦膜顯影、靜脈竇充血、腦室變小或腰椎穿刺檢查顱內壓力偏低)。
 3. 十八歲以下之兒童不受上開給付規定之限制。

建議給付規定(2)

□ 現行健保全額給付「腦脊髓液引流組」給付規定(I203-11)：

限用於腦脊髓液分流手術後發生過度引流且有下列情形之一者：

1. 硬腦膜下積液。
2. 硬腦膜下出血。
3. 顱內低壓(姿勢性頭痛；影像檢查顯示廣泛腦膜顯影、靜脈竇充血、腦室變小或腰椎穿刺檢查顱內壓力偏低)。
4. 未滿七歲兒童，引流過度造成頭顱尺寸過小。

□ 考量健保全額給付固定壓力式腦室腹腔引流組和本案特材臨床治療上為同一族群病患，給付規定應一致，建議併同修正給付規定(I203-11) 同簡報P.22。

23

健保署財務預估

功能核價類別	暫核支付點數 (A)	健保支付 點數 (B)	年使用量		財務預估 $E=(A-B)*(C+D)$
			新增年使用量 (C)	健保全額給 付使用量 (D)	
調控式腦室腹腔引流系統-流速控制型或可調式壓力閥(不具抗虹吸功能)	53,000	7,127	1,943	928	131,701,383

- 註：
1. 本案僅納入「調控式腦室腹腔引流系統-流速控制型或可調式壓力閥(不具抗虹吸功能)」類別，爰以109年該類別之申報量1,943組，健保全額給付類似功能特材申報量977組，以開放給付後約取代95%健保全額給付申報量($977*0.95=928$)，重新推估使用量為2,871組($1,943+928=2,871$)。
 2. 預算來源：111年新醫療科技新特材品項預算約7.64億，尚餘1.03億，本案尚經本會議討論通過，其預計生效時間為111年11月，推估該項預算尚足以支應本案111年增加費用，不足部分擬以112年新醫療科技新特材品項預算支應。

特材基本資料(1)

特材名稱	“英特佳”內植用腦積水引流管組(自付差額) ”Integra” Hydrocephalus valve systems and accessories		
許可證字號	衛署醫器輸字第012626號	發證日期	94/10/07
廠商名稱	博暘科技有限公司		
製造廠名稱	Integra NeuroSciences Implants	製造國別	法國
特材大類碼	管套類(C)	特材小類碼	引流管(D)
使用科別	神經外科。		
規格	OSV II 內植用腦積水引流管組。		
材質	矽樹脂彈料、硫酸鋇、多磺胺、人工橡膠、人造紅寶石、矽樹脂膠帶鋇、多丙烯和環氧基樹脂。		
適應症	用於治療病人腦水腫的引流程序，將CSF從腦室分流到腹腔。		
健保支付點數 (自付差額)	7,127元。		

25

特材基本資料(2)

特材名稱	“美敦力”史卓塔腦脊髓液可調式壓力閥-NSC(自付差額) ”Medtronic” Strata Adjustable Valves-NSC		
許可證字號	衛署醫器輸字第023018號	發證日期	100/11/21
廠商名稱	美敦力醫療產品股份有限公司		
製造廠名稱	Medtronic Inc.	製造國別	美國
特材大類碼	管套類(C)	特材小類碼	引流管(D)
使用科別	神經外科。		
規格	25*8mm。		
材質	聚丙烯、縮乙醛、鈦金屬、矽質。		
適應症	可持續讓腦脊髓液（CSF）從腦室流入右心房或腹膜腔。		
健保支付點數 (自付差額)	7,127元。		

特材基本資料(3)

特材名稱	“美敦力”史卓塔腦脊髓液引流組-STRATA NSC控制閥(自付差額) ”Medtronic” STRATA Shunts-strata NSC Valve		
許可證字號	衛署醫器輸字第014308號	發證日期	95/04/17
廠商名稱	美敦力醫療產品股份有限公司		
製造廠名稱	Medtronic Inc.	製造國別	美國
特材大類碼	管套類(C)	特材小類碼	引流管(D)
使用科別	神經外科。		
規格	32;23*16;13mm。		
材質	聚丙烯、縮乙醛、鈿金屬、矽質。		
適應症	可持續讓腦脊髓液(CSF)從腦室流入右心房或腹膜腔。		
健保支付點數 (自付差額)	7,127元。		

27

特材基本資料(4)

特材名稱	“美的思”柯特曼霍金斯引流閥系統-可調式引流閥(自付差額) ”Medos” Codman Hakim valve system-programmable valve		
許可證字號	衛署醫器輸字第007778號	發證日期	85/02/28
廠商名稱	科舉顧問股份有限公司		
製造廠名稱	Integra LifeSciences Switzerland Sarl	製造國別	瑞士
特材大類碼	管套類(C)	特材小類碼	引流管(D)
使用科別	神經外科。		
規格	活門導入器。		
材質	聚醚砜、矽膠、紅寶石、不銹鋼。		
適應症	可提供持續的腦室內壓及腦脊髓液的引流，以治療水腦及其他腦脊髓液流動和吸收發生障礙的情形。		
健保支付點數 (自付差額)	7,127元。		

特材基本資料(5)

特材名稱	“柯特曼”霍金斯引流閥系統-霍金斯可調式引流閥(自付差額) ”Codman” Hakim Valve System-Hakim Programmable Valve Shunt Systems		
許可證字號	衛署醫器輸字第012548號	發證日期	94/10/03
廠商名稱	科舉顧問股份有限公司		
製造廠名稱	Integra LifeSciences Switzerland Sarl	製造國別	瑞士
特材大類碼	管套類(C)	特材小類碼	引流管(D)
使用科別	神經外科。		
規格	可程式化18段壓力設定，由30到200 mmH ₂ O，每段10mmH ₂ O。		
材質	316L不銹鋼彈簧、鈦活門底座、人工紅寶石球體與錐體。		
適應症	可提供持續的腦室內壓及腦脊髓液的引流，以治療水腦。		
健保支付點數 (自付差額)	7,127元。		

29

特材基本資料(6)

特材名稱	“美的思”柯特曼史特斯引流閥-附配件及抗菌導管(自付差額) ”Medos” Codman Certas Plus Programmable Valve-attachment and Bactiseal Catheter		
許可證字號	衛部醫器輸字第025303號	發證日期	102/07/27
廠商名稱	科舉顧問股份有限公司		
製造廠名稱	Integra LifeSciences Switzerland Sarl	製造國別	瑞士
特材大類碼	管套類(C)	特材小類碼	引流管(D)
使用科別	神經外科。		
規格	可調式引流閥：8段壓力設定，腦室導管：14cm，遠端導管：120cm。		
材質	導管：矽橡膠、直角接頭：Prolene。		
適應症	可於治療腦積水時提供穩定的顱內壓及腦脊髓液引流。		
健保支付點數 (自付差額)	7,127元。		

特材基本資料(7)

特材名稱	“美的思”柯特曼史特斯引流閥-附配件及導管(自付差額) "Medos" Codman Certas Plus Programmable Valve -Attachment and Catheter		
許可證字號	衛部醫器輸字第025303號	發證日期	102/07/27
廠商名稱	科舉顧問股份有限公司		
製造廠名稱	Integra LifeSciences Switzerland Sarl	製造國別	瑞士
特材大類碼	管套類(C)	特材小類碼	引流管(D)
使用科別	神經外科。		
規格	可調式引流閥：8段壓力設定，腦室導管：14cm，遠端導管：120cm。		
材質	導管：矽橡膠、直角接頭：Prolene。		
適應症	可於治療腦積水時提供穩定的顱內壓及腦脊髓液引流。		
健保支付點數 (自付差額)	7,127元。		

31

特材基本資料(8)

特材名稱	“柯特曼”霍金斯引流閥系統-霍金斯可調式引流閥(具抗虹吸裝置) (自付差額)"Codman" Hakim valve System-Hakim programmable valve shunt systems(with siphonguard)		
許可證字號	衛署醫器輸字第012548號	發證日期	94/10/03
廠商名稱	科舉顧問股份有限公司		
製造廠名稱	Integra LifeSciences Switzerland Sarl	製造國別	瑞士
特材大類碼	管套類(C)	特材小類碼	引流管(D)
使用科別	神經外科。		
規格	可程式化18段壓力設定，由30到200 mmH ₂ O，每段10mmH ₂ O。		
材質	316L不銹鋼彈簧、鈦活門底座、人工紅寶石球體與錐體。		
適應症	可提供持續的腦室內壓及腦脊髓液的引流，以治療水腦。		
健保支付點數 (自付差額)	7,127元。		

特材基本資料(9)

特材名稱	“美的思”柯特曼史特斯引流閥-具抗虹吸裝置(自付差額) ”Medos” Codman Certas Plus Programmable Valve -Siphonguard		
許可證字號	衛部醫器輸字第025303號	發證日期	102/07/27
廠商名稱	科舉顧問股份有限公司		
製造廠名稱	Integra LifeSciences Switzerland Sarl	製造國別	瑞士
特材大類碼	管套類(C)	特材小類碼	引流管(D)
使用科別	神經外科。		
規格	可調式引流閥：8段壓力設定，腦室導管：14cm，遠端導管：120cm。		
材質	導管：矽橡膠、直角接頭：Prolene。		
適應症	可於治療腦積水時提供穩定的顱內壓及腦脊髓液引流。		
健保支付點數 (自付差額)	7,127元。		

33

特材基本資料(10)

特材名稱	“美的思”柯特曼史特斯引流閥-附配件、抗菌導管及具抗虹吸裝置(自付差額) ”Medos” Codman Certas Plus Programmable Valve -Attachment、 Bactiseal catheter and Siphonguard		
許可證字號	衛部醫器輸字第025303號	發證日期	102/07/27
廠商名稱	科舉顧問股份有限公司		
製造廠名稱	Integra LifeSciences Switzerland Sarl	製造國別	瑞士
特材大類碼	管套類(C)	特材小類碼	引流管(D)
使用科別	神經外科。		
規格	可調式引流閥：8段壓力設定，腦室導管：14cm，遠端導管：120cm。		
材質	抗菌導管：含銀矽橡膠、直角接頭：Prolene。		
適應症	可於治療腦積水時提供穩定的顱內壓及腦脊髓液引流。		
健保支付點數 (自付差額)	7,127元。		

特材基本資料(11)

特材名稱	“美的思”柯特曼史特斯引流閥-附配件、導管及具抗虹吸裝置 (自付差額) ”Medos” Codman Certas Plus Programmable Valve-Attachment、Catheter and Siphonguard		
許可證字號	衛部醫器輸字第025303號	發證日期	102/07/27
廠商名稱	科舉顧問股份有限公司		
製造廠名稱	Integra LifeSciences Switzerland Sarl	製造國別	瑞士
特材大類碼	管套類(C)	特材小類碼	引流管(D)
使用科別	神經外科。		
規格	可調式引流閥：8段壓力設定，腦室導管：14cm，遠端導管：120cm。		
材質	抗菌導管：含銀矽橡膠、直角接頭：Prolene。		
適應症	可於治療腦積水時提供穩定的顱內壓及腦脊髓液引流。		
健保支付點數 (自付差額)	7,127元。		

35

特材基本資料(12)

特材名稱	“美敦力”史卓塔腦脊髓液可調式壓力閥(自付差額) ”Medtronic” Strata Adjustable Valves		
許可證字號	衛署醫器輸字第023018號	發證日期	100/11/21
廠商名稱	美敦力醫療產品股份有限公司		
製造廠名稱	Medtronic Inc.	製造國別	美國
特材大類碼	管套類(C)	特材小類碼	引流管(D)
使用科別	神經外科。		
規格	24*8mm。		
材質	聚丙烯、縮乙醛、鈿金屬、矽質。		
適應症	可持續讓腦脊髓液（CSF）從腦室流入右心房或腹膜腔。		
健保支付點數 (自付差額)	7,127元。		

特材基本資料(13)

特材名稱	“美敦力”史卓塔腦脊髓液引流組-STRATA II控制閥(自付差額) ”Medtronic”Strata Shunts-strata II Valve		
許可證字號	衛署醫器輸字第014308號	發證日期	95/04/17
廠商名稱	美敦力醫療產品股份有限公司		
製造廠名稱	Medtronic Inc.	製造國別	美國
特材大類碼	管套類(C)	特材小類碼	引流管(D)
使用科別	神經外科。		
規格	32;23*16;13mm。		
材質	聚丙烯、縮乙醛、鈦金屬、矽質。		
適應症	可持續讓腦脊髓液（CSF）從腦室流入右心房或腹膜腔。		
健保支付點數 (自付差額)	7,127元。		

37

特材基本資料(14)

特材名稱	雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統(自付差額) Aesculap-miethke Progav Adjustable Shunt System		
許可證字號	衛署醫器輸字第018600號	發證日期	97/02/20
廠商名稱	台灣柏朗股份有限公司		
製造廠名稱	Christoph Miethke GMBH & CO. KG	製造國別	德國
特材大類碼	管套類(C)	特材小類碼	引流管(D)
使用科別	神經外科。		
規格	--		
材質	導管：PUR材質、閥門：內部為磁鐵設計，外部為鈦合金材質包覆。		
適應症	可將腦脊髓液（CSF）自腦室引流至腹腔，適用於水腦症病患。		
健保支付點數 (自付差額)	7,127元。		

特材基本資料(15)

特材名稱	雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統(自付差額) Aesculap-miethke Progav 2.0 Adjustable Shunt System		
許可證字號	衛部醫器輸字第028478號	發證日期	105/08/29
廠商名稱	台灣柏朗股份有限公司		
製造廠名稱	Christoph Miethke GMBH & CO. KG	製造國別	德國
特材大類碼	管套類(C)	特材小類碼	引流管(D)
使用科別	神經外科。		
規格	--		
材質	本體：鈦合金、鈿、藍寶石，本體：矽膠。		
適應症	本產品適用於水腦症治療之腦脊髓液（CSF）引流。		
健保支付點數 (自付差額)	7,127元。		

111 年 5 月份特殊材料專家諮詢會議紀錄

(時間：111 年 5 月 26 日上午 9 時 30 分)

貳、討論提案

第 1 案：有關現行保險對象自付差額類別之特殊材料「腦脊髓液分流系統」等 4 類計 15 品項納入健保全額給付案，提請討論。

說明：

- (一) 本案特材適用於水腦症病患，於 104 年 6 月 1 日納入健保，屬保險對象自付差額特材。經提 107 年 6 月本會議討論，結論略以因財務衝擊之影響及對於本案確實有臨床療效的族群尚不明確，建議暫緩改列健保全額給付，倘本案特材已為臨床常規普遍使用，請台灣神經外科醫學會及台灣兒童神經外科醫學會訂定臨床指引及明確嚴謹之給付適應症後再議。
- (二) 本案特材因使用占率逐年提升，107 年至 109 年達 8 成以上，已為臨床常規普遍使用，且為健保會密切關注及追蹤要優先研議納入健保全額給付之項目，爰重啟研議。
- (三) 社團法人台灣神經外科醫學會及台灣兒童神經外科醫學會與會代表，以及與會專家表示：
 1. 依據健保署統計 8 成以上病人使用自付差額本案特材，其較健保全額給付定壓式腦室腹腔引流組具有優點，如可自動調整流速、從外面調整壓力及可抵抗虹吸、重力造成的水腦問題，可改善病人預後，短期健保財務會增加，但整體長期來看，可減少併發症及手術等，可節省財務。倘本案特材為 MRI 相容，可增加病人安全性，並可減少後續檢查之影像干擾。另文獻顯示引流過度比引流不足問題更大，建議全額納入健保給付。
 2. 兒童頭顱成長過程，若治療水腦症未使用可調壓的本案特材，可能造成頭位過小或腦室過小之狀況，會有一些不可逆的併發症，建議兒童水腦症手術要可使用可調壓的本案特材，可大幅減少引流過量造成的併發症。

3. 台灣兒童神經外科醫學會建議 18 歲以下水腦症手術開放臨床醫師決定是否使用，故針對社團法人台灣神經外科醫學會建議易發生 slit ventricle 病患及兒童水腦患者引流過度造成頭顱尺寸過小，予以刪除限制，並考量腦炎病患治療上需使用本案特材，特別是 Covid-19 導致兒童腦炎情形，建議將 post-meningitic hydrocephalus 修改為 post-infective hydrocephalus。

(四) 健保署說明：

1. 考量「調控式腦室腹腔引流系統-流速控制型」與「調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(不具抗虹吸功能)」之差異主要為體外手動及體內自動調整流速，且價格差異不大，又「調控式腦室腹腔引流系統-流速控制型」申報占率低且查無國際價格，建議將前開 2 類併為一類。與會學會代表皆表示同意。
2. 另考量固定壓力和可調壓力式腦脊髓液分流系統，其臨床治療上為同一族群病患，給付規定應一致，建議將現行健保全額給付「腦脊髓液引流組」給付規定(I203-11)併同本案給付規定一起整合修訂，使臨床醫師可依疾病狀況選擇合適之醫材。與會學會代表亦皆表示認同。
3. 針對與會專家詢問本案特材是否為 MRI 相容，目前確認醫材仿單，皆為 MRI 相容。

結論：與會專家一致建議如下：

- (一) 本案特材使用占率逐年提升，已為臨床常規使用，且可改善病人預後，減少併發症及手術等，特別是兒童更具有效性及安全性，建議全額納入健保給付。
- (二) 建議功能分類：
 1. 調控式腦室腹腔引流系統-流速控制型或可調式壓力閥(不具抗虹吸功能)。
 2. 調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(具抗虹吸功能)
 3. 調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(附加體位式重力閥門)
- (三) 建議支付點數：考量使用量及市場價格，納入全額給付後應以對健保最具優惠之方案，授權健保署以全民健康保險藥物給付項目及支付標準第 52-2 條第 1 項第 2 款第 1 目及第 3 目規定為原則，與廠商協商。

(四) 建議給付規定:

1. 易發生 overdrainage 病人：如 normal pressure hydrocephalus, post-hemorrhagic hydrocephalus, tumor associated hydrocephalus, post-traumatic hydrocephalus, post-infective hydrocephalus 等。
2. 其他水腦症病人，接受分流手術後發生過度引流並有下列情形之一者：
 - (1) 硬腦膜下積液
 - (2) 硬腦膜下出血
 - (3) 顱內低壓（姿勢性頭痛、影像檢查顯示廣泛腦膜顯影、靜脈竇充血、腦室變小或腰椎穿刺檢查顱內壓力偏低）。
3. 十八歲以下之兒童不受上開給付規定之限制。

(五) 預估年使用量：參採台灣神經外科學會意見，約占該類特材總申報量之 95%，約 3,325 組。

(六) 併同修正現行健保全額給付「腦脊髓液引流組」給付規定(I203-11)，與本案給付規定一致。

討論案 2

有關耀瑞股份有限公司建議調高既有功能類別特材
「“史密斯”儲液卡匣+“史密斯”延長管(含 0.2
micron 過濾器)」之支付點數案。

討論案第 2 案

案由：有關耀瑞股份有限公司建議調高既有功能類別特材「“史密斯”儲液卡匣+“史密斯”延長管(含 0.2 micron 過濾器)」之支付點數案，提請討論。

說明：

- 一、依據耀瑞股份有限公司(以下稱耀瑞公司)111 年 6 月 15 日耀(111)字第 1110615001 號函辦理(詳附件 1, 頁次: 討 2-3~討 2-4)。
- 二、查「“史密斯”儲液卡匣」(不含延長管)為本保險收載「限原發性肺動脈高血壓症居家靜脈注射 FLOLAN 者」功能核價類別, 自 89 年 11 月 1 日起納入給付, 健保支付點數每個 750 點, 目前健保收載有效品項共 2 項, 無給付規定, 均為耀瑞公司所持有之產品(詳附件 2, 頁次: 討 2-5)。
- 三、案係耀瑞公司來函表示, 本案特材為用於罕見疾病原發性肺動脈高血壓症居家靜脈注射 FLOLAN 者, 且儲液卡需搭配專用延長管以整組使用, 因近年來國際原物料成本、運輸費用大幅上漲及製造成本也增加極多, 建議以整組「儲液卡匣+延長管」納入健保給付, 並調高支付點數為 1,500 點, 且併同刪除原僅有儲液卡匣之特材代碼(BBB0107322HJ 及 BBB01TEMP001)。依廠商提供成本分析表, 每組進口總成本(含運費、保險費、關稅、報關費用等)為 1,227 元(未含管銷費用)。
- 四、本案特材按醫療器材許可證仿單所載如下:
 - (一) 「“史密斯”儲液卡匣」(型號 21-7302-24, 規格 100ml): 本產品可使用的 CADD 的幫浦上, 必須配合使用內含抗虹吸閥的專用延長管(CADD Extension Set)。
 - (二) 「“史密斯”延長管」(型號 21-7106-24): 含抗虹吸閥的 Smiths 專用延長管(CADD Extension Set)與儲液卡匣一併使用, 可防止卡匣連接不當導致的反重力注入。
- 五、經本署遴聘醫藥審查專家表示:
 - (一) 文獻指出 FLOLAN 是目前所有肺動脈高壓治療藥物中, 唯一一個可增加病患存活的藥物, 是嚴重肺動脈高壓患者的最後一線用藥, 且不可中斷。

- (二) FLOLAN 需要透過攜帶式注射幫浦 24 小時不間斷地將藥物注射進入靜脈血管中，儲液卡匣必須與抗虹吸閥的 Smiths 專用延長管一併使用，以防止卡匣連接不當導致的反重力注入，造成過量給藥的情形。FLOLAN 準確劑量的輸注，對原發性肺動脈高壓患者至為重要，因此儲液卡匣需搭配延長管整組使用，考量原物料價格增加與通膨之考量，且為臨床救命之必要特材、又無替代品可使用，建議調高支付點數。
- (三) 預估年使用量：儲液卡匣及延長管於臨床使用為每日更換一組，加上藥品更換銜接及不可避免之耗損，1 人 1 年預估使用量約 400 組，目前全台使用 6~8 人，預估 1 年使用數量約為 2,400 組~3,200 組。

六、依全民健康保險藥物給付項目及支付標準(以下稱支付標準)第 53-2 條規定，必要或不可替代之特殊材料，因成本變動等因素致不敷成本，且屬相同功能類別者，亦無廠商可依現行健保支付點數供應時，該醫療器材許可證之持有廠商得提出該特殊材料調高健保支付點數之建議，由保險人提藥物擬訂會議討論。支付點數之訂定可參考廠商成本價、醫事服務機構採購價及同功能類其他廠商建議價最低者，擇一訂定，並得考量合理因素加算，最高加算百分之十五(詳附件 3，頁次：討 2-6)。

七、建議支付點數：參考廠商進口成本分析資料為 1,227 元，且考量浮動點值(108Q1-108Q4：0.8823)及臨床使用之必要性，再依支付標準第 53-2 條規定得加算 15%為 1,599 點【 $(1,227/0.8823)*1.15$ 】，因高於廠商建議支付點數 1,500 點，爰建議調整支付點數為 1,500 點。

八、預估年使用量：考量 103 年起至 110 年，本案特材功能核價類別之申報量有逐年下降之趨勢，且近年 Covid-19 疫情影響，爰擬依 105 年之申報量 1,260 組作推估。

九、財務預估：健保財務增加約 94.5 萬點【 $(1,500-750)*1,260$ 】。

擬辦：本案經討論後如獲同意，擬依上開說明調整「限原發性肺動脈高血壓症居家靜脈注射 FLOLAN 者」功能核價類別之支付點數，且併同刪除原單組件(儲液卡匣)之特材代碼(BBB0107322HJ 及 BBB01TEMP001)，並依程序辦理暫予公告實施。

耀瑞股份有限公司 (函)

承辦人：

電話：(02)25150450 分機

受文者：衛生福利部中央健康保險署

發文日期：中華民國 111 年 6 月 15 日

發文文號：耀 (111) 字第 1110615001 號

- 附件：1.既有功能類別特材給付建議書 (A4-1、A4-2、A4-3)
2.醫療器材許可證正、反面影本乙份
3.中文仿單核定本影本乙份
4.產品型錄乙份
5.切結書乙份
6.建議售價參考文件


主旨：Smiths 廠牌產品“史密斯“儲液卡匣 (包括延長管含 0.2 micron 過濾器) “Smiths” CADD Medication Cassette Reservoirs (include Extension set with 0.2 micron filter), 申請新增健保碼及健保價, 如說明。

說明：關於本公司代理銷售之上列產品，其衛生福利部核發之合格醫療器材許可證字號：衛部醫器輸字第 032650 號及衛署醫器輸字第 018368 號，產品規格及品號：21-7302-24 100ml CADD Medication Cassette Reservoirs, 21-7106-24 CADD Extension set with 0.2 micron filter。

上述產品已為 貴署既有功能品項，是罕見疾病肺動脈高壓症臨床急需使要之醫材，特此申請新增健保碼及健保價，規格詳如附件中文仿單說明，相關申請資料如附，祈請 貴局准予申辦並惠覆為荷。

耀瑞股份有限公司

負責人：蔡孟峰

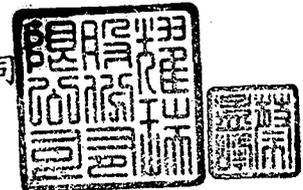

主旨：申請新特材代碼：BBB0107302HJ 史密斯儲液卡匣（包括延長管含 0.2 micron 過濾器）

※限肺動脈高壓症居家靜脈注射 Flolan 者使用,健保支付點數說明。

說明：

1. 目前的特材代碼：BBB0107322HJ

中文品名：史密斯"儲液卡匣（限原發性肺動脈高血壓症居家靜脈注射 FLOLAN 者）

產品型號：21-7302-24 支付點數：750.-/ea

此特材短少申請專用配件型號 21-7106-24 延長管含 0.2 micron 過濾器,病患無法單獨使用儲液卡匣。

2. 目前新申請的特材代碼：BBB0107302HJ

中文品名：“史密斯”儲液卡匣（包括延長管含 0.2 micron 過濾器）

※限肺動脈高壓症居家靜脈注射 Flolan 者

產品型號：21-7302-24+21-7106-24 申請的支付點數：1500.-/ea

是一完整的病患使用套件組,所以重新申請。

3. 目前的特材代碼：BBB0107322HJ 支付點數是用 89/11/01 的特材代碼：BBB01TEMP001 的支付點數 750.-/ea 支付,至今已 22 年均未調整過,近年來國際原物料成本大幅上漲,運輸費用大幅增加,又新品結構變更,工廠產線更新,製造成本也增加極多,故新品成本比舊品成本已大幅上漲。此產品只使用於罕見疾病原發性肺動脈高血壓症居家靜脈注射 FLOLAN 者,本公司基於企業之社會責任,特別進口供原發性肺動脈高血壓症病患使用,目前全台病患已剩大約 5 人治療使用中。懇請 貴局能儘早核准此套件組的健保價,減輕並嘉惠這些罕見疾病原發性肺動脈高血壓症病患的生活經濟負擔。

4. 新的特材代碼：BBB0107302HJ 若申請核准時,請 貴局同時刪除特材代碼：

BBB01TEMP001, BBB0107322HJ 兩個特材代碼,毋任感荷。

健保收載特材品項彙整表

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	許可證字號	產品型號/規格	製造國	支付點數	納入健保 給付日期	給付規定 代碼	廠商
1	BBB0107322HJ	“史密斯”儲液卡匣 (限原發性肺動脈高 血壓症居家靜脈注射 FLOLAN者)	“Smiths” CADD Medication Cassette Reservoirs	衛部醫器輸字 第032650號	21-7302-24	墨西哥	750	110/09/01	無	耀瑞股份 有限公司
2	BBB01TEMP001	"史密斯"儲液卡匣 (限原發性肺動脈高 血壓症居家靜脈注射 FLOLAN者)	100CC MEDICATION CASSETTE RESERVOIR	衛署醫器輸字 第017342號	CADD-1	墨西哥	750	089/11/01	無	耀瑞股份 有限公司

條號查詢結果

法規名稱：全民健康保險藥物給付項目及支付標準

法規類別：行政 > 衛生福利部 > 社會保險目

附檔：
附件一：全民健康保險藥品及特殊材料事前審查申請書.PDF
附件二：藥品給付品項暨支付標準表.PDF
附件三：特殊材料給付品項暨支付標準表.PDF
附件四：中藥用藥品項表（單方）.PDF
附件五：中藥用藥品項表（複方）.PDF
附件六：藥品給付規定.PDF
附件七：特殊材料給付規定.PDF

- 第 53-2 條
- 1 必要或不可替代之特殊材料，因成本變動相關因素致不敷成本，且屬相同功能類別者，亦無廠商可依現行健保支付點數供應時，該醫療器材許可證之持有廠商得提出該特殊材料調高健保支付點數之建議，由保險人提藥物擬訂會議討論。
 - 2 前項特殊材料支付點數之訂定原則如下，得擇一訂定：
 - 一、參考廠商進口或製造成本價。
 - 二、參考醫事服務機構購買價，得除以收載時最近四季結算之醫院總額部門浮動點值之平均值。
 - 三、同功能類別特殊材料有多家廠商可供應，採其中建議價最低者。
 - 3 前項支付點數之訂定，得考量合理因素加算，最高加算百分之十五。
 - 4 屬非必要或有替代性之全額給付特殊材料，廠商以高於支付點數供應予本保險特約醫事服務機構，經保險人通知醫療器材許可證持有廠商限期改善，屆期仍未改善者，保險人應將該品項不列入本標準一年。

資料來源：全國法規資料庫

報告案 1

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

共 162 項：(1)新增既有功能類別特材品項 120 項/第 1-1~1-14 頁；項次 1~120。(2)新增既有功能類別特材自付差額品項 12 項/第 1-15~1-16 頁；項次 121~132。(3)新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號 30 項/第 1-17~1-21 頁；項次 133~162。

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共120項(項次1~項次120,詳頁次1-1~1-14)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至111年9月 同功能/類似功 能核價類別之 有效品項數	給付規定	健保給付 生效日期
1	CDD11000389	"施愛德"一次性腹腔鏡用穿刺器;3mm(穿刺內管1+穿刺外管1+轉接頭1)	"Surgaid" Single Use Sterile Laparoscopic Trocar Kit	(NGCSA;NTCSA;NPCMA;NPCSA-50;70;90-1-3);(NPCS;NPCM;NGCS;NTCS-70-1-3);(NGCS-50-1-3)	組	衛部醫器陸輸字第001354號	智鼎	1,100	依CDD11A4(內視鏡安全穿刺套管≤6MM(穿刺內管OBTURATORX1)+穿刺外管1支+固定式轉接頭1支)全組拋棄式)同功能類別品項(如特材代碼CDD11NB5LP2C)之支付點數暫予支付。	14	無	111/11/01
2	CDD110051589	"施愛德"一次性腹腔鏡用穿刺器;5-15mm(穿刺套管1支+穿刺針1支+可變式轉接頭1支)	"Surgaid" Single Use Sterile Laparoscopic Trocar Kit	請參考圖檔(詳頁次1-22)	組	衛部醫器陸輸字第001354號	智鼎	1,379	依CDD11A3(內視鏡安全穿刺套管5-15MMTROCARKIT(穿刺內管X1OBTURATOR+穿刺外管X1SLEEVE+可變轉接頭X1)全組拋棄式)同功能類別品項(如特材代碼CDD110612NL7)之支付點數暫予支付。	41	無	111/11/01
3	CDD11FPB0593	"風和醫療"一次性內視鏡穿刺器5mm(穿刺針1+外管1+固定轉接頭1)	"Fengh" Disposable Endoscopic Trocar	FLPC5;BLTC5;F5LP;B5LT	組	衛部醫器陸輸字第001355號	埃默高	1,100	依CDD11A4(內視鏡安全穿刺套管≤6MM(穿刺內管OBTURATORX1)+穿刺外管1支+固定式轉接頭1支)全組拋棄式)同功能類別品項(如特材代碼CDD11NB5LP2C)之支付點數暫予支付。	14	無	111/11/01
4	CEE01VS351Q4	"尼得立斯"計量點滴輸液套-幫浦輸液套/無針式接頭*1/避光/過濾器)	"Needleless" Administration Set	PVS351;PVS851	組	衛部醫器製字第005721號	尼得立斯	255	依CLS06A4(PUMPSET/FOR避光藥品/FILTER/1個或2個無針式接頭)同功能類別品項(如特材代碼CLS06C5088U2)之最後收載品項之支付點數暫予支付。	0	E301-4	111/11/01
5	CGDW1SSSH190	"鐵克諾武"三愛司血管攝影導線	"Technowood" SSS Angiographic Guide Wire	H503-3508A;H503-3508BK1.5;H503-3508AM;H503-3508BK1.5M	條	衛部醫器輸字第035347號	博宣寧	647	依GWAB21A(GUIDEWIRE/彈性合金(NITINOL),D=0.016"-0.052",L≤100CM,有塗層)同功能類別品項(如特材代碼CGDW1VHUQ1AS)之支付點數暫予支付。	5	無	111/11/01

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共120項(項次1~項次120,詳頁次1-1~1-14)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至111年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
6	CGDW1SSSH290	“鐵克諾武”三愛司血管攝影導線	“Technowood” SSS Angiographic Guide Wire	H502-3515S;H503-3515S;H503L-3515S;H502-3518S;H503-3518S;H503L-3518S;H502-3520S;H503-3520S;H503L-3520S;H502-3515A;H503-3515A;H503L-3515A;H502-3518A;H503-3518A;H503L-3518A;H502-3520A;H503-3520A;H503L-3520A;H502-3515P2;H503-3515P2;H503L-3515P2;H502-3518P2;H503-3518P2;H503L-3518P2;H502-3520P2;H503-3520P2;H503L-3520P2;H502-3515P3;H503-3515P3;H503L-3515P3;H502-3518P3;H503-3518P3;H503L-3518P3;H502-3520P3;H503-3520P3;H503L-3520P3;H502-3515BK1.5;H503-3515BK1.5;H503L-3515BK1.5;H502-3518BK1.5;H503-3518BK1.5;H503L-3518BK1.5;H502-3520BK1.5;H503-3520BK1.5;H503L-3520BK1.5;H502-3515AM;H503-3515AM;H503L-3515AM;H502-3518AM;H503-3518AM;H503L-3518AM;H502-3520AM;H503-3520AM;H503L-3520AM;H502-3515BK1.5M;H503-3515BK1.5M;H503L-3515BK1.5M;H502-3518BK1.5M;H503-3518BK1.5M;H503L-3518BK1.5M;H502-3520BK1.5M;H503-3520BK1.5M;H503L-3520BK1.5M	條	衛部醫器輸字第035347號	博宣寧	744	依GWAB210(GUIDEWIRE/彈性合金(NITINOL),D=0.016"-0.052",L=101-200CM,有塗層)同功能類別品項(如特材代碼CGDW1VHUQ2AS)之支付點數暫予支付。	20	無	111/11/01
7	CGDW1SSSH390	“鐵克諾武”三愛司血管攝影導線	“Technowood” SSS Angiographic Guide Wire	H502-3522S;H503-3522S;H503L-3522S;H502-3526S;H503-3526S;H503L-3526S;H502-3522A;H503-3522A;H503L-3522A;H502-3526A;H503-3526A;H503L-3526A;H502-3522P2;H503-3522P2;H503L-3522P2;H502-3526P2;H503-3526P2;H503L-3526P2;H502-3522P3;H503-3522P3;H503L-3522P3;H502-3526P3;H503-3526P3;H503L-3526P3;H502-3522BK1.5;H503-3522BK1.5;H503L-3522BK1.5;H502-3526BK1.5;H503-3526BK1.5;H503L-3526BK1.5;H502-3522AM;H503-3522AM;H503L-3522AM;H502-3526AM;H503-3526AM;H503L-3526AM;H502-3522BK1.5M;H503-3522BK1.5M;H503L-3522BK1.5M;H502-3526BK1.5M;H503-3526BK1.5M;H503L-3526BK1.5M	條	衛部醫器輸字第035347號	博宣寧	1,359	依GWAB310(GUIDEWIRE/彈性合金(NITINOL),D=0.016"-0.052",L=201-300CM,有塗層)同功能類別品項(如特材代碼CGDW1VHUQ3AS)之支付點數暫予支付。	14	無	111/11/01
8	CGPG1CS126AS	“朝日”科塞爾微導管	“ASAHI” CORSAIR MICRO CATHETER	CSW135-26N;CSW150-26N;CSR135-26P;CSR150-26P	條	衛署醫器輸字第021465號	日商朝日英達科	11,536	依CGPG1A4(單腔微導管/用於冠狀動脈完全阻塞(CTO))同功能類別品項(如特材代碼CGPG1TORO2AS)之支付點數暫予支付。	2	A225-6	111/11/01
9	CGPW124954SB	“波士頓科技”艾裘帝靜脈導線	“Boston Scientific” Acuity Strait-Trak and Mailman Venous Guide Wires	7081;7082	組	衛署醫器輸字第024954號	荷商波士頓	2,353	依GWBA610(GUIDEWIRE(CRT)/不鏽鋼,D<=0.014",L=90-190CM,有塗層)同功能類別品項(如特材代碼CGPW1ACUMMSB)之最後收載品項之支付點數暫予支付。	0	B104-1	111/11/01

一、新增既有功能類別特材品項共120項(項次1~項次120,詳頁次1-1~1-14)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至111年9月 同功能/類似功 能核價類別之 有效品項數	給付規定	健保給付 生效日期
10	CGPW185261A7	“埃普特”蘇黎世 導引線	“APT” susrail Guidewire	42118261;42135261	條	衛部醫器陸輸 字第001333號	蘭波灣	2,669	依GWBB310(GUIDEWIRE(周邊血管介入治 療)/彈性合金,D=0.014"-0.052", L>=201CM,塗層)同功能類別品項(如特材代 碼CGPW1LW26EMR)之支付點數暫予支付。	9	無	111/11/01
11	CGPWIAHW03AS	朝日冠狀動脈導引 線	ASAHI PTCA Guide Wire	AHW14R013S;AHW14R013P	條	衛部醫器輸字 第034095號	日商朝 日英達 科	4,734	依GWBA420(GUIDE WIRE(PTCA)/不鏽鋼, D=0.0078-0.014【[縮細2段式或3段式 Tapered tip]或[多重編織線圈(Multi Stranded Coil)】/L>=101CM/有塗層)同功 能類別品項(如特材代碼CGPWIAHW14AS)之支 付點數暫予支付。	6	A225-3	111/11/01
12	CGPW1S8181A7	“埃普特”蘇黎世 導引線	“APT” susrail Guidewire	42118181	條	衛部醫器陸輸 字第001333號	蘭波灣	2,669	依GWBB210(GUIDEWIRE(周邊血管介入治療)/ 彈性合金,D=0.014"-0.052",L<=200CM, 塗層)同功能類別品項(如特材代碼 CGPW1LWS35MR)之支付點數暫予支付。	8	無	111/11/01
13	CGS0126441SB	“波士頓科技”艾 裘帝導引導管	“Boston Scientific” Acuity Pro Guide Catheter	(90810799- 02;06;10;14;18;22;26;30;34;38;42;46;50;54;58;6 2);(90810798-02;06;10;14)	組	衛部醫器輸字 第026441號	荷商波 士頓	6,528	依CGS01A3(配合心臟整流去顫器結合心房同 步雙心室節律器使用左心室傳送系統/具整 合式止血閥)同功能類別品項(如特材代碼 CGS01ATT62M4)之支付點數暫予支付。	3	C301-1	111/11/01
14	CHF06MEFKA95	“賽耐司”美德思 股動靜脈導管	“Xenios” Medos Femoral Cannulae	(MEFKA-16;18;20;22;24-L);(MEFKV- 18;20;22;24;26;28-L)	組	衛署醫器輸字 第018553號	興東	16,771	依CHF06A2(動脈或靜脈人工心肺導管套 (ECMO))同功能類別品項(如特材代碼 CHF06MEFKAML)之支付點數暫予支付。	4	B201-2	111/11/01
15	CLS05110VNBB	“柏朗”史倍斯輸 液套-幫浦輸液套/ 卡樺式/附無針式接 頭1個	“B. Braun” Infusomat Space Line	8700110SP	組	衛部醫器輸字 第035319號	台灣柏 朗	195	依CLS05A7(PUMP SET/卡樺式/附無針式接頭 1個)同功能類別品項(如特材代碼 CLS05110HUBB)之支付點數暫予支付。	5	E301-4	111/11/01
16	CLS05118VNBB	“柏朗”史倍斯輸 液套-幫浦輸液套/ 卡樺式/附無針式接 頭1個(含AirStop)	“B. Braun” Infusomat Space Line	8700118SP	組	衛部醫器輸字 第035319號	台灣柏 朗	195	依CLS05B7(PUMPSET/卡樺式/附無針式接頭1 個(含Airtrap或Airstop))同功能類別品項 (如特材代碼CLS0511943HR)之支付點數暫予 支付。	1	E301-4	111/11/01
17	CLS05140VNBB	“柏朗”史倍斯輸 液套-幫浦輸液套/ 卡樺式/WITH BURETTE(含 AirStop)	“B. Braun” Infusomat Space Line	8700140SP	組	衛部醫器輸字 第035319號	台灣柏 朗	197	依 CLS05B1(PUMPSET/FOROTHERDRUG/WITHBURET TE/卡樺式(含Airtrap或Airstop))同功能類 別品項(如特材代碼CLS0611706HR)之支付點 數暫予支付。	1	E301-1	111/11/01
18	CLS05350VNBB	“柏朗”史倍斯輸 液套-幫浦輸液套 /WITHOUT BURETTE/ 卡樺式	“B. Braun” Infusomat Space Line	8270350SP	組	衛部醫器輸字 第035319號	台灣柏 朗	152	依CLS05A2(PUMP SET/FOR OTHER DRUG/WITHOUT BURETTE/卡樺式)同功能類別 品項(如特材代碼CLS05350HUBB)之支付點數 暫予支付。	10	E301-1	111/11/01
19	CLS05710VNBB	“柏朗”史倍斯輸 液套-幫浦輸液套/ 卡樺式/附無針式接 頭2個	“B. Braun” Infusomat Space Line	8250710SP	組	衛部醫器輸字 第035319號	台灣柏 朗	229	依CLS05A8(PUMP SET/卡樺式/附無針式接頭 2個)同功能類別品項(如特材代碼 CLS05ST420KG)之支付點數暫予支付。	4	E301-4	111/11/01

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共120項（項次1~項次120，詳頁次1-1~1-14）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至111年9月 同功能/類似功 能核價類別之 有效品項數	給付規定	健保給付 生效日期
20	CLS05PVS21Q4	“尼得立斯”計量 點滴輸液套-NTG幫 浦輸液套	“Needleless” Administration Set	PVS201;PVS202	組	衛部醫器製字 第005721號	尼得立 斯	230	依CLS06A1(PUMP SET/FOR NTG)同功能類別 品項(如特材代碼CLS0543650KG)之支付點數 暫予支付。	2	無	111/11/01
21	CRT02CUF1F94	“維立”氣切套管- 有氣囊	“Well Lead” Tracheostomy Tube- Cuffed	A02A05-65;70;75;80;85;90;95;96-1F	支	衛部醫器陸輪 字第001330號	博宣寧	332	依CRT02T1(氣切套管(單管,有氣囊))同功能 類別品項(如特材代碼CRT02CUF659W)之支付 點數暫予支付。	10	無	111/11/01
22	CRT02PAE1394	“維立”氣切套管- 小兒用	“Well Lead” Tracheostomy Tube- Paediatric	(A02A05-30;35;40;45;50;55;60-1F);(A02A06- 30;35;40;45;50;55;60-3F)	支	衛部醫器陸輪 字第001330號	博宣寧	893	依CRT01T3(小兒氣切套管)同功能類別品項 (如特材代碼CRT02PAE309W)之支付點數暫予 支付。	4	無	111/11/01
23	CRT02UCF3F94	“維立”氣切套管- 無氣囊	“Well Lead” Tracheostomy Tube- Uncuffed	A02A06-65;70;75;80;85;90;95;96-3F	支	衛部醫器陸輪 字第001330號	博宣寧	325	依CRT02T2(氣切套管(單管,無氣囊))同功能 類別品項(如特材代碼CRT02UCF659W)之支付 點數暫予支付。	8	無	111/11/01
24	CVC01NAV7190	“鐵克諾武”索芙 娜血管攝影導管	“Technowood” SoftNAV Angiographic Catheter	(H710-FL;SL- 418;518;420;520;422;522;419;519;421;521;423;52 3);(H710-FL;SL-418;420;422;419;421;423- JSH);(H710-FL;SL-518;520;522;519;521;523- TJ);(SVH3-FL;SL- 418;518;420;520;419;519;421;521-SH);(H710- FL;SL- 4060;5060;4013;5013;4012;5012;4011;5011;4361;5 361;4363;5363;4362;5362;4122;5122;4123;5123;44 5SH;545;446SH;546;401SH;548;4601;5601;4661;566 1;4662;5662;4671;5671;4672;5672;5307;5308;5309);(H710-FL;SL- 4711;5711;4713;5713;4731;5731;4733;5733;4741;5 741;4743;5743;4751;5751;4753;5753-M)	組	衛部醫器輸字 第035349號	博宣寧	543	依CVA01A1(房室,心臟血管及周邊血管攝影 導管/ANGIOGRAPHIC CATHETER ANY CURVE) 同功能類別品項(如特材代碼CVC01CAPGTMR) 之支付點數暫予支付。	56	無	111/11/01
25	FBHBA1000AS2	“好美得卡-奧斯得 寧”人工雙極式髖關 節系統	“HOWMEDICA- OSTEONICS” Accolade HIP SYSTEM:HA BIPOLAR SYSTEM	由以下特材代碼組 合:FBHB1UH10NS2;FBHH11260NS2;FBHH16269NS2;FBHS 1672XNS2	組	衛署醫器輸字 第021427號+ 衛署007998+ 衛部029701 + 衛部029020號	史賽克	35,195	依FBHBA1(雙極式人工髖關節組 (BIPOLARHIPSYSTEM/STEM+HEAD+CUP+INSERT))同功能類別品項(如特材代碼 FBHBA2000NS2)之支付點數暫予支付。	14	無	111/11/01
26	FBHH16269NS2	“史賽克”股骨頭	“Stryker” LFIT V40 Femoral Head	(6260-9-1:3-22);(6260-9-0:4-26;28;32)	個	衛部醫器輸字 第029701號	史賽克	4,352	依FBHH1A1(全人工髖關節股骨頭 TOTAL HIP FEMORAL HEAD)同功能類別品項(如特材代碼 FBHS11170NS2)之支付點數暫予支付。	14	無	111/11/01
27	FBHPA1000AS2	“好美得卡奧斯得 寧”全人工髖關節系 統	“HOWMEDICA OSTEONICS” Accolade HIP SYSTEM	由以下特材代碼組 成:FBHS1672XNS2;FBHC154NXNS2;FBHH16260NS2;FBHH 16269NS2;FBHL16200NS2;FBHL16201NS2;FBHL11236NS 2	組	衛部醫器輸字 029020+衛署 010293 +衛署 019147+衛部 029701+衛署 011235+衛署 022771+衛署 019314號+衛 署024932號	史賽克	39,396	依FBHPA1(全人工髖關節組(PRIMARY HIP SYSTEM/STEM+HEAD+CUP+INSERT))同功能類 別品項(如特材代碼FBHPA1000NS2)之支付點 數暫予支付。	21	無	111/11/01

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共120項(項次1~項次120,詳頁次1-1~1-14)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至111年9月 同功能/類似功 能核價類別之 有效品項數	給付規定	健保給付 生效日期
28	FBHS1672XNS2	"好美得卡 奧斯得寧"愛克雷股骨柄	"Howmedica Osteonics" Accolade II Stem	(6720-0027;0127;0230;0330;0435,0535;0635;0737;0837;0937;1040;1140);(6721-0027;0127;0230;0330;0435,0535;0635;0737;0837;0937;1040;1140)	個	衛部醫器輸字第029020號	史賽克	20,692	依FBHS1A1(人工髖關節股骨柄(TOTAL HIP STEM 或 BIPOLAR HIP STEM))同功能類別品項(如特材代碼FBHS11170NS2)之支付點數暫予支付。	23	無	111/11/01
29	FBKA2AGMNT46	羅斯霸膝關節置換系統:加強塊	LOSPA Total Knee Replacement System: augment	(K4.FD2.-03:09;11:14;16-05;10;15-ASY);(K4.TH2.-03:09;11:14;16-05;10;15-ASY);(K4.FP2.-03:09;11:14;16-05;10-ASY)	個	衛部醫器輸字第035398號	立鼎	2,989	依FBKA2A1(REVISION KNEE WEDGE(FEMORAL、TIBIAL))同功能類別品項(如特材代碼FBKA215230DP)之支付點數暫予支付。	13	D108-1	111/11/01
30	FBKE2STEM146	羅斯霸膝關節置換系統:延伸幹	LOSPA Total Knee Replacement System: stem extension	(K2.C-09:15.0-010;020;030;060;090;120;150;180);(K2.C-16:20.0-030;060;090;120;150;180);(K2.BXP.1510)	個	衛部醫器輸字第035398號	立鼎	5,682	依FBKE2A1(STEM EXTENSION(TIBIAL、FEMORAL))同功能類別品項(如特材代碼FBKE215121DP)之支付點數暫予支付。	13	D108-1	111/11/01
31	FBKF1CRPSC46	羅斯霸膝關節置換系統:股骨組件	LOSPA Total Knee Replacement System: femoral component	(01.10.00-1;3:9;B;C;D;E;G);(01.10.02-1;3:9;B;C;D;E;G);(01.10.04-1;3:9;B;C;D;E;G);(01.10.06-1;3:9;B;C;D;E;G)	個	衛部醫器輸字第035398號	立鼎	18,197	依FBKF1A1(TOTAL KNEE/FEMORAL COMPONENT(PRIMARY、REVISION))同功能類別品項(如特材代碼FBKF10410NJJ)之支付點數暫予支付。	39	D108-1	111/11/01
32	FBKF2FMC0146	羅斯霸膝關節置換系統:組合式股骨組件	LOSPA Total Knee Replacement System: modular femoral component	K2.FB-L.;R.-4553;5159;5462;5765;6065;6068;6368;6371;6674;6974;6977;7277	個	衛部醫器輸字第035398號	立鼎	18,197	依FBKF1A1(TOTAL KNEE/FEMORAL COMPONENT(PRIMARY、REVISION))同功能類別品項(如特材代碼FBKF26001NJJ)之支付點數暫予支付。	39	D108-1	111/11/01
33	FBKT1TB00146	羅斯霸膝關節置換系統:脛骨組件	LOSPA Total Knee Replacement System: tibial baseplate	01.10.50-1;3:9;B;C;D;E;G	個	衛部醫器輸字第035398號	立鼎	14,031	依FBKT1A1(TOTAL KNEE/TIBIAL BASE COMPONENT)同功能類別品項(如特材代碼FBKT15321NZ1)之支付點數暫予支付。	31	D108-1	111/11/01
34	FBKT2TMC0146	羅斯霸膝關節置換系統:組合式脛骨組件	LOSPA Total Knee Replacement System: modular tibial baseplate	K2.BFN.-3655;4061;4264;4467;4570;4672;4872;4874;5076;5281;5484;5684;5886-ASM	個	衛部醫器輸字第035398號	立鼎	14,031	依FBKT1A1(TOTAL KNEE/TIBIAL BASE COMPONENT)同功能類別品項(如特材代碼FBKT286000JJ)之支付點數暫予支付。	31	D108-1	111/11/01
35	FBKUA1800NS2	"美酷"單側人工膝關節系統	"MAKO" RESTORIS MCK Unicompartmental Knee System	由以下特材代碼組合: FBUF41805FS2;FBUF41806TS2;FBUF41807NS2	組	衛部醫器輸字第026336號	史賽克	44,983	依FBKUA1(UNI KNEE SYSTEM半膝關節組(FEMORAL+TIBIAL+INSERT))同功能類別品項(如特材代碼 FBKUA1592USN)之支付點數暫予支付。	3	D108-3	111/11/01
36	FBP0621016Y2	"亞太醫療"正童小兒骨板系統-8字型骨板+骨釘	"SYNTEC" Pediatric Plate System-8 Plate+Screw	【Plate:(PDT-220-12;14;16;18;20;22;024);(Screw:204-010;045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100;105;110);(214-620;622;624;626;628;630;632;634;636;638;640;642;644;646;648;650;652;654;656;660;664;668;672)】	組	衛部醫器製字第007183號+衛署醫器製字第000728號	亞太醫療	39,951	依FBP06B1(兒童長骨畸形矯正骨板系統)同功能類別品項(如特材代碼FBP06305704K)之支付點數暫予支付。	3	D203-4	111/11/01
37	FBPR1S240P78	"潔和"亞理士胸骨及肋骨固定系統-肋骨骨板	"Jeil" ARIX Sternal system-Sternal and Rib Plates-rib locking plate	(S24-STRB-004;006;008;010);(S24-CVRB-004;006;008)	個	衛部醫器輸字第033826號	橋河	38,151	依FBPR1P1(肋骨固定骨板)同功能類別品項(如特材代碼FBPR1RFBPRWR)之支付點數暫予支付。	10	D203-5	111/11/01

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共120項(項次1~項次120,詳頁次1-1~1-14)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至111年9月 同功能/類似功 能核價類別之 有效品項數	給付規定	健保給付 生效日期
38	FBS0173583V2	“鑲鈦”胸肋骨板系統-皮質自攻骨釘2.9mm	“INTAI” RIB Fixation System-Cortical Screw2.9mm	4B2070-10;12	支	衛部醫器製字第007358號	鑲鈦	182	依FBS01T1(TITANIUM CORTEX SCREW SMALL AND MINI FRAGMENTS(3.5, 2.7, 2.0, 1.5MM))同功能類別品項(如特材代碼FBS0141006V2)之支付點數暫予支付。	4	無	111/11/01
39	FBSFINS20146	“羅斯霸”脊椎固定系統二節	“LOSPA” IS Spinal Fixation System(S*4+R*2)	由以下特材代碼組合:FBSF4NPS0146、FBSF2NRS0146	組	衛部醫器輸字第035183號	立鼎	13,816	依FBSF12T(TITANIUM SPINAL PLATE SYSTEM二節(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF108SP14J)之支付點數暫予支付。	29	無	111/11/01
40	FBSFINS30146	“羅斯霸”脊椎固定系統三節	“LOSPA” IS Spinal Fixation System(S*6+R*2)	由以下特材代碼組合:FBSF4NPS0146、FBSF2NRS0146、FBSF2NRL0146	組	衛部醫器輸字第035183號	立鼎	20,044	依FBSF13T(TITANIUM SPINAL PLATE SYSTEM三節(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF108SP24J)之支付點數暫予支付。	27	無	111/11/01
41	FBSF1PS20146	“羅斯霸”脊椎固定系統二節	“LOSPA” IS Spinal Fixation System(R*2+S*4)	由以下特材代碼組合:FBSF4PPS0146、FBSF2PRS0146	組	衛部醫器輸字第035183號	立鼎	23,358	依FBSF1T2(TITANIUM SPINAL SYSTEM二節(SCREWX4+RODX2))同功能類別品項(如特材代碼FBSF101626B0)之支付點數暫予支付。	42	D112-1	111/11/01
42	FBSF1PS30146	“羅斯霸”脊椎固定系統三節	“LOSPA” IS Spinal Fixation System(R*2+S*6)	由以下特材代碼組合:FBSF4PPS0146、FBSF2PRS0146、FBSF2PRL0146	組	衛部醫器輸字第035183號	立鼎	34,118	依FBSF1T3(TITANIUM SPINAL SYSTEM三節(SCREWX6+RODX2))同功能類別品項(如特材代碼FBSF148233S9)之支付點數暫予支付。	42	D112-1	111/11/01
43	FBSF1SFP2L85	健寶脊椎固定系統-二節(SX4+RX2)	JBone Spinal Fixation System-2 Level	由以下特材代碼組合:FBSF43103285;FBSF23107S85	組	衛部醫器製字第007367號	健寶生技	23,358	依FBSF1T2(TITANIUM SPINAL SYSTEM二節(SCREWX4+RODX2))同功能類別品項(如特材代碼FBSF1000021A)之支付點數暫予支付。	42	D112-1	111/11/01
44	FBSF1SFP3L85	健寶脊椎固定系統-三節(SX6+RX2)	JBone Spinal Fixation System-3 Level	由以下特材代碼組合:FBSF43103285;FBSF23107L85	組	衛部醫器製字第007367號	健寶生技	34,118	依FBSF1T3(TITANIUM SPINAL SYSTEM三節(SCREWX6+RODX2))同功能類別品項(如特材代碼FBSF1000031A)之支付點數暫予支付。	42	D112-1	111/11/01
45	FBSF1SFS2L85	健寶脊椎固定系統-二節(SX4+RX2)(免事前審查)	JBone Spinal Fixation System-2 Level	由以下特材代碼組合:FBSF43101285;FBSF23105S85	組	衛部醫器製字第007367號	健寶生技	13,816	依FBSF12T(TITANIUM SPINAL PLATE SYSTEM二節(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF1ESS2LM4)之支付點數暫予支付。	29	無	111/11/01
46	FBSF1SFS3L85	健寶脊椎固定系統-三節(SX6+RX2)(免事前審查)	JBone Spinal Fixation System-3 Level	由以下特材代碼組合:FBSF43101285;FBSF23105L85	組	衛部醫器製字第007367號	健寶生技	20,044	依FBSF13T(TITANIUM SPINAL PLATE SYSTEM三節(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF1ESS3LM4)之支付點數暫予支付。	27	無	111/11/01
47	FBSF23105L85	健寶脊椎固定系統-長節固定桿(115;600mm)(免事前審查)	JBone Spinal Fixation System: Rod(L)	(3105.55-115;120;125;130;135;140;145;150;155;160;165;170;175;180;185;190;195;200;205;210;215;220;225;230;235;240;245;250;300;350;400;450;500;550;600-2)	支	衛部醫器製字第007367號	健寶生技	1,419	依FBSF2S3(TITANIUM SPINAL ROD(長節110MM(含)以上)(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF2000F41A)之支付點數暫予支付。	25	無	111/11/01
48	FBSF23105S85	健寶脊椎固定系統-短節固定桿(40;110mm)(免事前審查)	JBone Spinal Fixation System: Rod(S)	(3105.55-040;045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100;105;110-2)	支	衛部醫器製字第007367號	健寶生技	679	依FBSF2S2(TITANIUM SPINAL ROD(短節<110MM)(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF2050605H)之支付點數暫予支付。	26	無	111/11/01
49	FBSF23107L85	健寶脊椎固定系統-長節固定桿	JBone Spinal Fixation System: Long Rod	(3105.57-115;120;125;130;135;140-2)	支	衛部醫器製字第007367號	健寶生技	2,662	依FBSF2TL(TITANIUM SPINAL ROD(長節))同功能類別品項(如特材代碼FBSF2G62LRG0)之支付點數暫予支付。	36	D112-1	111/11/01
50	FBSF23107S85	健寶脊椎固定系統-短節固定桿	JBone Spinal Fixation System: Short Rod	(3105.57-040;045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100;105;110-2)	支	衛部醫器製字第007367號	健寶生技	919	依FBSF2TR(TITANIUM SPINAL ROD OR PLATE(短節))同功能類別品項(如特材代碼FBSF2G62SRG0)之支付點數暫予支付。	36	D112-1	111/11/01

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共120項(項次1~項次120,詳頁次1-1~1-14)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至111年9月 同功能/類似功 能核價類別之 有效品項數	給付規定	健保給付 生效日期
51	FBSF2NRL0146	“羅斯霸” 脊椎固定系統:長固定桿	“LOSPA” IS Spinal Fixation System:ROD	SA. R55. 01-10;20;30;40;50;60;70	個	衛部醫器輸字第035183號	立鼎	1,419	依FBSF2S3(TITANIUM SPINAL ROD(長節110MM(含)以上)(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF216002XP)之支付點數暫予支付。	25	無	111/11/01
52	FBSF2NRS0146	“羅斯霸” 脊椎固定系統:短固定桿	“LOSPA” IS Spinal Fixation System:ROD 40;100MM	SA. R55. 0-040;050;060;070;080;090;100	個	衛部醫器輸字第035183號	立鼎	679	依FBSF2S2(TITANIUM SPINAL ROD(短節<110MM)(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF255160DP)之支付點數暫予支付。	26	無	111/11/01
53	FBSF2PRL0146	“羅斯霸” 脊椎固定系統:固定桿長節	“LOSPA” IS Spinal Fixation System:ROD	SA. R-1;2-6. 0-110;120;130;140;150	個	衛部醫器輸字第035183號	立鼎	2,662	依FBSF2TL(TITANIUM SPINAL ROD(長節))同功能類別品項(如特材代碼FBSF2785NLY2)之支付點數暫予支付。	36	D112-1	111/11/01
54	FBSF2PRS0146	“羅斯霸” 脊椎固定系統:固定桿短節	“LOSPA” IS Spinal Fixation System:ROD 30;100MM	SA. R-1;2-6. 0-030;040;050;060;070;080;090;100	個	衛部醫器輸字第035183號	立鼎	919	依FBSF2TR(TITANIUM SPINAL ROD OR PLATE(短節))同功能類別品項(如特材代碼FBSF248232S9)之支付點數暫予支付。	36	D112-1	111/11/01
55	FBSF33109H85	健寶脊椎固定系統-固定鈎	JBone Spinal Fixation System: HOOK	(3109. 104;108;209;308;408-052;072;092)	支	衛部醫器製字第007367號	健寶生技	3,311	依FBSF3TH(TITANIUM SPINAL HOOK)同功能類別品項(如特材代碼FBSF3BA001RK)之支付點數暫予支付。	14	D112-1	111/11/01
56	FBSF43101285	健寶脊椎固定系統-萬向中空皮質螺釘(免事前審查)	JBone Spinal Fixation System: Poly cannulated screw	(3101. 45;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95;10-030;035;040;045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100-2)	支	衛部醫器製字第007367號	健寶生技	3,114	依FBSF4S3(TITANIUM SPINAL SCREW(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF412361XP))之支付點數暫予支付。	37	無	111/11/01
57	FBSF43103285	健寶脊椎固定系統-萬向中空皮質長螺釘	JBone Spinal Fixation System: Poly cannulated long-arm screw	(3103. 45;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95;10-030;035;040;045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100-2)	支	衛部醫器製字第007367號	健寶生技	4,465	依FBSF4TS(TITANIUM SPINAL SCREW)同功能類別品項(如特材代碼FBSF44009TWG)之支付點數暫予支付。	70	D112-1	111/11/01
58	FBSF43111887	鈦亞脊椎固定系統-萬向骨鬆皮質螺釘	TiA Spinal Fixation System:Poly fenestrated screw	(3111. 45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95;10-030;035;040;045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100-8)	支	衛署醫器製字第007368號	健寶生技	11,812	依FBSF4TP(鈦合金脊椎內固定釘(適用於經診斷為骨質疏鬆症之患者))同功能類別品項(如特材代碼FBSF41600NB0)之支付點數暫予支付。	20	D112-5	111/11/01
59	FBSF4NPS0146	“羅斯霸” 脊椎固定系統:脊椎骨釘多軸向	“LOSPA” IS Spinal Fixation System:POLY-AXIAL U TYPE	(SA. 225. -40;45;50;55;60;65;70;75-25;30;35;40;45;50;55);(SA. 225. -4020;4520;5020;5520);(SA. 225. 85-30;35;40;45;50;55)	個	衛部醫器輸字第035183號	立鼎	3,114	依FBSF4S3(TITANIUM SPINAL SCREW(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF44006TV2)之支付點數暫予支付。	37	無	111/11/01
60	FBSF4PPS0146	“羅斯霸” 脊椎固定系統:脊椎骨釘引導中空U型	“LOSPA” IS Spinal Fixation System:GUIDED/CANNULATED PEDICLE SCREW U TYPE	(SA. 227. -40;45;50;55;60;65;70;75-25;30;35;40;45;50;55);(SA. 227. -40;45;50;55-20);(SA. 227. 85-30;35;40;45);(SA. 60-7-8. -55;65;75-25;30;35;40;45;50;55)	個	衛部醫器輸字第035183號	立鼎	4,465	依FBSF4TS(TITANIUM SPINAL SCREW)同功能類別品項(如特材代碼FBSF412261XP)之支付點數暫予支付。	70	D112-1	111/11/01
61	FBSF53107585	健寶脊椎固定系統-橫向連接器	JBone Spinal Fixation System: Transverse link	(3107. 55-040;050;060;070;080;090;000-2)	個	衛部醫器製字第007367號	健寶生技	6,108	依FBSF5TC(TITANIUM SPINAL CROSSLINK)同功能類別品項(如特材代碼FBSF517022XP)之支付點數暫予支付。	44	D112-1	111/11/01

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共120項(項次1~項次120,詳頁次1-1~1-14)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至111年9月 同功能/類似功 能核價類別之 有效品項數	給付規定	健保給付 生效日期
62	FBSF53107685	健寶脊椎固定系統- 橫向連接器(免事前 審查)	JBone Spinal Fixation System: Transverse link	(3107.60-040;050;060;070;080;090;000-2)	個	衛部醫器製字 第007367號	健寶生 技	2,661	依FBSF5S2(TITANIUM SPINAL CROSSLINK(免 事前審查))同功能類別品項(如特材代碼 FBSF517021XP)之支付點數暫予支付。	27	無	111/11/01
63	FBSFAPLF0146	“羅斯霸” 脊椎椎 間融合器系統(後開 型)	“LOSPA” IS Spinal Cage System(PLIF)	SC. B04. 22-08:16;SC. B08. 22-09:16;SC. B04. 25- 09:16;SC. B08. 25-10:16	個	衛部醫器輸字 第035159號	立鼎	21,017	依FBSFAA5(PLIF PEEK CAGE 脊椎後開型間 體護架)同功能類別品項(如特材代碼 FBSFA1000NZ1)之支付點數暫予支付。	22	D112-4	111/11/01
64	FBSFATLF0146	“羅斯霸” 脊椎椎 間融合器系統(側開 型)	“LOSPA” IS Spinal Cage System(TLIF)	SC. B04. 28-09:16;SC. B08. 28-10:16;SC. B04. 31- 09:16;SC. B08. 31-10:16;SC. B00. 3408;SC. B04. 34- 09:16;SC. B08. 34-12:16	個	衛部醫器輸字 第035159號	立鼎	41,355	依FBSFAA3(TLIF PEEK SYSTEM (脊椎側開 型,每節椎體置放一個))同功能類別品項(如 特材代碼FBSFA045233Z)之支付點數暫予支 付。	37	D112-4	111/11/01
65	FBSFC88801Y2	“亞太醫療” 龍頭 柱系統-枕頸椎多軸 釘	“SYNTEC” Occipital- Cervical-Upper Thoracic Fixation System-Occipital Polyaxial Screw	(888- 008;010;012;014;016;018;020;022;024;026;028;03 0;108;110;112;114;116;118;120;122;124;126;128; 130)	支	衛部醫器製字 第007380號	亞太醫 療	10,186	依FBSFCS3(頸椎後側固定系統-多軸頸椎骨 釘)同功能類別品項(如特材代碼 FBSFC08318S1)之支付點數暫予支付。	9	D112-7	111/11/01
66	FBSFC88802Y2	“亞太醫療” 龍頭 柱系統-枕骨板	“SYNTEC” Occipital- Cervical-Upper Thoracic Fixation System-Occipital Plate	(888-231;237;245)	支	衛部醫器製字 第007380號	亞太醫 療	11,827	依FBSFCCP(頸椎後側固定系統-T型或蝴蝶型 枕骨固定板)同功能類別品項(如特材代碼 FBSFCSW200BB)之支付點數暫予支付。	4	D112-7	111/11/01
67	FBSFC88803Y2	“亞太醫療” 龍頭 柱系統-枕頸椎骨釘	“SYNTEC” Occipital- Cervical-Upper Thoracic Fixation System-Occipital Screw	(888-306;316;406;416)	支	衛部醫器製字 第007380號	亞太醫 療	8,237	依FBSFCS1(頸椎後側固定系統-枕骨骨釘)同 功能類別品項(如特材代碼FBSFC04CTSS1)之 支付點數暫予支付。	5	D112-7	111/11/01
68	FBSFC88804Y2	“亞太醫療” 龍頭 柱系統-萬向連接器	“SYNTEC” Occipital- Cervical-Upper Thoracic Fixation System-Universal Link	(888-550;560;570)	支	衛部醫器製字 第007380號	亞太醫 療	7,208	依FBSFCC1(頸椎後側固定系統-橫連結器組) 同功能類別品項(如特材代碼FBSFCSW005BB) 之支付點數暫予支付。	7	D112-7	111/11/01
69	FBSFC88805Y2	“亞太醫療” 龍頭 柱系統-直刀椎板鉤	“SYNTEC” Occipital- Cervical-Upper Thoracic Fixation System-Laminar Hooks	888601;888602	支	衛部醫器製字 第007380號	亞太醫 療	5,375	依FBSFCH1(頸椎後側固定系統-骨鉤,固定 夾)同功能類別品項(如特材代碼 FBSFC07189S1)之支付點數暫予支付。	8	D112-7	111/11/01

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共120項(項次1~項次120,詳頁次1-1~1-14)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至111年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
70	FBSFC88807Y2	“亞太醫療”龍頭柱系統-連接桿(110mm:250mm)	“SYNTEC” Occipital-Cervical-Upper Thoracic Fixation System-Connect Rod(110mm:250mm)	(888-700;811;812;815)	支	衛部醫器製字第007380號	亞太醫療	3,700	依FBSFCRL(頸椎後側固定系統-長固定桿,長固定板)同功能類別品項(如特材代碼FBSFCSW198BB)之支付點數暫予支付。	10	D112-7	111/11/01
71	FBSFC88808Y2	“亞太醫療”龍頭柱系統-皮質自攻骨釘	“SYNTEC” Occipital-Cervical-Upper Thoracic Fixation System-Cortex Screw	888-910:916	支	衛部醫器製字第007380號	亞太醫療	807	依FBSFCSA(TITANIUM ANTERIOR CERVICAL SCREW)同功能類別品項(如特材代碼FBSFC4020NS9)之支付點數暫予支付。	20	D112-3	111/11/01
72	FBSR1S2XLS78	“潔和”亞理士胸骨及肋骨固定系統-肋骨骨釘	“Jeil” ARIX Sternal system-Sternal and Rib Plates-rib locking screw	【(S24L-SA-006:018-TA);(S24L-SA-006:018-T);(S24L-SA-S06:S18-TA);(S27L-SA-006:018-TA);(S27L-SA-006:020-T);(S27L-SA-S06:S20-TA)】;【(S24L-SA-006:018-TA-2);(S24L-SA-006:18-T-2);(S24L-SA-S06:S18-TA-2);(S27L-SA-006:018-TA-2);(S27L-SA-006:020-T-2);(S27L-SA-S06:S20-TA-2)(1包2支裝,本特材支付以「支」為單位)】;【(S24L-SA-006:018-TA-4);(S24L-SA-006:018-T-4);(S24L-SA-S06:S18-TA-4);(S27L-SA-006:018-TA-4);(S27L-SA-006:020-T-4);(S27L-SA-S06:S20-TA-4)(1包4支裝,本特材支付以「支」為單位)】	支	衛部醫器輸字第033826號	橋河	5,100	依FBSR1A1(肋骨鎖定骨釘)同功能類別品項(如特材代碼FBSR1RFBR5WR)之支付點數暫予支付。	10	D203-5	111/11/01
73	FBT01RF0019A	關樂關節腔注射劑	Rekneef Intra-articular Injection	3毫升/支	支	衛部醫器製字第007391號	永信	2,626	依FBT01A5(關節內注射劑(每個療程1次,療效6個月))同功能類別品項(如特材代碼FBT01AB305LB)之支付點數暫予支付。	3	D109-1	111/11/01
74	FBT01VK001V0	飛捷益關節腔注射劑	VEJOKNEE Synovial Fluid Supplement	3.0ml	支	衛部醫器製字第007392號	科妍	2,626	依FBT01A5(關節內注射劑(每個療程1次,療效6個月))同功能類別品項(如特材代碼FBT01HYRN2LJ)之支付點數暫予支付。	3	D109-1	111/11/01
75	FBUF41805FS2	“美酷”單側人工膝關節系統-股骨組件	“MAKO” RESTORIS MCK Unicompartmental Knee System-FEMORAL COMPONENT	(18050-1:8);(18051-1:8)	個	衛部醫器輸字第026336號	史賽克	23,268	依FBKUF1(UNI KNEE FEMORAL)同功能類別品項(如特材代碼FBUF422371SN)之支付點數暫予支付。	4	D108-3	111/11/01
76	FBUF41806TS2	“美酷”單側人工膝關節系統-脛骨盤	“MAKO” RESTORIS MCK Unicompartmental Knee System-Tibial Baseplate	(18060-1:8);(18061-1:8)	個	衛部醫器輸字第026336號	史賽克	14,735	依FBKUTA1(UNI KNEE TIBIAL)同功能類別品項(如特材代碼FBUT422431SN)之支付點數暫予支付。	5	D108-3	111/11/01
77	FBUF41807NS2	“美酷”單側人工膝關節系統-脛骨襯墊	“MAKO” RESTORIS MCK Unicompartmental Knee System-Tibial Insert	(18070-1:8-1:9)	個	衛部醫器輸字第026336號	史賽克	6,980	依FBKULA1(UNI KNEE INSERT)同功能類別品項(如特材代碼FBUL422241SN)之支付點數暫予支付。	4	D108-3	111/11/01

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共120項（項次1~項次120，詳頁次1-1~1-14）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至111年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
78	FBUF45610FS2	“好美得卡 奧斯得寧”三項能局部人工膝關節系統-股骨組件	“Howmedica Osteonics” Triathlon Partial Knee Resurfacing-Femofral Component	5610-F-101:102;201:202;301:302;401:402;501:502;601:602	個	衛部醫器輸字第030018號	史賽克	23,268	依FBKUF1(UNI KNEE FEMORAL)同功能類別品項(如特材代碼FBUF422371SN)之支付點數暫予支付。	4	D108-3	111/11/01
79	FBUF45620BS2	“好美得卡 奧斯得寧”三項能局部人工膝關節系統-脛骨盤	“Howmedica Osteonics” Triathlon Partial Knee Resurfacing-Tibial baseplate	5620-B-101:102;201:202;301:302;401:402;501:502;601:602	個	衛部醫器輸字第030018號	史賽克	14,735	依FBKUT1(UNI KNEE TIBIAL)同功能類別品項(如特材代碼 FBUF422431SN)之支付點數暫予支付。	5	D108-3	111/11/01
80	FHX04MEH2C95	“賽耐司”美德思管路組(ECMO長效型人工心肺套含 OXYGENATOR+PUMP HEAD+TUBING SET+CUVETTE+TRANSDUCER*3+IV SET)	“Xenios” Medos Tubing Sets	MEH2C3792;MEH2C3793	組	衛署醫器輸字第022065號	興東	57,071	依FHX04AR(長效型人工心肺套 W/OXYGENATOR+PUMPHEAD+TUBINGSET(ECMO)+TRANSDUCER+CUVETTE)同功能類別品項(如特材代碼FHX04MEH2CML)之支付點數暫予支付。	1	B201-2	111/11/01
81	FHX04XYTFL95	“賽耐司”美德思管路組(ECMO長效型人工心肺組)	“Xenios” Medos Tubing Sets:OXYGENATOR+DISPOSABLE PROBE+TUBING SET	MEH2C2805	組	衛署醫器輸字第022065號	興東	36,660	依FHX04AL(人工心肺套W/長效型人工心肺+DISPOSABLE PROBE+TUBING SET(ECMO))同功能類別品項(如特材代碼FHX04XYTFLML)之支付點數暫予支付。	1	B201-2	111/11/01
82	FHX04XYTUB95	“賽耐司”美德思管路組(ECMO長效型人工心肺組)	“Xenios” Medos Tubing Sets:OXYGENATOR+TUBING SET	MEH2C3667;MEH2C2380;MEH2C2752	組	衛署醫器輸字第022065號	興東	35,346	依FHX04AK(人工心肺套W/長效型人工心肺+TUBING SET(ECMO))同功能類別品項(如特材代碼FHX04XYTUBML)之支付點數暫予支付。	1	B201-2	111/11/01
83	FPP0250383S1	“信迪思”下顎固定系統-下顎下關節骨板	“Synthes” MatrixMANDIBLE System-Subcondylar Plate	(04.503.830:834)	個	衛署醫器輸字第020324號	壯生	4,895	健保收載品項並無與本案特材相同之骨板類別，目前臨床上針對下顎下關節骨折之固定方式為使用2支健保鈦金屬mini plates(核價類別FPP02A1)，健保支付點數計5,124點(2,562*2)，廠商建議本案特材比照另一核價類別「MRS RECONSTRUCTION、COMPRESSION PLATE 6:10HOLE ANGLE(FPP02A3)」之支付點數4,895點納入健保給付，經請本署遴聘之2位臨床專家審查表示，本特材具有簡易操作及省時的優點，相較於現行使用2支mini plates，整體而言較為優異，廠商建議以較低的支付點數納入健保給付，爰同意新增核價類別「MRS MANDIBLE SUBCONDYLAR PLATE 4:7 HOLE特殊型(FPP02A5)」，支付點數以4,895點暫予支付。	0	D201-1	111/11/01

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共120項（項次1~項次120，詳頁次1-1~1-14）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至111年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
84	FPP07NBP01AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微鑽孔蓋骨板5/6孔;0.4mm厚	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-BURR HOLE PLATE 5/6 Hole	NBP304S06A;NBP304M06A;NBP304L06A;NBP304X06A;NB S304S05A;NBS304M05A;NBS304L05A;NBS304X05A;NBC3 04M06A;NBC304L06A	個	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	5,823	依FPP0700(MICRO BURR HOLE PLATE)同功能類別品項(如特材代碼FPP07FM971AE)之支付點數暫予支付。	16	D201-1	111/11/01
85	FPP07NDS01AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微方形骨板3x2孔;0.4mm厚	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-Double Square Plate 6 Hole	NDS304M06A	個	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	4,826	依FPP07BB(MICRO BONE PLATE 3X2 HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP07FM969AE)之支付點數暫予支付。	15	D201-1	111/11/01
86	FPP07NDY01AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微雙Y型骨板6孔;0.4mm厚	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-Double Y Plate 6 Hole	NDY304M06A;NDY304L06A	個	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	5,546	依FPP07YD(MICRO X-PLATE(DOUBLE Y)4:10HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP07FM966AE)之支付點數暫予支付。	21	D201-1	111/11/01
87	FPP07NME01AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微網狀型骨板;0.4mm厚	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-Mesh Plate	NME103S00;NME103M00	個	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	10,663	依FPP07EC(MICRO MESH PLTAE)同功能類別品項(如特材代碼FPP07FM973AE)之支付點數暫予支付。	12	D201-5	111/11/01
88	FPP07NQD01AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微方形骨板4x2孔;0.4mm厚	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-Matrix Plate 8 Hole	NQD304M08A;NQD304L08A	個	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	6,558	依FPP07BC(MICRO BONE PLATE 4X2 HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP07FM970AE)之支付點數暫予支付。	16	D201-1	111/11/01
89	FPP07NSQ01AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微方形骨板2x2孔;0.4mm厚	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-Square/Rectangular Plate 4 Hole	NSQ304M04A;NSQ304L04A;NSQ304X04A;NRE304M04A	個	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	3,433	依FPP07BA(MICRO BOX PLATE 2X2 HOLES)同功能類別品項(如特材代碼FPP07FM968AE)之支付點數暫予支付。	19	D201-1	111/11/01
90	FPP07NST01AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微直型骨板 2-5孔;0.4mm厚	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-Straight Plate 2-5 Hole	NST304L02A;NST304X02A;NST304L04A;NST304X04A;NS T304M05A	個	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	2,431	依FPP07SA(MICRO PLATE 2:5HOLE STR)同功能類別品項(如特材代碼FPP07F1005WR)之支付點數暫予支付。	18	D201-1	111/11/01
91	FPP07NST02AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微直型骨板6/10孔;0.4mm厚	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-Straight Plate 6/10 Hole	NST304M06A;NST304M10A	個	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	2,599	依FPP07SB(MICRO PLATE 6:10HOLE STR)同功能類別品項(如特材代碼FPP07N7050WR)之支付點數暫予支付。	13	D201-1	111/11/01

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共120項(項次1~項次120,詳頁次1-1~1-14)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至111年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
92	FPP07NST03AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微直型骨板20孔;0.4mm厚	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-Straight Plate 20 Hole	NST304M20A	個	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	3,981	依FPP07SC(MICRO PLATE 11:24HOLE STR)同功能類別品項(如特材代碼FPP075032NS1)之支付點數暫予支付。	13	D201-1	111/11/01
93	FPP07NXP01AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微X型骨板4孔;0.4mm厚	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-X Plate 4 Hole	NXP304M04A	個	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	5,546	依FPP07YD(MICRO X-PLATE(DOUBLE Y)4:10HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP07FM966AE)之支付點數暫予支付。	21	D201-1	111/11/01
94	FPP07NYP01AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微Y型骨板5孔;0.4mm厚	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-Y Plate 5 Hole	NYP304M05A	個	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	4,614	依FPP07YA(MICRO Y-PLATE 4:13HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP07FM964AE)之支付點數暫予支付。	15	D201-1	111/11/01
95	FPP07TCN11AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微直型骨板2孔*3+骨釘*6	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-Sterile Kit(straight plate 2 hole*3+screw*6)	TCN-011;TCN-021	組	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	15,081	依FPP07SE(MICRO PLATE 2 HOLE STR*3+SCREW*6)同功能類別品項(如特材代碼FPP0718001EJ)之支付點數暫予支付。	3	D201-1	111/11/01
96	FPP07TCN12AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微直型骨板2孔*5+骨釘*10	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-Sterile Kit(straight plate 2 hole*5+screw*10)	TCN-012;TCN-022	組	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	25,135	依下列組件支付點數及數量合併計算暫予支付: 1、FPP07SA「MICRO PLATE 2:5HOLE STR」(支付點數2,431點)*5 2、FPS01MS「MICRO SCREW(ANY SIZE)」(支付點數1,298點)*10	0	D201-1	111/11/01
97	FPP07TCN31AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微鑽孔蓋骨板6孔*1+直型骨板2孔*2+骨釘*10	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-Sterile Kit(Burrhole plate 6 hole*1+straight plate 2 hole*2+screw*10)	TCN-031	組	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	23,665	依FPP07SH(BURR HOLE *1+MICRO PLATE 2 HOLE STR*2+ SCREW*10)同功能類別品項(如特材代碼FPP0717310WR)之支付點數暫予支付。	2	D201-1	111/11/01
98	FPP07TCN41AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微鑽孔蓋骨板6孔*1+骨釘*6	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-Sterile Kit(Burrhole plate 6 hole*1+screw*6)	TCN-041	組	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	13,611	依FPP0702(MICRO BURR HOLE PLATE SYSTEM(含PLATE*1+SCREW*6))同功能類別品項(如特材代碼FPP0718009EJ)之支付點數暫予支付。	6	D201-1	111/11/01

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共120項(項次1~項次120,詳頁次1-1~1-14)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至111年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
99	FPP07TCN51AE	"雅氏"顱骨固定系統及其附件-顯微鑽孔蓋骨板5孔*1+骨釘*5	"Aesculap" Neuro Plating System and Accessories-Sterile Kit(Burrhole plate 5 hole*1+screw*5)	TCN-051	組	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	12,313	依下列組件支付點數及數量合併計算暫予支付: 1、FPP0700「MICRO BURR HOLE PLATE」(支付點數5,823點)*1 2、FPS01MS「MICRO SCREW(ANY SIZE)」(支付點數1,298點)*5	0	D201-1	111/11/01
100	FPS01TSN06AE	"雅氏"顱骨固定系統及其附件-顯微骨釘	"Aesculap" Neuro Plating System and Accessories-Micro Screw	TSN-013:016(1盒6支裝,本特材支付以「支」為單位)	支	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	1,298	依FPS01MS(MICRO SCREW(ANY SIZE))同功能類別品項(如特材代碼FPS01FM940AE)之支付點數暫予支付。	37	D301-1	111/11/01
101	FUS0100411SB	"波士頓科技"尿控系統	"Boston Scientific" AMS 800 Artificial Urinary Sphincter	(7240-0098;0023:0025;0160:0168;0170;0172;0174;1685);720133-01	組	衛署醫器輸字第021254號	荷商波士頓	155,000	原特材代碼FUS0100411AM,因更改廠牌,故變更特材代碼。	1	D113-1	111/11/01
102	NBS0732477LF	歐得利320造影劑:造影劑注射筒	OPTIRAY 320, IOVERSOL INJECTION 68%	125ML	支	衛署藥輸字第020493號	台灣古爾貝特	212	依NBS07A1(造影劑注射筒/ANY SIZE)同功能類別品項(如特材代碼NBS071010TTY)之支付點數暫予支付。	9	無	111/11/01
103	SAS03GAEEA93	"風和醫療"一次性管型縫合器(端對端)	"Fengh" Disposable Circular Staplers	FAEEA-21;25;26;29;32	支	衛部醫器陸輸字第001309號	埃默高	5,196	依SAST31C(端對端自動縫合器附鈦金屬縫釘/彎型,21-33MM)同功能類別品項(如特材代碼SAS03SCS25EG)之支付點數暫予支付。	4	A101-4	111/11/01
104	SAU07LCR4593	"風和醫療"一次性內視鏡直線型切割縫合器及釘匣-釘匣/45mm	"Fengh" Disposable Endoscopic Linear Cutter Stapler & Reloads	(FA-CU;CV;CS;CM;CT;CH-45):(FR-CU;CV;CS;CM;CT;CH-45)	匣	衛部醫器陸輸字第001357號	埃默高	4,843	依SAU07A2(鈦金屬釘匣/旋轉式鈦金屬釘匣(手術切割縫合用)45mm~59mm(4排釘/6排釘))同功能類別品項(如特材代碼SAU07SDU45EG)之支付點數暫予支付。	14	無	111/11/01
105	SAU07LCR6093	"風和醫療"一次性內視鏡直線型切割縫合器及釘匣-釘匣/60mm	"Fengh" Disposable Endoscopic Linear Cutter Stapler & Reloads	FACU60;FR-CU;CV;CS;CM;CT;CH-60	匣	衛部醫器陸輸字第001357號	埃默高	5,891	依SAU07A3(鈦金屬釘匣/旋轉式鈦金屬釘匣(手術切割縫合用)≥60mm(4排釘/6排釘))同功能類別品項(如特材代碼SAU07SDU60EG)之支付點數暫予支付。	12	無	111/11/01
106	SAU08DRE4693	"風和醫療"一次性內視鏡直線型切割縫合器及釘匣-縫合器	"Fengh" Disposable Endoscopic Linear Cutter Stapler & Reloads	DRES45;DRES60;DREM45;DREL45	支	衛部醫器陸輸字第001357號	埃默高	9,000	依SAU08A1(直線型自動縫合器)同功能類別品項(如特材代碼SAU08S12M0EG)之支付點數暫予支付。	11	A101-1	111/11/01
107	TFTMCSM00882	"倍爾曼"體溫調節系統-嬰孩包覆墊	"Belmont" Thermo Regulation System	(35-48;41;36;31;25;21;18):(31-31;36;41;48):(31-18;21;25)	組	衛部醫器輸字第027026號	嘉杏	23,400	原特材代碼TFTMCSM0089Y,因更改廠牌,故變更特材代碼及新增型號。	3	T201-1	111/11/01
108	TFTMCXL00882	"倍爾曼"體溫調節系統-治療包覆墊	"Belmont" Thermo Regulation System	3500	組	衛部醫器輸字第027026號	嘉杏	25,000	原特材代碼TFTMCXL0089Y,因更改廠牌,故變更特材代碼及刪除型號。	3	T201-1	111/11/01
109	WBB0402051MG	"愛氏"繃帶(滅菌)-2"X5Y	"I-M" Bandage (Sterile)	2" X5Y	捲	衛部醫器製字第005745號	愛氏衛材	5.3	依WBB4A1(彈性繃帶/2" X5Y(2311CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBB0402050G)之支付點數暫予支付。	8	E309-1	111/11/01

一、新增既有功能類別特材品項共120項(項次1~項次120,詳頁次1-1~1-14)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至111年9月 同功能/類似功 能核價類別之 有效品項數	給付規定	健保給付 生效日期
110	WBB0402052MG	"愛民" 繃帶 (未滅菌)-2" X5Y	"I-M" Bandage (Non-Sterile)	2" X5Y	捲	衛部醫器製壹字第005346號	愛民衛材	5.3	依WBB4A1(彈性繃帶/2" X5Y(2311CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBB0402050G)之支付點數暫予支付。	8	E309-1	111/11/01
111	WBB0403051MG	"愛民" 繃帶 (滅菌)-3" X5Y	"I-M" Bandage (Sterile)	3" X5Y	捲	衛部醫器製壹字第005745號	愛民衛材	11	依WBB04A2(彈性繃帶/3" X5Y(3467CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBB0403050G)之支付點數暫予支付。	11	E309-1	111/11/01
112	WBB0403052MG	"愛民" 繃帶 (未滅菌)-3" X5Y	"I-M" Bandage (Non-Sterile)	3" X5Y	捲	衛部醫器製壹字第005346號	愛民衛材	11	依WBB4A2(彈性繃帶/3" X5Y(3467CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBB0403050G)之支付點數暫予支付。	11	E309-1	111/11/01
113	WBB0404051MG	"愛民" 繃帶 (滅菌)-4" X5Y	"I-M" Bandage (Sterile)	4" X5Y	捲	衛部醫器製壹字第005745號	愛民衛材	11	依WBB04A3(彈性繃帶/4" X5Y(4622CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBB0404050G)之支付點數暫予支付。	14	E309-1	111/11/01
114	WBB0404052MG	"愛民" 繃帶 (未滅菌)-4" X5Y	"I-M" Bandage (Non-Sterile)	4" X5Y	捲	衛部醫器製壹字第005346號	愛民衛材	11	依WBB4A3(彈性繃帶/4" X5Y(4622CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBB0404050G)之支付點數暫予支付。	14	E309-1	111/11/01
115	WBB0406051MG	"愛民" 繃帶 (滅菌)-6" X5Y	"I-M" Bandage (Sterile)	6" X5Y	捲	衛部醫器製壹字第005745號	愛民衛材	17.7	依WBB04A5(彈性繃帶/6" X5Y(6934CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBB0406050G)之支付點數暫予支付。	10	E309-1	111/11/01
116	WBB0406052MG	"愛民" 繃帶 (未滅菌)-6" X5Y	"I-M" Bandage (Non-Sterile)	6" X5Y	捲	衛部醫器製壹字第005346號	愛民衛材	17.7	依WBB4A5(彈性繃帶/6" X5Y(6934CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBB0406050G)之支付點數暫予支付。	10	E309-1	111/11/01
117	WDD081106097	怡適敷 水凝膠傷口敷料(滅菌)-110X60MM	EASTDERM hydrogel wound dressing (Sterile)	HWD-110060	片	衛部醫器製壹字第008446號	沃康	83.8	依WDD08H3(人工生物化學覆蓋物/ HYDROCOLLOID DRESSING, 面積約75cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD00442532H)之支付點數暫予支付。	2	A217-1	111/11/01
118	WDD081313097	怡適敷 水凝膠傷口敷料(滅菌)-130X130MM	EASTDERM hydrogel wound dressing (Sterile)	HWD-130130	片	衛部醫器製壹字第008446號	沃康	207	依WDD08H7(人工生物化學覆蓋物/ HYDROCOLLOID DRESSING, 面積約151cm2-200cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD08S1020RW)之最後收載品項之支付點數暫予支付。	0	A217-1	111/11/01
119	WDD081606097	怡適敷 水凝膠傷口敷料(滅菌)-160X60MM	EASTDERM hydrogel wound dressing (Sterile)	HWD-160060	片	衛部醫器製壹字第008446號	沃康	119	依WDD08H4(人工生物化學覆蓋物/ HYDROCOLLOID DRESSING, 面積約100cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD00442552H)之支付點數暫予支付。	13	A217-1	111/11/01
120	WDD082106097	怡適敷 水凝膠傷口敷料(滅菌)-210X60MM	EASTDERM hydrogel wound dressing (Sterile)	HWD-210060	片	衛部醫器製壹字第008446號	沃康	143	依WDD08H5(人工生物化學覆蓋物/ HYDROCOLLOID DRESSING, 面積約125cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD0820674F4)之支付點數暫予支付。	1	A217-1	111/11/01

二、新增既有功能類別特材自付差額品項共12項(項次121~項次132,詳頁次1-15~1-16)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	適用自付差額條件	健保支付點數	說明	給付規定	健保給付生效日期
121	CBC04LX181BA	"路透尼斯"路透尼斯018經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管	"Lutonix" Lutonix 018 Drug Coated Balloon PTA Catheter	(LX18-75;100;130;150-4-40;60;80;100;120;150-4F)(LX18-100;130;150-4-220-4F)(LX18-75;100;130;150-5-7-40;60;80;100;120;150-5F)(LX18-100;130;150-5-220-5F)	支	衛部醫器輸字第035427號	巴德	改善血管直徑,減少病灶再次狹窄機率。	28,773	自付差額品項,依CBC04C1(塗藥氣球導管用於淺股動脈及近端髖動脈狹窄-直徑 \geq 4.0mm)近似功能類別品項(如特材代碼CBC0490204BA)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	A220-4	111/11/01
122	CBC04SPSMLE7	"優科德"石坡特紫杉醇塗藥周邊血管擴張導管	"EucaTech" SUPPORT Paclitaxel Coated PTA Catheter	SPS-0400-020;030-138	支	衛部醫器輸字第035348號	匯悅	改善血管直徑,減少病灶再次狹窄機率。	28,773	自付差額品項,依CBC04C1(塗藥氣球導管用於淺股動脈及近端髖動脈狹窄-直徑 \geq 4.0mm)近似功能類別品項(如特材代碼CBC04PASLXBK)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	A220-4	111/11/01
123	CBP06BFC11BS	"百爾森"百美登艾塔冠狀動脈塗藥支架系統	"BIOSENSORS" BioFreedom Drug Coated Coronary Stent System	(BFC1-22;40-09;14;19;24;29)(BFC1-25;27;30;35-09;14;19;24;29;33;36)	組	衛部醫器輸字第035504號	科舉	長度較長,可減少病人傳統方式治療之手術時間。	14,099	自付差額品項,依CBP06A2(冠狀動脈塗藥支架(雙抗血小板藥物3個月以下))近似功能類別品項(如特材代碼CBP06BFR11BS)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	A213-2N	111/11/01
124	FALSNA7197Z	"蔡司"托比散光矯正親水性後房人工水晶體	"ZEISS" AT TORBI toric Hydrophilic Acrylic Posterior Chamber Intraocular Lens	AT TORBI 719M;AT TORBI 719MP	片	衛部醫器輸字第035445號	卡爾蔡司	提供具非球面功能型人工水晶體,能有效降低角膜的球面像差之療效,並具散光矯正功能。	2,744	自付差額品項,依FALSNB2(特殊人工水晶體(單焦點、非球面、散光(含黃片)))近似功能類別品項(如特材代碼FALSNA7097Z)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	無	111/11/01
125	FALSNAVE16HY	豪雅預載式單片型人工水晶體	HOYA Nanex multiSert+ Preloaded Intraocular Lens	NC1-SP	片	衛部醫器輸字第035318號	維州	提供具非球面功能型人工水晶體,能有效降低角膜的球面像差之療效。	2,744	自付差額品項,依FALSNB1(特殊人工水晶體(單焦點、非球面(含黃片)))近似功能類別品項(如特材代碼FALSNAVE13HY)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	無	111/11/01
126	FBHBCERA3S2	"好美得卡-奧斯得寧"陶瓷雙極式人工髖關節組	"HOWMEDICA-OSTEONICS" Accolade HIP SYSTEM: CERAMIC BIPOLAR SYSTEM	由以下特材代碼組合:FBHB1UH1ONS2; FBHHCERA1S2; FBHS1672XNS2	組	衛署醫器輸字第021427號+衛署010293+衛部029020號	史賽克	1.增加耐久性。2.陶瓷人工髖關節系統,可增加使用年限。	35,195	自付差額品項,依FBHBCB1(雙極式人工髖關節整組(陶瓷股骨頭+健保給付髖臼杯、髖臼杯內襯、股骨柄))近似功能類別品項(如特材代碼FBHBCERA1S2)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	無	111/11/01

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

二、新增既有功能類別特材自付差額品項共12項(項次121~項次132,詳頁次1-15~1-16)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	適用自付差額條件	健保支付點數	說明	給付規定	健保給付生效日期
127	FBHCCERA4S2	"好美得卡-奧斯得寧"陶瓷雙極式人工髖關節組	"HOWMEDICA-OSTEONICS" Accolade HIP SYSTEM: CERAMIC BIPOLAR SYSTEM	由以下特材代碼組合:FBHB1UH10NS2; FBHCCERA4S2; FBHS1672XNS2	組	衛署醫器輸字第021427號+衛部028991號+衛部029020號	史賽克	1.增加耐久性。2.陶瓷人工髖關節系統,可增加使用年限。	35,195	自付差額品項,依FBHBCB2(雙極式人工髖關節整組(複合物強化陶瓷股骨頭+健保給付髖白杯、髖白杯內襯、股骨柄))近似功能類別品項(如特材代碼FBHCCERA2S2)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	無	111/11/01
128	FBHCCERA4S2	"好美得卡-奧斯得寧"陶瓷股骨頭	"Howmedica Osteonics" Biolox delta Ceramic Femoral Head	(6570-0-0:3-28);(6570-0-0:2-32);(6570-0-0:2:4:5:7-36)	個	衛部醫器輸字第028991號	史賽克	1.增加耐久性。2.陶瓷人工髖關節系統,可增加使用年限。	4,352	自付差額品項,依FBHCCB2(複合物強化陶瓷股骨頭)近似功能類別品項(如特材代碼FBHCCERA2S2)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	無	111/11/01
129	FBHPCERA4S2	"好美得卡奧斯得寧"陶瓷髖關節組(陶瓷HEAD+陶瓷LINER)	"HOWMEDICA OSTEONICS" Accolade Ceramic HIP SYSTEM	由以下特材代碼組成:FBHS1672XNS2;FBHC154NXNS2;FBHCCERA1S2;FBHCCERA1S2	組	衛部醫器輸字029020+衛署010293號	史賽克	1.增加耐久性。2.陶瓷人工髖關節系統,可增加使用年限。	39,396	自付差額品項,依FBHPCB3(全人工髖關節整組(陶瓷股骨頭+陶瓷髖白杯內襯+健保給付髖白杯、股骨柄))近似功能類別品項(如特材代碼FBHPCERA1S2)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	無	111/11/01
130	FBHPCERA7S2	"好美得卡奧斯得寧"陶瓷全人工髖關節組(陶瓷HEAD)	"HOWMEDICA OSTEONICS" Accolade Ceramic HIP SYSTEM	由以下特材代碼組合:FBHS1672XNS2;FBHC154NXNS2;FBHCCERA4S2;FBHL16200NS2;FBHL16201NS2;FBHL11236NS2	組	衛部醫器輸字029020+衛署010293+衛部028991+衛署019314號+衛署024932號+衛署011235號+衛署022771號	史賽克	1.增加耐久性。2.陶瓷人工髖關節系統,可增加使用年限。	39,396	自付差額品項,依FBHPCB2(全人工髖關節整組(複合物強化陶瓷股骨頭+健保給付髖白杯、髖白杯內襯、股骨柄))近似功能類別品項(如特材代碼FBHPCERA2S2)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	無	111/11/01
131	FBHPCERA8S2	"好美得卡奧斯得寧"陶瓷全人工髖關節組(陶瓷HEAD)	"HOWMEDICA OSTEONICS" Accolade Ceramic HIP SYSTEM	由以下特材代碼組合:FBHS1672XNS2;FBHC154NXNS2;FBHCCERA1S2;FBHL16200NS2;FBHL16201NS2;FBHL11236NS2	組	衛部醫器輸字029020+衛署010293+衛署019314號+衛署024932號+衛署011235號+衛署022771號	史賽克	1.增加耐久性。2.陶瓷人工髖關節系統,可增加使用年限。	39,396	自付差額品項,依FBHPCB1(全人工髖關節整組(陶瓷股骨頭+健保給付髖白杯、髖白杯內襯、股骨柄))近似功能類別品項(如特材代碼FBHPCERA3S2)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	無	111/11/01
132	FHVD1DDLAMQR	"漢瑞爾"多佛都生物性人工心臟瓣膜	"Meril" Dafodil Pericardial Bioprosthesis	(DDL-19;21;23;25;27-A)(DDL-23;25;27;29;31-M)	個	衛部醫器輸字第035316號	建律	減少瓣膜鈣化,延長使用時間。	43,613	自付差額品項,依FHVD1B3(牛心材質瓣膜)近似功能類別品項(如特材代碼FHVD137TFXED)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	無	111/11/01

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共30項(項次133~項次162,詳頁次1-17~1-21)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效日期
133	ACA0100CDVPW	"普惠"注射帽(免針安全型)	"PERFECT" I.V LOCK(NEEDLESS SAFETY)	C型;D型;(型號重整為TYPE C;TYPE D自1111101生效)	個	衛署醫器輸字第016679號	普惠	37.7	型號重整為TYPE C;TYPE D。	無	111/11/01
134	ACA01AB00NPW	"普惠"注射帽	"PERFECT" I.V LOCK	A型、B型;(型號重整為TYPE A;TYPE B自1111101生效)	個	衛署醫器輸字第016679號	普惠	3	型號重整為TYPE A;TYPE B。	無	111/11/01
135	CBP06BFR11BS	"百爾森"百美登冠狀動脈塗藥支架系統	"BIOSENSORS" BioFreedom Drug Coated Coronary Stent System	(BFR1-22-08;11;14;18;24;28);(BFR1-25-08;11;14;18;24;28;33;36);(BFR1-27-08;11;14;18;24;28;33;36);(BFR1-30-08;11;14;18;24;28;33;36);(BFR1-35-08;11;14;18;24;28;33;36);(BFR1-40-08;11;14;18;24;28)(新增產品型號BFR1-25;27;30;35-42;48自1111101生效)【型號重整(BFR1-22;40-08;11;14;18;24;28)(BFR1-25;27;30;35-08;11;14;18;24;28;33;36;42;48)自1111101生效】	組	衛署醫器輸字第031840號	科舉	14,099	自付差額品項,擴增產品型號BFR1-25;27;30;35-42;48	A213-2N	111/11/01
136	CDD11ZT00058	"濾容"濁必隱穿刺套管(穿刺針×1+外管×1+轉接頭×1+內建過濾網)	"Zerone"Tropan Laparoscopic Trocar	ZT-12F;ZT-22F(擴增產品型號NZT-30F;NZT-40F自1111101生效)	組	衛署醫器輸字第034959號	橋河	1,379	擴增產品型號NZT-30F;NZT-40F	無	111/11/01
137	CDP0104015SB	"波士頓科技"經鼻瞻道引流管	"BOSTON SCIENTIFIC" FLEXIMA NASOBILIARY CATHETER	M00540-150;180;(刪除M00540150自1111101生效):(型號重整為M00540160;M00540170;M00540180自1111101生效)	組	衛署醫器輸字第011779號	荷商波士頓	5,143	刪除產品型號M00540150並重新整理型號。	無	111/11/01
138	CEP0108314P2	"太平洋"壓力延長管	"PAHSCO" PRESSURE TUBE	I08314;6;I08322;I08327;8(刪除I08314;I08315;I08322;I08328自1110501生效):(I08427;I08428;I08401;I08405;I08417自1110501生效):(刪除I08316;I08327;I08427;8;I08401;5;I08417自1111101生效):(I08313;4;I08326;I08346;I08400;I08407;9;I08413;I08423;I08315;I08328;I08410;2;I08416;I08420;1;I08422;I08425;I08414自1111101生效)	個	衛署醫器製字第000996號	太平洋	6.3	刪除產品型號I08316;I08327;I08427;8;I08401;5;I08417並擴增產品型號I08313;4;I08326;I08346;I08400;I08407;9;I08413;I08423;I08315;I08328;I08410;2;I08416;I08420;1;I08422;I08425;I08414。	無	111/11/01
139	CGPG134356SB	"波士頓科技"馬克導引導管	"BOSTON SCIENTIFIC" MACH 1 GUIDE CATHETER	請參考圖檔(詳頁次1-23-1-28)	條	衛署醫器輸字第009962號	荷商波士頓	1,500	刪除產品型號H7493435-6760;61230;65450;65460;65480;65490;66470;7440;7760;71070;71180;71230;71300;72490;74700;74710;74720;74730;8120;8150;8570;8970;81070;81230;81300並重新整理產品型號,請參考圖檔。	無	111/11/01
140	CGUS188010W6	"威德"取石網(滅菌)	"well Lead" Stone baskets (Sterile)	SB4NS-22120;SB4NS-18090;SB4TL-25120;SB6NL-25120;(SB4NS-22120;SB4NS-18090自1090901刪除生效):(SB4NS-22120;SB4NS-18090;SB4NS-18120;SB3NS-17130-8;SB3NS-17130-11自1111101生效)	組	衛署醫器陸輸字第003188號	康成生醫	5,598	擴增產品型號SB4NS-22120;SB4NS-18090;SB4NS-18120;SB3NS-17130-8;SB3NS-17130-11。	D113-4	111/11/01
141	CHF06MEFKAML	"美德思"股動靜脈導管	"MEDOS" FEMORAL CANNULAE	MEFKA16;26;MEFKA16;26L;MEFKV18;28;MEFKV18;28L;(MEFKA16;26;MEFKA26L;MEFKV18;28自1111101刪除)	組	衛署醫器輸字第018553號	興東	16,771	刪除型號MEFKA16;26;MEFKA26L;MEFKV18;28。	B201-2	111/11/01
142	CLS05NVB34Q4	"尼得立斯"計量點滴輸液套-幫浦計量輸液套(2免針)	"Needleless" Administration Set	IVB634;(IVB834自1111101生效)	組	衛署醫器製字第005721號	尼得立斯	283	擴增產品型號IVB834。	E301-4	111/11/01

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共30項（項次133~項次162，詳頁次1-17~1-21）												
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效日期	
143	CLS05PVS35Q4	"尼得立斯"計量點滴輸液套-幫浦輸液套(1免針)	"Needleless" Administration Set	PVS034;(PVS534自1111101生效)	組	衛部醫器製字第005721號	尼得立斯	195	擴增產品型號PVS534。	E301-4	111/11/01	
144	CMV02F0TREBK	"百多力"和期思導引鞘系統(導引套管+導引鞘)	"BIOTRONIK" Fortress Introducer Sheath System	(3588-13:15)(3865-90:95)(新增產品型號444481;444482;444483;444484;444485;444486自109年3月1日生效(新增產品型號4523-82:89自1111101生效)【型號重整為(3588-13:15)(3865-90:95)(4444-81:86)(4523-82:89)自1111101生效】)	組	衛部醫器輸字第029122號	百多力	6,351	擴增產品型號4523-82:89。	I203-17	111/11/01	
145	CMV03SYNCHS9	"史賽克"新格導引線	"Stryker" Synchro Guidewires	2601;2611;2641;2642;2631;2632;2651;2652;(刪除產品型號2601;2611;2641;2642;2631;2632;2651;2652自1100901生效);(型號重整為M00326010;M00326110;M00326410;M00326420;M00326310;M00326320;M00326510;M00326520;M00313010;M00313020;M0031310;M00313320;M00313410;M00316310;M00316330自1100901生效);【(S2SP-S14215;P14215;S14300;P14300);(SSTD-215STR;215PRE;300STR;300PRE);(SSFT-215STR;215PRE;300STR;300PRE);(SSUP-215STR;215PRE;300STR;300PRE)自1111101生效】	組	衛署醫器輸字第020895號	史賽克	4,474	擴增產品型號(S2SP-S14215;P14215;S14300;P14300);(SSTD-215STR;215PRE;300STR;300PRE);(SSFT-215STR;215PRE;300STR;300PRE);(SSUP-215STR;215PRE;300STR;300PRE)。	I203-17	111/11/01	
146	CMV04HESVXMS	"麥新"親水性線圈栓塞系統	"MICROVENTION" HYDROCOIL EMBOLIC SYSTEM	100202HES-V;182020HES-V(100152H2HS-V;101030H2HS-V;100306HFRM-V;182048HFRM-V;100202HFIL-V:102450HFIL-V自104/1/1生效);【(10-0202;0204;0206;0304;0306;0404;0406;0408;0410;0506;0508;0510;0606;0608;0610-HES-V);(14-0203;0205;0305;0307;0407;0410;0510;0515;0610;0615;0620;0710;0715;0720;0815;0820;0915;0920;1015;1020-HES-V);(18-0610;0710;0810;0815;0915;1015;1215;1220;1415;1420;1620;1820;2020-HES-V)自1111101刪除】;(10-0102;0103;0152;0154;0202;0204;0206;0208;0254;0256;0258;0304;0306;0308;0310-HFRM-V自1111101生效);【型號重整為(10-0152;0154;0201;0202;0203;0204;0206;0208;0254;0256;0304;0306;0308;0310;0404;0406;0408;0410;0508;0510;0515;0520;0608;0610;0615;0620;0720;0820;0930;1030-H2HS-V);(10-0405;0408;0510;0515;0612;0619;0715;0728;0817;0833-HFRM-V);(18-0619;0723;0827;0931;1036;1139;1243;1347;1445;1644;1850;2048-HFRM-V);(10-0102;0103;0152;0153;0154;0202;0203;0204;0206;0208;0254;0256;0258;0304;0306;0308;0310-HFRM-V)自1111101生效】	個	衛署醫器輸字第018960號	世新	17,770	刪除及擴增產品型號，並重新整理產品型號為(10-0152;0154;0201;0202;0203;0204;0206;0208;0254;0256;0304;0306;0308;0310;0404;0406;0408;0410;0508;0510;0515;0520;0608;0610;0615;0620;0720;0820;0930;1030-H2HS-V);(10-0405;0408;0510;0515;0612;0619;0715;0728;0817;0833-HFRM-V);(18-0619;0723;0827;0931;1036;1139;1243;1347;1445;1644;1850;2048-HFRM-V);(10-0102;0103;0152;0153;0154;0202;0203;0204;0206;0208;0254;0256;0258;0304;0306;0308;0310-HFRM-V)。	I203-2	111/11/01	
147	CVA02ABCDGTM	"泰爾茂"歐帝克血管攝影導管	"TERUMO" RADIFOCUS OPTITORQUE ANGIOGRAPHIC CATHETER	請參考圖檔(詳頁次1-29-1-33)	條	衛署醫器輸字第024181號	台灣泰爾茂	543	擴增產品型號，請參考圖檔。	無	111/11/01	

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共30項(項次133~項次162,詳頁次1-17~1-21)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效日期
148	FBHL16201NS2	"好美得卡奧斯得寧" 采登特髖臼內墊系統 (超耐磨髖臼內墊)	"HOWMEDICA OSTEONICS" TRIDENT ACETABULAR COMPONENT SYSTEM(UHMWPE)	623-00;10-22A:22J;26B:26J;28C:28J;32D:32J;36E:36J;36D;40E;44F:44J(643-00-28D:28I;32E:32I;36E:36I自105.11.01生效) 【(623-00;10-26B自1111101刪除);(623-00-28A:28B);(623-00-32B:32C)(723-00;10-22A:22J);(723-10-26C:26J);(723-00-28A:28B);(723-00;10-28C:28J);(723-00-32B:32C);(723-00;10-32D:32J);(723-00-36D);(723-00-36E:36J);(723-00-40E:40J;723-00-44F:44J);(743-00-28C:28J);(743-00-32E:32J);(743-00-36E:36J)自1111101生效】;【型號重整為(623-00;10-22A:22J);(623-00;10-26C:26J);(623-00;10-28C:28J);(623-00;10-32D:32J);(623-00-36D);(623-00-40E:40J);(623-00-44F:44J);(643-00-28D:28I);(643-00-32E:32I);(643-00-36E:36I);(723-00;10-22A:22J);(723-10-26C:26J);(723-00-28A:28B);(723-00;10-28C:28J);(723-00-32B:32C);(723-00;10-32D:32J);(723-00-36D);(723-00-36E:36J);(723-00-40E:40J);(723-00-44F:44J);(743-00-28C:28J);(743-00-32E:32J);(743-00-36E:36J)自1111101生效】	個	衛署醫器輸字第010293號 +019314號	史賽克	4, 018	【刪除產品型號(623-00;10-26B);擴增產品型號(623-00-28A:28B);(623-00-32B:32C);(723-00;10-22A:22J);(723-10-26C:26J);(723-00-28A:28B);(723-00;10-28C:28J);(723-00-32B:32C);(723-00;10-32D:32J);(723-00-36D);(723-00;10-36E:36J);(723-00-40E:40J);(723-00-44F:44J);(743-00-28C:28J);(743-00-32E:32J);(743-00-36E:36J)】;【型號重整為(623-00;10-22A:22J);(623-00;10-26C:26J);(623-00;10-28C:28J);(623-00;10-32D:32J);(623-00;10-36E:36J);(623-00-36D);(623-00-40E:40J);(623-00-44F:44J);(623-00-28A:28B);(623-00-32B:32C);(643-00-28D:28I);(643-00-32E:32I);(643-00-36E:36I);(723-00;10-22A:22J);(723-10-26C:26J);(723-00-28A:28B);(723-00;10-28C:28J);(723-00-32B:32C);(723-00;10-32D:32J);(723-00-36D);(723-00-40E:40J;723-00-44F:44J);(743-00-28C:28J);(743-00-32E:32J);(743-00-36E:36J)自1111101生效】	無	111/11/01
149	FBHRCERA1S2	"史賽克"采登特髖臼杯系統:重建型(陶瓷HEAD+陶瓷LINER)	"STRYKER" TRIDENT POLY ACETABULAR SYSTEM: CERAMIC REVISION HIP SYSTEM	(1726;28;32;3600E;05E)(1728;32;3E;365E;6250T-28D;32E;F;36G;H;I(65650028:0236;20472844E:3264;E970701生效)(STEM及CUP傳統);【(1726-00E;05E);(20472844E:3264;E)自1111101刪除】;【(FBHS2601XNS2;FBHS2130LNS2自1111101生效)】;【型號重整(17-28;32-3-E);(17-36-5-E)(17-28;32;36-00;05-E);(625-0T-28D;32E;32F;36G;36H;36I);(6565-0-028;032;036;128;132;136;228;232;236);(STEM及CUP傳統);(FBHS2601XNS2;FBHS2130LNS2自1111101生效)】	SET	衛署醫器輸字第010293號 +021713號 +021427號	史賽克	52, 796	【(1726-00E;05E);(20472844E:3264;E)自1111101刪除】;【(FBHS2601XNS2;FBHS2130LNS2自1111101生效)】;【型號重整(17-28;32-3-E);(17-36-5-E)(17-28;32;36-00;05-E);(625-0T-28D;32E;32F;36G;36H;36I);(6565-0-028;032;036;128;132;136;228;232;236);(STEM及CUP傳統);(FBHS2601XNS2;FBHS2130LNS2自1111101生效)】	無	111/11/01
150	FBN05RAFNO5I	"信迪思"萬向髓內釘股骨系統-中空逆向性股骨髓內釘	"Synthes" Expert Retrograde/Integrade Femoral Nail System- Retrograde Femoral Nail	【Nail:(04.013.-3:9-12;16;20;24;28;32;36;40;44;48;52;56;60;64;68;72;76-S);(04.013.-3:9-12;16;20;24;28;32;36;40;44;48;52;56;60;64;68;72;76自111.11.01生效)】;【End cap:(04.003.000:004);04.013.000;(04.003.000:004-S自111.11.01生效)】;【Spiral blade:(04.013.-041:052-S);(04.013.-041:052)】;【Screw:(04.005.-5;6-16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;54;58;62;66;70;75;80;85;90-S);(04.005.6-16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;54;58;62;66;70;75;80;85;90);(04.005.-5-16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58;60;62;64;66;68;70;75;80;85;90自1110501生效)】	組	衛署醫器輸字第018793號+衛署018775號+衛署019808號	壯生	19, 036	擴增產品型號(04.013.-3:9-12;16;20;24;28;32;36;40;44;48;52;56;60;64;68;72;76);(04.003.000:004-S)	D101-8	111/11/01

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共30項(項次133~項次162,詳頁次1-17~1-21)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效日期
151	FBS0141006V2	"鑄鈦"骨釘骨板植入物(皮質骨釘鈦 2.0/2.4/2.7/3.5mm)	"INTAI" BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(CORTEX SCREW T6A14V 2.0/2.4/2.7/3.5mm)	(41100-06;08;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40);(40200-06;08;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;45;50;55);(4040-010;012;014;016;018;020;022;024;026;028;030;032;034;036;038;040;045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100;105;110;115;120;125);(40420-12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;45;55);(40175-06;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58;60自111.11.01生效)	支	衛署醫器製字第002074號	鑄鈦	182	擴增產品型號40175-06;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58;60	無	111/11/01
152	FBSFCB0004RK	瑞寶德"頸椎前路骨板系統:頸椎骨板"	REBORN ESSENCE ANTERIOR CERVICAL PLATE SYSTEM : CERVICAL PLATE	465-26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;58;62;66;70;74;78;82;84;86;90;(465-20;22;24;36C;38C;56;60;64;68;72自1111101生效)	個	衛署醫器製字第002798號	寶德生技	3,389	擴增產品型號465-20;22;24;36C;38C;56;60;64;68;72	無	111/11/01
153	FBSFCBA001RK	"瑞寶德"頸椎前路骨板系統:二節(PX1+SX4)	REBORN ESSENCE ANTERIOR CERVICAL PLATE SYSTEM:2 LEVEL(PX1+SX4)	465-26K;38K;422-12;14;16;423-12;14;16(465-26;38;424-14;自990701刪除);(465-26A;38A;26B;38B;422;423-18;422-3012A;3018A;3512A;3518A自104.03.01生效);【(465-20-K);(465;22;24-A;K);(465-36;38-KC;AC);(422-40-12;14;16;18-A)自1111101生效】;【型號重整為(465-20-K);(465-22;24-A;K);(465-26;28;30;32;34;36;38-A;B;K);(422;423-12;14;16;18);(465-36;38-KC;AC);(422-30;35;40-12;14;16;18-A)自1111101生效】	組	衛署醫器製字第002798號	寶德生技	16,099	擴增產品型號(465-20-K);(465;22;24-A;K);(465-36;38-KC;AC);(422-40-12;14;16;18-A);產品型號重新整理為465-20-K;(465-22;24-A;K);(465-26;28;30;32;34;36;38-A;B;K);(422;423-12;14;16;18);(465-36;38-KC;AC);(422-30;35;40-12;14;16;18-A)。	D112-3	111/11/01
154	FBSFCBA002RK	"瑞寶德"頸椎前路骨板系統:三節(PX1+SX6)	REBORN ESSENCE ANTERIOR CERVICAL PLATE SYSTEM:3 LEVEL(PX1+SX6)	465-40K;90K;422;423-12;14;16;(465-40;90;424-14;16自990701刪除);(465-40A;90A;40B;90B;422;423-18;422-3012A;3018A;3512A;3518A自104.03.01生效);【(465-56;60;64;66;68;72-A;K);(422-40-12;14;16;18-A)自1111101生效】;【型號重整為(465-40;42;44;46;48;50;52;54;58;62;66;70;74;78;82;84;86;90-A;B;K);(465-56;60;64;68;72-A;K);(422;423-12;14;16;18);(422-30;35;40-12;14;16;18-A)自1111101生效】	組	衛署醫器製字第002798號	寶德生技	17,332	擴增產品型號(465-56;60;64;66;68;72-A;K);(422-40-12;14;16;18-A);產品型號重新整理為(465-40;42;44;46;48;50;52;54;58;62;66;70;74;78;82;84;86;90-A;B;K);(465-56;60;64;68;72-A;K);(422;423-12;14;16;18);(422-30;35;40-12;14;16;18-A)。	D112-3	111/11/01
155	FBSFCBA003RK	"瑞寶德"頸椎前路骨板系統:頸椎螺釘	REBORN ESSENCE ANTERIOR CERVICAL PLATE SYSTEM:CERVICAL SCREW	422-12;14;16;423-12;14;16;(422;423-18;422-3012A;3018A;422-3512A;3518A自104.03.01生效);(422-40-12;14;16;18-A自1111101生效);【型號重整為(422;423-12;14;16;18);(422-30;35;40-12;14;16;18-A)自1111101生效】	支	衛署醫器製字第002798號	寶德生技	807	擴增產品型號422-40-12;14;16;18-A;產品型號重新整理為(422;423-12;14;16;18);(422-30;35;40-12;14;16;18-A)。	D112-3	111/11/01

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共30項（項次133~項次162，詳頁次1-17~1-21）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效日期
156	FHV04EVLTPM4	"美敦力"柯普經導管主動脈瓣膜及"美敦力"柯普經導管主動脈瓣膜輸送及裝載系統(含瓣膜、裝載/輸送系統、導引器)	"Medtronic"CoreValve Evolut PRO Transcatheter Aortic Valve and"Medtronic"CoreValve EnVeO PRO Delivery Catheter and Loading System	整組合[(EVOLUTPRO-23;26;29)+(ENVPRO-16;ENVEOR-N)+(L-ENVPRO-1623;L-ENVPRO-16)]+(CGS01SENSHM4;擴增型號CMV02SENSHM4自1110501生效);刪除CGS01SENSHM4自1111101生效	組	衛部醫器輸字第034231號 +034201號 +034322號	美敦力	1,077,458	刪除產品型號CGS01SENSHM4。	B102-8	111/11/01
157	FHV04EVLTRM4	"美敦力"柯法經導管主動脈瓣膜及"美敦力"經導管主動脈瓣膜輸送及裝載系統(含瓣膜、裝載/輸送系統、導引器)	"Medtronic"CoreValve Evolut R Transcatheter Aortic Valve;Delivery Catheter and Loading System	整組合[(EVOLUTR-23;26;29;34)+(LS-ENVEOR-23;2629;34;擴增產品型號L-ENVPRO-14;16)]+(ENVEOR-L;N;擴增產品型號ENVPRO-14;16)]+(CGS01SENSHM4;擴增產品型號CMV02SENSHM4自1110501生效);刪除型號CGS01SENSHM4自1111101生效	組	衛部醫器輸字第029410號 +029415號 +034322號	美敦力	1,077,458	刪除產品型號CGS01SENSHM4。	B102-8	111/11/01
158	FHX04XYTUBML	"美德思"管路組(ECMO長效型人工心肺組)	"MEDOS" TUBING SETS:OXYGENATOR+TUBING SET	MEH2C2380;MEH2C2392;MEH2C2393;MEH2C2751;MEH2C2752;(MEH2C3667自1030701生效);(MEH2C2392;MEH2C2393;MEH2C2751自1111101刪除)	組	衛部醫器輸字第022065號	興東	35,346	刪除型號MEH2C2392;MEH2C2393;MEH2C2751。	B201-2	111/11/01
159	FSP710BTR2SB	"波士頓科技"歐碧翠系統(2個輸送裝置+1個網狀結構)	"Boston Scientific"Obtryx II System	M0068504110;M0068504111;M0068505110;M0068505111;(刪除M0068504111;M0068505111自1111101生效)	組	衛部醫器輸字第026612號	荷商波士頓	13,582	刪除產品型號M0068504111;M0068505111	無	111/11/01
160	HEF03PLA40E9	"美蒂佳"血漿過濾器	"MEDICA" PLASMAFILTERS	PLASMART40;(刪除產品型號PLASMART40自1111101生效);(Plasmart200;Plasmart400;Plasmart600;Plasmart700自1111101生效)	個	衛部醫器輸字第014029號	明基透析	4,296	刪除產品型號PLASMART40;並擴增產品型號Plasmart200;Plasmart400;Plasmart600;Plasmart700。	無	111/11/01
161	NBS070539J3N	"根本"顯影注射筒套組:50;100;150;200C注射筒(含填充管)	"NEMOTO" DISPOSABLE SYRINGE KIT:SYRINGE+J TUBE	TM0539J;TM05390;TM0539S;TM0539U;(TM0539AU自1111101生效)	支	衛部醫器製字第004916號	太平洋	212	擴增產品型號TM0539AU。	無	111/11/01
162	NES01M1806AG	"亞康思"穿刺針	"ARGON" FINE NEEDLE ASPIRATION (FNA) BIOPSY NEEDLES	MCN1803;MCN1806;MCN1803US;MCN1806US;MFN1803;MFN1806;MFN1803US;MFN1806US;(擴增型號MCN1808;MCN2003;MCN2006;MCN2008;MCN2203;MCN2206;MCN2208;MCN1808US;MCN2003US;MCN2006US;MCN2008US;MCN2203US;MCN2206US;MCN2208US;MFN1808;MFN2003;MFN2006;MFN2008;MFN2203;MFN2206;MFN2208;MFN1808US;MFN2003US;MFN2006US;MFN2008US;MFN2203US;MFN2206US;MFN2208US;MSPN1803;MSPN1806;MSPN2003;MSPN2006;MSPN2203;MSPN2206;MSPN2208;MSPN2203US;MSPN2006US;MSPN2203US;MSPN2206US;MWN2003;MWN2006;MWN2008;MWN2203;MWN2206;MWN2208;MWN2003US;MWN2006US;MWN2008US;MWN2203US;MWN2206US;MTN1806;MTN1808自1111101生效)	支	衛部醫器輸字第010398號	春莒	331	擴增型號MCN1808;MCN2003;MCN2006;MCN2008;MCN2203;MCN2206;MCN2208;MCN1808US;MCN2003US;MCN2006US;MCN2008US;MCN2203US;MCN2206US;MCN2208US;MFN1808;MFN2003;MFN2006;MFN2008;MFN2203;MFN2206;MFN2208;MFN1808US;MFN2003US;MFN2006US;MFN2008US;MFN2203US;MFN2206US;MFN2208US;MSPN1803;MSPN1806;MSPN2003;MSPN2006;MSPN2203;MSPN2206;MSPN2208;MSPN2003US;MSPN2006US;MSPN2203US;MSPN2206US;MWN2003;MWN2006;MWN2008;MWN2203;MWN2206;MWN2208;MWN2003US;MWN2006US;MWN2008US;MWN2203US;MWN2206US;MTN1806;MTN1808。	無	111/11/01

項次2

特材代碼：CDD110051589

中文品名："施愛德" 一次性腹腔鏡用穿刺器；5~15mm(穿刺套管1支+
可變式轉接頭1支+穿刺針1支)

英文品名："Surgaid" Single Use Sterile Laparoscopic Trocar Kit

許可證字號：衛部醫器陸輸字第001354號

產品型號：

NGCSA-70-1-5	KTCS-100-1-5	NPVS-110-1-15
NGCSA-90-1-5	KTCS-100-1-10	NPVS-120-1-5
NTCSA-70-1-5	KTCS-100-1-12	NPVS-150-1-5
NTCSA-90-1-5	KTVS-100-1-5	NPVS-150-1-10
NPCMA-70-1-5	KTVS-100-1-10	NPVS-150-1-12
NPCMA-90-1-5	KTVS-100-1-12	NPVM-100-1-5
NPCSA-70-1-5	NPCS-70-1-5	NPVM-100-1-10
NPCSA-90-1-5	NPCS-100-1-5	NPVM-100-1-12
NPCSA-130-1-5	NPCS-100-1-10	NPVM-120-1-5
NPCSA-130-1-10	NPCS-100-1-12	NGVS-100-1-5
NPCSA-130-1-12	NPCS-110-1-15	NGVS-100-1-10
KGVS-100-1-5	NPCS-120-1-5	NGVS-100-1-12
KGVS-100-1-10	NPCS-150-1-5	NGCS-70-1-5
KGVS-100-1-12	NPCS-150-1-10	NGCS-100-1-5
KGCS-100-1-5	NPCS-150-1-12	NGCS-100-1-10
KGCS-100-1-10	NPCM-70-1-5	NGCS-100-1-12
KGCS-100-1-12	NPCM-100-1-5	NTCS-70-1-5
KPVS-100-1-5	NPCM-100-1-10	NTCS-100-1-5
KPVS-100-1-10	NPCM-100-1-12	NTCS-100-1-10
KPVS-100-1-12	NPCM-120-1-5	NTCS-100-1-12
KPCS-100-1-5	NPVS-100-1-5	NTVS-100-1-5
KPCS-100-1-10	NPVS-100-1-10	NTVS-100-1-10
KPCS-100-1-12	NPVS-100-1-12	NTVS-100-1-12

特材代碼：**CGPG134356SB**

中文品名："波士頓科技"馬克導引導管

英文品名：**"BOSTON SCIENTIFIC" MACH 1 GUIDE CATHETER**

許可證字號：衛署醫器輸字第 **009962** 號

自 **1111101** 生效，刪除以下產品型號：

H74934356760; H749343561230; H749343565450; H749343565460; H749343565480;
 H749346565490; H749343566470; H74934357440; H74934357760; H749343571070;
 H749343571180; H749343571230; H749343571300; H749343572490;
 H749343574700; H749343574710; H749343574720; H749343574730; H74934358120;
 H74934358150; H74934358570; H74934358970; H749343581070; H749343581230;
 H749343581300

自 **1111101** 生效，產品型號重整為：

6F Mach 1 Guide Catheter

H74934356010	H74934356310	H74934356850
H74934356020	H74934356380	H74934356910
H74934356030	H74934356390	H74934356920
H74934356040	H74934356400	H749343561220
H74934356050	H74934356410	H749343561260
H74934356060	H74934356460	H749343561270
H74934356070	H74934356470	H749343561290
H74934356080	H74934356480	H749343561380
H74934356090	H74934356520	H749343561410
H74934356100	H74934356530	H749343562300
H74934356170	H74934356660	H749343562310
H74934356180	H74934356670	H749343562720
H74934356190	H74934356680	H749343562790
H74934356200	H74934356690	H749343562800
H74934356220	H74934356710	H749343562930
H74934356240	H74934356720	H749343562940
H74934356250	H74934356730	H749343562950
H74934356260	H74934356740	H749343562960
H74934356280	H74934356750	H749343562970
H74934356290	H74934356780	H749343562980
H74934356300	H74934356790	H749343564420

H749343564460	H749343565730	H749343566610
H749343564700	H749343565740	H749343566620
H749343564720	H749343565750	H749343566630
H749343564730	H749343565760	H749343566640
H749343564960	H749343565780	H749343566650
H749343564970	H749343565790	H749343566670
H749343564980	H749343565830	H749343566680
H749343564990	H749343565840	H749343566840
H749343565000	H749343565910	H749343566850
H749343565010	H749343565920	H749343566860
H749343565020	H749343566120	H749343566870
H749343565140	H749343566130	H749343566880
H749343565360	H749343566140	H749343566890
H749343565370	H749343566150	H749343566910
H749343565380	H749343566160	H749343566920
H749343565390	H749343566320	H749343566980
H749343565410	H749343566380	
H749343565420	H749343566600	

7F Mach 1 Guide Catheter

H74934357010	H74934357240	H74934357500
H74934357020	H74934357250	H74934357510
H74934357030	H74934357260	H74934357520
H74934357040	H74934357280	H74934357530
H74934357050	H74934357290	H74934357540
H74934357060	H74934357300	H74934357550
H74934357070	H74934357310	H74934357560
H74934357080	H74934357380	H74934357660
H74934357090	H74934357390	H74934357670
H74934357100	H74934357400	H74934357680
H74934357170	H74934357410	H74934357690
H74934357180	H74934357460	H74934357710
H74934357190	H74934357470	H74934357720
H74934357200	H74934357480	H74934357730
H74934357220	H74934357490	H74934357740

H74934357750	H749343572310	H749343575830
H74934357770	H749343572470	H749343575910
H74934357780	H749343572480	H749343576110
H74934357790	H749343572680	H749343576120
H74934357800	H749343572690	H749343576130
H74934357810	H749343572720	H749343576140
H74934357850	H749343572730	H749343576150
H74934357890	H749343572760	H749343576160
H74934357910	H749343572770	H749343576380
H74934357920	H749343572930	H749343576410
H74934357950	H749343572940	H749343576600
H74934357960	H749343572950	H749343576610
H749343571030	H749343572960	H749343576620
H749343571040	H749343572970	H749343576630
H749343571050	H749343574420	H749343576640
H749343571080	H749343574430	H749343576650
H749343571140	H749343574460	H749343576660
H749343571150	H749343574470	H749343576670
H749343571160	H749343574480	H749343576680
H749343571190	H749343574490	H749343576690
H749343571210	H749343574960	H749343576700
H749343571220	H749343574970	H749343576710
H749343571240	H749343574980	H749343576730
H749343571260	H749343574990	H749343576740
H749343571270	H749343575000	H749343576750
H749343571280	H749343575010	H749343576760
H749343571290	H749343575020	H749343576790
H749343571320	H749343575030	H749343576800
H749343571330	H749343575140	H749343576810
H749343571340	H749343575150	H749343576820
H749343571350	H749343575730	H749343576840
H749343571380	H749343575740	H749343576850
H749343571390	H749343575760	H749343576860
H749343571400	H749343575770	H749343576870
H749343571410	H749343575780	H749343576880
H749343572300	H749343575790	H749343576890

H749343576900	H749343576940	H749343577030
H749343576910	H749343576950	H749343577040
H749343576920	H749343576970	
H749343576930	H749343576980	

8F Mach 1 Guide Catheter

H74934358010	H74934358510	H749343581150
H74934358020	H74934358520	H749343581160
H74934358030	H74934358530	H749343581190
H74934358040	H74934358540	H749343581210
H74934358050	H74934358550	H749343581220
H74934358060	H74934358560	H749343581240
H74934358070	H74934358660	H749343581260
H74934358080	H74934358670	H749343581270
H74934358090	H74934358680	H749343581280
H74934358100	H74934358690	H749343581290
H74934358170	H74934358710	H749343581320
H74934358180	H74934358720	H749343581330
H74934358190	H74934358730	H749343581340
H74934358200	H74934358740	H749343581350
H74934358220	H74934358750	H749343581380
H74934358240	H74934358770	H749343581390
H74934358250	H74934358780	H749343581410
H74934358260	H74934358790	H749343582300
H74934358280	H74934358800	H749343582310
H74934358290	H74934358810	H749343582470
H74934358300	H74934358850	H749343582480
H74934358310	H74934358890	H749343582680
H74934358380	H74934358910	H749343582690
H74934358390	H74934358920	H749343582720
H74934358410	H74934358950	H749343582730
H74934358460	H74934358960	H749343582760
H74934358470	H749343581030	H749343582770
H74934358480	H749343581040	H749343582790
H74934358490	H749343581080	H749343582800

H74934358500	H749343581140	H749343582930
H749343582940	H749343585740	H749343586810
H749343582950	H749343585750	H749343586820
H749343582960	H749343585760	H749343586840
H749343582970	H749343585770	H749343586850
H749343582990	H749343585780	H749343586860
H749343583000	H749343585790	H749343586870
H749343583650	H749343585800	H749343586890
H749343583720	H749343586110	H749343586900
H749343583800	H749343586120	H749343586910
H749343583820	H749343586130	H749343586920
H749343583830	H749343586140	H749343586930
H749343583870	H749343586150	H749343586940
H749343583940	H749343586160	H749343586950
H749343584020	H749343586380	H749343586970
H749343584040	H749343586410	H749343586980
H749343584050	H749343586600	H749343587030
H749343584420	H749343586610	H749343587040
H749343584430	H749343586620	H749343587080
H749343584460	H749343586630	
H749343584470	H749343586640	
H749343584480	H749343586650	
H749343584490	H749343586660	
H749343584960	H749343586670	
H749343584970	H749343586680	
H749343584980	H749343586690	
H749343584990	H749343586700	
H749343585000	H749343586710	
H749343585010	H749343586730	
H749343585020	H749343586740	
H749343585030	H749343586750	
H749343585140	H749343586760	
H749343585150	H749343586790	
H749343585730	H749343586800	

特材代碼：**CGPG134356SB**

中文品名："波士頓科技"馬克導引導管

英文品名："BOSTON SCIENTIFIC" MACH 1 GUIDE CATHETER

許可證字號：衛署醫器輸字第 009962 號

本圖檔型號為 111 年 10 月 30 日以前收載之歷史資料

H7493435-6010:6980;7010:87080;(自 1020801 始;型號更正為 H7493435-6010:66980;7010:87080)

特材代碼：CVA02ABCDGTM

中文名稱：“泰爾茂”歐帝克血管攝影導管

英文名稱：“Terumo” Radifocus Optitorque Angiographic Catheter

許可證字號：衛署醫器輸字第：024181 號

自 111 年 11 月 1 日生效，擴增產品型號 RH*5BL3520M；RH*5BL4020M；

RH*5BLK411M；RH*5TR4001M；RH*5TR5001M；RH*5TIG111M；

RH*6TIG110M；RH*5TR3510M；RH*5TR4000M；RH*5TR4500M；

RH*5TR5000M；RH*5TR4010M；RH*6TR4000M；RH*6TR5000M。

新增型號與規格：

Product code	Usable length of catheter (mm)	O.D. (Fr.)	Tip shape of catheter	Tip curve length
RH*5BL3520M	1000	5	Jacky Radial	3.5 cm
RH*5BL4020M	1000	5	Sarah Radial	4.0 cm
RH*5BLK411M	1100	5	Radial BLK	4.0 cm
RH*5TR4001M	1100	5	Radial TIG II 4.0	4.5 cm
RH*5TR5001M	1100	5	Radial TIG II 5.0	5.0 cm
RH*5TIG111M	1100	5	Radial TIG	4.0 cm
RH*6TIG110M	1000	6	Radial TIG	4.0 cm
RH*5TR3510M	1000	5	Radial TIG II 3.5	3.5 cm
RH*5TR4000M	1000	5	Radial TIG II 4.0	4.0 cm
RH*5TR4500M	1000	5	Radial TIG II 4.5	4.5 cm
RH*5TR5000M	1000	5	Radial TIG II 5.0	5.0 cm
RH*5TR4010M	1000	5	Radial TIG II 4.0	4.0 cm
RH*6TR4000M	1000	6	Radial TIG II 4.0	4.0 cm
RH*6TR5000M	1000	6	Radial TIG II 5.0	5.0 cm

以下為 111 年 10 月 30 日前收載之型號與規格：

Product Code	Product Code	Specification		
		Length (cm)	Applicable Site	External Diameter (Fr)
RH+4AL1000M	RH*4AL1000M	100	Thoracic	4Fr
RH+4AL2000M	RH*4AL2000M	100		
RH+4AP4561M	RH*4AP4561M	110		
RH+4AP5561M	RH*4AP5561M	110		
RH+4APR241M	RH*4APR241M	110		
RH+4AR1000M	RH*4AR1000M	100		
RH+4AR2000M	RH*4AR2000M	100		
RH+4AR3000M	RH*4AR3000M	100		
RH+4BPIN00M	RH*4BPIN00M	100		
RH+4CL3500M	RH*4CL3500M	100		
RH+4CL4000M	RH*4CL4000M	100		
RH+4CR3500M	RH*4CR3500M	100		
RH+4CR4000M	RH*4CR4000M	100		
RH+4JL3500M	RH*4JL3500M	100		
RH+4JL4000M	RH*4JL4000M	100		
RH+4JL5000M	RH*4JL5000M	100		
RH+4JR3500M	RH*4JR3500M	100		
RH+4JR4000M	RH*4JR4000M	100		
RH+4MP2520M	RH*4MP2520M	100		
RH+4MP3020M	RH*4MP3020M	100		
RH+4MP3028M	RH*4MP3028M	80		
RH+4MP4020M	RH*4MP4020M	100		
RH+4PR1508M	RH*4PR1508M	80		
RH+4PR2008M	RH*4PR2008M	80		
RH+4PR2508M	RH*4PR2508M	80		
RH+4SP0061M	RH*4SP0061M	110		
RH+4SP0068M	RH*4SP0068M	80		

Product Code	Product Code	Specification		
		Length (cm)	Applicable Site	External Diameter (Fr)
RH+5AL1000M	RH*5AL1000M	100	Thoracic	5Fr
RH+5AL2000M	RH*5AL2000M	100		
RH+5AL3000M	RH*5AL3000M	100		
RH+5AP4561M	RH*5AP4561M	110		
RH+5AP5561M	RH*5AP5561M	110		
RH+5APR241M	RH*5APR241M	110		
RH+5AR1000M	RH*5AR1000M	100		
RH+5AR2000M	RH*5AR2000M	100		
RH+5AR3000M	RH*5AR3000M	100		
RH+5BPIN00M	RH*5BPIN00M	100		
RH+5BPIR00M	RH*5BPIR00M	100		
RH+5BPJL00M	RH*5BPJL00M	100		
RH+5BPJR00M	RH*5BPJR00M	100		
RH+5CAS100M	RH*5CAS100M	100		
RH+5CL3500M	RH*5CL3500M	100		
RH+5CL4000M	RH*5CL4000M	100		
RH+5CL5000M	RH*5CL5000M	100		
RH+5CL6000M	RH*5CL6000M	100		
RH+5CR3500M	RH*5CR3500M	100		
RH+5CR3528M	RH*5CR3528M	80		
RH+5CR4000M	RH*5CR4000M	100		
RH+5CR5000M	RH*5CR5000M	100		
RH+5FJ1000M	RH*5FJ1000M	100		
RH+5JL3500M	RH*5JL3500M	100		
RH+5JL4000M	RH*5JL4000M	100		
RH+5JL5000M	RH*5JL5000M	100		
RH+5JR3500M	RH*5JR3500M	100		
RH+5JR4000M	RH*5JR4000M	100		
RH+5JR5000M	RH*5JR5000M	100		
RH+5JR6000M	RH*5JR6000M	100		
RH+5MP2520M	RH*5MP2520M	100		
RH+5MP2528M	RH*5MP2528M	80		
RH+5MP3020M	RH*5MP3020M	100		
RH+5MP3520M	RH*5MP3520M	100		
RH+5MP4020M	RH*5MP4020M	100		
RH+5SP0061M	RH*5SP0061M	110		
RH+5SP0068M	RH*5SP0068M	80		
RH+5TIG110M	RH*5TIG110M	100		
RH+5TIG118M	RH*5TIG118M	80		

Product Code	Product Code	Specification		
		Length (cm)	Applicable Site	External Diameter (Fr)
RH+6AL1000M	RH*6AL1000M	100	Thoracic	6Fr
RH+6AL2000M	RH*6AL2000M	100		
RH+6AL3000M	RH*6AL3000M	100		
RH+6AP4561M	RH*6AP4561M	110		
RH+6AP5561M	RH*6AP5561M	110		
RH+6AP6561M	RH*6AP6561M	110		
RH+6APR241M	RH*6APR241M	110		
RH+6AR1000M	RH*6AR1000M	100		
RH+6AR2000M	RH*6AR2000M	100		
RH+6AR3000M	RH*6AR3000M	100		
RH+6BPIN00M	RH*6BPIN00M	100		
RH+6BPIR00M	RH*6BPIR00M	100		
RH+6BPJL00M	RH*6BPJL00M	100		
RH+6BPJR00M	RH*6BPJR00M	100		
RH+6CL3500M	RH*6CL3500M	100		
RH+6CL4000M	RH*6CL4000M	100		
RH+6CL5000M	RH*6CL5000M	100		
RH+6CL6000M	RH*6CL6000M	100		
RH+6CR3500M	RH*6CR3500M	100		
RH+6CR4000M	RH*6CR4000M	100		
RH+6CR5000M	RH*6CR5000M	100		
RH+AB44108M	RH*AB44108M	80	Visceral and cerebral	4Fr
RH+AB4410GM	RH*AB4410GM	65		
RH+AB54108M	RH*AB54108M	80		
RH+AB5410GM	RH*AB5410GM	65		
RH+AB64108M	RH*AB64108M	80		
RH+AC4410GM	RH*AC4410GM	65		
RH+AD44108M	RH*AD44108M	80		
RH+AD4410GM	RH*AD4410GM	65		
RH+AD5410GM	RH*AD5410GM	65		
RH+AD6410GM	RH*AD6410GM	65		
RH+AG34108M	RH*AG34108M	80		
RH+AG94107M	RH*AG94107M	70		
RH+AGF4108M	RH*AGF4108M	80		
RH+AR94108M	RH*AR94108M	80		

Product Code	Product Code	Specification		
		Length (cm)	Applicable Site	External Diameter (Fr)
RH+6FJ1000M	RH*6FJ1000M	100	Thoracic	6Fr.
RH+6JL3500M	RH*6JL3500M	100		
RH+6JL4000M	RH*6JL4000M	100		
RH+6JL5000M	RH*6JL5000M	100		
RH+6JR3500M	RH*6JR3500M	100		
RH+6JR4000M	RH*6JR4000M	100		
RH+6JR5000M	RH*6JR5000M	100		
RH+6JR6000M	RH*6JR6000M	100		
RH+6MP2520M	RH*6MP2520M	100		
RH+6MP3020M	RH*6MP3020M	100		
RH+6MP3520M	RH*6MP3520M	100		
RH+6MP4020M	RH*6MP4020M	100		
RH+6RD4000M	RH*6RD4000M	100		
RH+6SP0061M	RH*6SP0061M	110		
RH+6TR4000M	RH*6TR4000M	100		
RH+AB45108M	RH*AB45108M	80		
RH+AB4510GM	RH*AB4510GM	65		
RH+AB55108M	RH*AB55108M	80		
RH+AB5510GM	RH*AB5510GM	65		
RH+AB65108M	RH*AB65108M	80		
RH+AC3510GM	RH*AC3510GM	65		
RH+AD6510GM	RH*AD6510GM	65		
RH+AG95107M	RH*AG95107M	70		
RH+BA14110M	RH*BA14110M	100	Visceral and cerebral	4Fr
RH+BA24110M	RH*BA24110M	100		
RH+BA34110M	RH*BA34110M	100		
RH+BB14110M	RH*BB14110M	100		
RH+BB24110M	RH*BB24110M	100		
RH+BE14110M	RH*BE14110M	100		
RH+BE24110M	RH*BE24110M	100		
RH+BH14110M	RH*BH14110M	100		
RH+BA15110M	RH*BA15110M	100	Visceral and cerebral	5Fr
RH+BA25110M	RH*BA25110M	100		
RH+BA35110M	RH*BA35110M	100		
RH+BB15110M	RH*BB15110M	100		
RH+BB25110M	RH*BB25110M	100		
RH+BC25110M	RH*BC25110M	100		
RH+BE15110M	RH*BE15110M	100		
RH+BE25110M	RH*BE25110M	100		
RH+BH15110M	RH*BH15110M	100		

報告案 2

全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之 初核情形報告

共 134 項：(1)醫療器材許可證註銷及刪除品項 133 項/第 2-1~2-15 頁；項次 1~133。(2)核價類別變更及價格調整品項 1 項/第 2-16 頁；項次 134。

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共133項(項次1~項次133,詳頁次2-1~2-15)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至111年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	健保給付生效日期
1	CGS01SENSHM4	"美敦力"森特爾倫特親水性塗層血管導引鞘	"Medtronic" Sentrant Introducer Sheath with Hydrophilic Coating	SENSH-12;14;16;18;20;22;24;26-28W	組	衛部醫器輸字第025824號	美敦力	產品停止販售,故取消給付。	4	112/04/01
2	CHF06MEFKAML	"美德思"股動靜脈導管	"MEDOS" FEMORAL CANNULAE	MEFKA16:26;MEFKA16:26L;MEFKV18:28;MEFKV18:28L;(MEFKA16:26;MEFKA26L;MEFKV18:28自1111101刪除)	組	衛署醫器輸字第018553號	興東	廠商來函表示,本案特材尚有庫存計236組,該品項最後一批之有效期限114年3月30日,考量該特材用於急重症醫療之人工心肺套組,有其臨床需求之必要性,依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第6-1條第1項規定,延長給付日期至該品項最後一批之有效期限截止日之前一季第一個月一日,故自113年10月2日起支付點數調整為0。	4	113/10/02
3	CMV03TPMG2CK	"曲克"導線	"COOK" WIRE GUIDE	TPMG-16-135;180-SAG-HC;TPMG-14-135;180-CEP-HC(TPMG-14-135-CEP-HC自1050301刪除)	EA	衛署醫器輸字第018005號	曲克	1.依廠商來函檢具相關庫存品資料,表示許可證到期不再展延,剩餘庫存量尚有21條,該品項最後一批效期112年9月3日。2.考量本案特材用於血管診斷或介入性手術,有其臨床需求,爰依本保險藥物給付項目及支付標準第6-1條第1項第1款規定,延長給付日期至該品項最後一批之有效期限截止日之前一季第一個月一日。爰本案特材支付點數調整為0,延後至112年4月2日生效。	15	112/04/02
4	CXE03EPT45SB	"波士頓科技"布雷瑟心臟除顫電極導管	"BOSTON SCIENTIFIC" BLAZER II XP TEMPERATURE ABLATION CATHETERS	M004EPT4500-T0;TK20;TN40;TMK20;M004EPT4500-THN40;M004EPT4790-TK20;M004EPT4500;4790-TH0;THM0;M004EPT4500;4790-THK20;THMK20	條	衛部醫器輸字第025231號	荷商波士頓	本特材代碼所含產品型號皆已註銷,故取消原特材代碼。	11	112/04/01
5	FALSNTORC2RY	"銳能"視飛克斯人工水晶體:散光功能軟式人工水晶體	"RAYNER" SULCOFLEX HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENSES	653T	EA	衛署醫器輸字第022276號	鈦沅	廠商建議取消健保給付,已有同類替代品,故同意取消給付。	30	112/04/01
6	FALSNAWAVE2RY	"銳能"視飛克斯人工水晶體:非球面軟式人工水晶體	"RAYNER" SULCOFLEX HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENSES	653L	EA	衛署醫器輸字第022276號	鈦沅	廠商建議取消健保給付,已有同類替代品,故同意取消給付。	53	112/04/01
7	FHX02ME258ML	"美德思"氧合器與硬殼靜脈儲血槽-中空纖維氧合器	"MEDOS" OXYGENATOR AND VENOUS HARDSHELL RESERVOIR-HOLLOW FIBER OXYGENATOR	ME62020001;ME62020061;ME62050001;ME62080001	組	衛署醫器輸字第024139號	興東	產品停產,許可證到期不展延,故取消給付。	1	112/04/01

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共133項(項次1~項次133,詳頁次2-1~2-15)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至111年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	健保給付生效日期
8	FHX032CL62ML	"美德思"氧合器與硬殼靜脈儲血槽-中空纖維氧合器 RHEOPARIN塗層+硬殼靜脈儲血槽	"MEDOS" Oxygenator and Venous Hardshell Reservoir	ME6202CL62;ME6205CL02;ME6208CL02	組	衛署醫器輸字第024139號	興東	產品停產,許可證到期不展延,故取消給付。	1	112/04/01
9	FHX03ME622ML	"美德思"氧合器與硬殼靜脈儲血槽	"MEDOS" OXYGENATOR AND VENOUS HARDSHELL RESERVOIR	ME62020002;ME62020062;ME62050002;ME62080002	組	衛署醫器輸字第024139號	興東	產品停產,許可證到期不展延,故取消給付。	2	112/04/01
10	FHX03ME658ML	"美德思"氧合器與硬殼靜脈儲血槽 RHEOPARIN塗層(小孩,嬰兒)(氧合器有COATING,儲血槽無COATING)	"MEDOS" OXYGENATOR AND VENOUS HARDSHELL RESERVOIR, RHEOPARIN COATING(PEDIATRIC, INFANT)	ME6205 C002;ME6208 C002	組	衛署醫器輸字第024139號	興東	產品停產,許可證到期不展延,故取消給付。	1	112/04/01
11	FHX03MEC62ML	"美德思"氧合器與硬殼靜脈儲血槽	"MEDOS" OXYGENATOR AND VENOUS HARDSHELL RESERVOIR-OXYGENATOR COATING	ME6202C002;(ME6202C062自1030701生效)	組	衛署醫器輸字第024139號	興東	產品停產,許可證到期不展延,故取消給付。	2	112/04/01
12	FHX03MECLRML	"美德思"氧合器與硬殼靜脈儲血槽-中空纖維氧合器 RHEOPARIN塗層	"MEDOS" OXYGENATOR AND VENOUS HARDSHELL RESERVOIR-LONG TERM RHEOPARIN COATING	ME6202CL01;ME6205CL01;ME6208CL01;(ME6202CL61自1030701生效)	組	衛署醫器輸字第024139號	興東	產品停產,許可證到期不展延,故取消給付。	2	112/04/01
13	FHX04C3464ML	"美德思"管路組(ECMO長效型人工心肺組-組件包括OXYGENATOR+PUMP HEAD+TUBING SET)	"Medos" Tubing Sets	MEH2C3464	組	衛署醫器輸字第022065號	興東	本特材代碼所含產品型號(MEH2C3464)已註銷,故取消原特材代碼。	2	112/04/01
14	FHX04MEH2CML	"美德思"管路組(ECMO長效型人工心肺套含OXYGENATOR+PUMP HEAD+TUBING SET+CUVETTE+TRANSDUCER*3+IV SET)	"Medos" Tubing Sets	MEH2C3792(30000071);MEH2C3793(30000420)	組	衛署醫器輸字第022065號	興東	廠商來函表示,本案特材尚有庫存計78組,該品項最後一批之有效期限113年3月24日,考量該特材用於急重症醫療之人工心肺套組,有其臨床需求之必要性,依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第6-1條第1項規定,延長給付日期至該品項最後一批之有效期限截止日之前一季第一個月一日,故自112年10月2日起支付點數調整為0。	1	112/10/02
15	FHX04METUBML	"美德思"管路組	"MEDOS" TUBING SETS(ECMO)	MEH2C2379;MEH2C2473;MEH2C2474	組	衛署醫器輸字第022065號	興東	本特材代碼所含產品型號(MEH2C2379;MEH2C2473;MEH2C2474)均已註銷,故取消原特材代碼。	1	112/04/01

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共133項（項次1~項次133，詳頁次2-1~2-15）										
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至111年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	健保給付生效日期
16	FHX04XYPUMML	"美德思"管路組 (ECMO長效型人工心肺組)	"MEDOS" TUBING SETS: OXYGENATOR+PUMP HEAD+TUBING SET	MEH2C2750	組	衛署醫器輸字第022065號	興東	本特材代碼所含產品型號(MEH2C2750)已註銷，故取消原特材代碼。	2	112/04/01
17	FHX04XYTFMLL	"美德思"管路組 (ECMO長效型人工心肺組)	"MEDOS" TUBING SETS: OXYGENATOR+DISPOSABLE PROBE+TUBING SET	MEH2C2805	組	衛署醫器輸字第022065號	興東	廠商來函表示，本案特材尚有庫存計104組，該品項最後一批之有效期限113年3月23日，考量該特材用於急重症醫療之人工心肺套組，有其臨床需求之必要性，依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第6-1條第1項規定，延長給付日期至該品項最後一批之有效期限截止日之前一季第一個月一日，故自112年10月2日起支付點數調整為0。	1	112/10/02
18	FHX04XYTUBML	"美德思"管路組 (ECMO長效型人工心肺組)	"MEDOS" TUBING SETS: OXYGENATOR+TUBING SET	MEH2C2380; MEH2C2392; MEH2C2393; MEH2C2751; MEH2C2752; (MEH2C3667自1030701生效); (MEH2C2392; MEH2C2393; MEH2C2751自1111101刪除)	SET	衛署醫器輸字第022065號	興東	廠商來函表示，本案特材尚有庫存計3組，該品項最後一批之有效期限113年1月19日，考量該特材用於急重症醫療之人工心肺套組，有其臨床需求，依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第6-1條第1項規定，延長給付日期至該品項最後一批之有效期限截止日之前一季第一個月一日，故自112年10月2日起支付點數調整為0。	1	112/10/02
19	FNP9106008S7	"司諾維思"腦膜補片	"SYNOVIS" DURA-GUARD DURAL REPAIR PATCH WITH APEX PROCESSING	DG-0608SN	EA	衛署醫器輸字第021215號	百特	1. 本特材廠牌由司諾維思變更為百特，爰變更廠牌代碼，由S7變更為BT，故取消原特材代碼，經111年5月份特材共擬會議決議自111年10月1日生效。2. 依廠商來函表示尚有庫存品，考量其臨床需求性，延長給付日期至該品項最後一批之有效期限截止日之前一季第一個月一日。	2	114/04/02
20	FNP9107575N7	"因提察"多利基腦膜防護墊	"INTEGRA" DURAGEN DURAL GRAFT MATRIX	ID-3301-1	EA	衛署醫器輸字第009943號	美麗康	1. 依廠商來函檢具相關庫存品資料，表示許可證到期不再展延，剩餘庫存量尚有75片，該品項最後一批效期113年9月30日。2. 考量本案特材用於腦部及脊椎手術中修補硬腦膜缺損，有其臨床需求，爰依本保險藥物給付項目及支付標準第6-1條第1項第1款規定，延長給付日期至該品項最後一批之有效期限截止日之前一季第一個月一日。爰本案特材支付點數調整為0，延後至113年4月2日生效。	7	113/04/02

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共133項（項次1~項次133，詳頁次2-1~2-15）										
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至111年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	健保給付生效日期
21	FNP9108014S7	"司諾維思" 腦膜補片	"SYNOVIS" DURA-GUARD DURAL REPAIR PATCH WITH APEX PROCESSING	DG-0814SN	EA	衛署醫器輸字第021215號	百特	1. 本特材廠牌由司諾維思變更為百特，爰變更廠牌代碼，由S7變更為BT，故取消原特材代碼，經111年5月份特材共擬會議決議自111年10月1日生效。2. 依廠商來函表示尚有庫存品，考量其臨床需求性，延長給付日期至該品項最後一批之有效期限截止日之前一季第一個月一日。	1	114/04/02
22	FNP9110016S7	"司諾維思" 腦膜補片	"SYNOVIS" DURA-GUARD DURAL REPAIR PATCH WITH APEX PROCESSING	DG-1016SN	EA	衛署醫器輸字第021215號	百特	1. 本特材廠牌由司諾維思變更為百特，爰變更廠牌代碼，由S7變更為BT，故取消原特材代碼，經111年5月份特材共擬會議決議自111年10月1日生效。2. 依廠商來函表示尚有庫存品，考量其臨床需求性，延長給付日期至該品項最後一批之有效期限截止日之前一季第一個月一日。	2	114/04/02
23	FNP9110125N7	"因提寡" 多利基腦膜防護墊	"INTEGRA" DURAGEN DURAL GRAFT MATRIX	ID-4501-1	EA	衛署醫器輸字第009943號	美麗康	1. 依廠商來函檢具相關庫存品資料，表示許可證到期不再展延，剩餘庫存尚有95片，該品項最後一批效期114年1月31日。2. 考量本案特材用於腦部及脊椎手術中修補硬腦膜缺損，有其臨床需求，爰依本保險藥物給付項目及支付標準第6-1條第1項第1款規定，延長給付日期至該品項最後一批之有效期限截止日之前一季第一個月一日。爰本案特材支付點數調整為0，延後至113年10月2日生效。	7	113/10/02
24	FUS0100411AM	"艾梅斯" 尿控系：人工括約肌	"AMS" 800 URINARY CONTROL SYSTEM	800型[72400098+724000-23:25+;724001-60:68;70;72;74(720133-01自;1020501生效)+72401685]	SET	衛署醫器輸字第021254號	荷商波士頓	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故取消原特材代碼。	1	112/04/01
25	NES01M1803AG	"亞康思" 穿刺針	"Argon" Fine Needle Aspiration (FNA) Biopsy Needles	MSPN1803;MSPN1806;MSPN2003;MSPN2006;MSPN2203;MSPN2206;MSPN2208;MSPN2003US;MSPN2006US;MSPN2203US;MSPN2206US	支	衛署醫器輸字第010398號	春苜	產品型號已併至特材代碼NES01M1806AG，故刪除原特材代碼。	8	112/04/01
26	NES01M1808AG	"亞康思" 穿刺針	"ARGON" FINE NEEDLE ASPIRATION (FNA) BIOPSY NEEDLES	MCN1808;MCN1808US;MFN1808;MFN1808US	支	衛署醫器輸字第010398號	春苜	產品型號已併至特材代碼NES01M1806AG，故刪除原特材代碼。	8	112/04/01
27	NES01M2006AG	"亞康思" 穿刺針	"ARGON" FINE NEEDLE ASPIRATION (FNA) BIOPSY NEEDLES	MCN2003;MCN2006;MCN2203;MCN2206;MCN2003US;MCN2006US;MCN2203US;MCN2206US;MFN2003;MFN2006;MFN2203;MFN2206;MFN2003US;MFN2006US;MFN2203US;MFN2206US	支	衛署醫器輸字第010398號	春苜	產品型號已併至特材代碼NES01M1806AG，故刪除原特材代碼。	8	112/04/01

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共133項（項次1~項次133，詳頁次2-1~2-15）										
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至111年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	健保給付生效日期
28	NES01M2008AG	"亞康恩"穿刺針	"ARGON" FINE NEEDLE ASPIRATION (FNA) BIOPSY NEEDLES	MCN2008;MCN2208;MCN2008US;MCN2208US;MFN2008;MFN2208;MFN2008US;MFN2208US	支	衛署醫器輸字第010398號	春菖	產品型號已併至特材代碼NES01M1806AG，故刪除原特材代碼。	8	112/04/01
29	TFTMCSM0089Y	"美翠"體溫調節系統-嬰孩包覆墊	"MTRE" Thermo Regulation System	LA008(3541;3536);MD008(3531;3525);SM008(3521;3518);3131;3136;3141;3148;3118;3121;3125	組	衛署醫器輸字第027026號	嘉杏	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故取消原特材代碼。	3	112/04/01
30	TFTMCXL0089Y	"美翠"體溫調節系統-治療包覆墊	"MTRE" Thermo Regulation System	XL008(3500;3548)	組	衛署醫器輸字第027026號	嘉杏	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故取消原特材代碼。	3	112/04/01
31	FHPCDLUMDRBK	"百多力"路麥斯植入式心臟除顫器(雙腔)*給付規定請見備註欄	"BIOTRONIK" LUMAX TACHYARRHYTHMIA THERAPY IMPLANTABLE DEFIBRILLATORS(DR-T)	LUMAX 540 DR-T 360346	個	衛署醫器輸字第023499號	百多力	許可證逾期，故取消給付。	7	111/10/01
32	FHPCDLUMDXBK	"百多力"路麥斯植入式心臟除顫器(單腔)*給付規定請見備註欄	"BIOTRONIK" LUMAX TACHYARRHYTHMIA THERAPY IMPLANTABLE DEFIBRILLATORS(VR-T DX)	LUMAX 540 VR-T DX 368852	個	衛署醫器輸字第023499號	百多力	許可證逾期，故取消給付。	8	111/10/01
33	FBSFASN00PAE	雅氏博斯貝椎融間融合植入物	"AESCULAP" PROSPACE PEEK	SN007P:13P;15P;17P;37P;43P;45P;47P;107P;113P;115P;117P;137P;143P;145P;147P;068P:073P;075P;077P;168P:173P;175P;177P 【(SN022P:SN032P);(SN052P:SN062P);(SN122P:SN132P);(SN152P:SN162P);(SN083P:SN092P);(SN183P:SN192P)自107.09.01生效】	EA	衛署醫器輸字第023619號	柏明	許可證逾期，故取消給付。	22	111/10/01
34	LEE013501AHP	"飛利浦"心臟電擊復甦器-多功能電極貼片	"Philips" HeartStart MRx Defibrillator /Monitor-PADS	M3501A;M3713A;M3716A	PAIR	衛署醫器輸字第029780號	飛利浦	許可證逾期，故取消給付。	8	111/10/01
35	LEE013504AHP	"飛利浦"心臟電擊復甦器-多功能電極貼片(兒童用)	"Philips" HeartStart MRx Defibrillator /Monitor-PADS	M3504A;M3717A	PAIR	衛署醫器輸字第029780號	飛利浦	許可證逾期，故取消給付。	5	111/10/01
36	FBKF118310BM	"邦美"先鋒人工膝關節系統-PS股骨組件	"Biomet" Vanguard Knee System-PS Femoral Component	183100;02;04;06;08;10;12;13;14;16;20;22;24;26;28;30;32;33;34;36	個	衛署醫器輸字第029650號	捷邁	許可證逾期，故取消給付。	39	111/10/01
37	FBKP118476BM	"邦美"先鋒人工膝關節系統-膕骨組件	"Biomet" Vanguard Knee System-Patellar Component	184760;70	個	衛署醫器輸字第029650號	捷邁	許可證逾期，故取消給付。	19	111/10/01
38	FBKT114123BM	"邦美"先鋒人工膝關節系統-脛骨組件	"Biomet" Vanguard Knee System-Tibial Component	141231;37	個	衛署醫器輸字第029650號	捷邁	許可證逾期，故取消給付。	31	111/10/01

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共133項(項次1~項次133,詳頁次2-1~2-15)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至111年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	健保給付生效日期
39	FBKT141210BM	"邦美"先鋒人工膝關節系統-組合式脛骨組件	"Biomet" Vanguard Knee System-Modular Tibial Component	141210:18;141369:70;141310	個	衛署醫器輸字第029650號	捷邁	許可證逾期,故取消給付。	31	111/10/01
40	BBF0377512KG	愛普仕管灌餵食管袋組合套	APPLIX SMART/VISION PUMP SET BAG	7751712	SET	衛署醫器輸字第023389號	費森尤斯卡比	許可證逾期,故取消給付。	14	111/10/01
41	CXE06EVSEKST	"聖獸達"電極貼片組	"SJM" Ensite Velocity Surface Electrode Kit	EN0020-V	組	衛署醫器輸字第029689號	台灣雅培	許可證逾期,故取消給付。	6	111/10/01
42	CGS0106249ST	"聖獸達"麥克斯導管導引器	"SJM" MAXIMUM HEMOSTASIS INTRODUCER	4062-49:53:59;4063-47:57:61:63	EA	衛署醫器輸字第009856號	台灣雅培	許可證逾期,故取消給付。	21	111/10/01
43	CGS0106255ST	"聖獸達"麥克斯導管導引器	"SJM" MAXIMUM HEMOSTASIS INTRODUCER	406255:406258	EA	衛署醫器輸字第009856號	台灣雅培	許可證逾期,故取消給付。	21	111/10/01
44	CGS014065NST	"聖獸達"麥克斯導管導引器	"SJM" MAXIMUM HEMOSTASIS INTRODUCER	406652;406653	EA	衛署醫器輸字第009856號	台灣雅培	許可證逾期,故取消給付。	23	111/10/01
45	FHP01PM136ST	"聖獸達"薩斯坦植入式心臟節律器	"SJM" SUSTAIN XL IMPLANTABLE CARDIAC PULSE GENERATOR	XL SR PM1136	EA	衛署醫器輸字第023319號	台灣雅培	許可證逾期,故取消給付。	10	111/10/01
46	FHP02PM234ST	"聖獸達"薩斯坦植入式心臟節律器	"SJM" SUSTAIN XL IMPLANTABLE CARDIAC PULSE GENERATOR	XL DC PM2134	個	衛署醫器輸字第023319號	台灣雅培	許可證逾期,故取消給付。	9	111/10/01
47	FHP02PM236ST	"聖獸達"薩斯坦植入式心臟節律器-雙腔型	"SJM" SUSTAIN XL IMPLANTABLE CARDIAC PULSE GENERATOR(DDDR)	XL DR PM2136	個	衛署醫器輸字第023319號	台灣雅培	許可證逾期,故取消給付。	11	111/10/01
48	FHP01MR224ST	"聖獸達"艾森核磁共振心臟節律器	"SJM" ACCENT MRI PULSE GENERATOR	PM1124;PM1224	EA	衛署醫器輸字第023498號	台灣雅培	許可證逾期,故取消給付。	16	111/10/01
49	FHP02MR224ST	"聖獸達"艾森核磁共振心臟節律器:雙腔	"SJM" ACCENT MRI PULSE GENERATOR-DDDR(MRI)	PM2124;PM2224	個	衛署醫器輸字第023498號	台灣雅培	許可證逾期,故取消給付。	17	111/10/01
50	FHPL2LPAMRST	"聖獸達"核磁共振植入式心臟節律器導線	"SJM" Tendril MRI Implantable Cardiac Pacing Leads	LPA1200M	條	衛署醫器輸字第023525號	台灣雅培	許可證逾期,故取消給付。	12	111/10/01
51	NBS02M9662HQ	優泌速樂筆-胰島素注射筆	HUMAPEN LUXURA-INSULIN DELIVERY DEVICE	HUMAPENLUXURA;(MS9663自991001生效)	EA	衛署醫器輸字第017750號	禮來	許可證註銷,故取消給付。	2	111/10/01
52	FBSFAP239SSI	"信迪思"利洛挺頸椎植入物	"Synthes" Zero-P cervical Implants	(04.617.-110:112;115:119;120:122;125:129;130:132;135:139;170:172;175:179;180:182;185:189;190:192;195:199;210:212;215:219;220:222;225:229;230:232;235:239-S);(04.617.-812;814;816);(04.617.-812;814;816-.02S)	組	衛署醫器輸字第023590號	壯生	許可證逾期,故取消給付。	13	111/10/01

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共133項(項次1~項次133,詳頁次2-1~2-15)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至111年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	健保給付生效日期
53	TSS0100006QG	好生活血糖檢測系統:血糖試片	GOODLIFE BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM:GL GOODLIFE SERIES BLOOD GLUCOSE TEST STRIP	GOODLIFE(KPH)	片	衛署醫器製字第003663號	厚美德	許可證逾期,故取消給付。	80	111/10/01
54	FALSNWAVE15V	"惟視艾"艾卡瑞爾系列單焦人工水晶體	"VSY"ACRIVA SERIES INTRAOCULA LENS	ACRIVA HAF	片	衛部醫器輸字第029772號	科林	許可證逾期,故取消給付。	53	111/10/01
55	FALSNMULT35V	"惟視艾"艾卡瑞爾多焦人工水晶體	"VSY"ACRIVA REVIOL BB INTRAOCULAR LENS	ACRIVA REVIOL BB T MFM 611	片	衛部醫器輸字第029776號	科林	許可證逾期,故取消給付。	10	111/10/01
56	CMV01SFD31S9	"史賽克"充沛流量導引器	"Stryker" Surpass Streamline Flow Diverter	(M003-100:102-FPP0)(M003-110:115-FPP0)(M003-120:124-FPP0)	組	衛部醫器輸字第029622號	史賽克	許可證註銷,故取消給付。	7	111/10/01
57	FBKL17230NS2	"史賽克"全人工膝關節系統:脛骨襯墊	"STRYKER" SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM:TIBIAL INSERT	72-3-0308:1124;(型號72-13-0308:1124;自960101生效)	EA	衛署醫器輸字第009931號	史賽克	許可證註銷,故取消給付。	18	111/10/01
58	FBKL26000NS2	"史賽克"全人工膝關節系統:重建型脛骨襯墊	"STRYKER" SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM:REVISION TIBIAL INSERT	72-40308:72-49124	EA	衛署醫器輸字第009931號	史賽克	許可證註銷,故取消給付。	6	111/10/01
59	FBKP17331NS2	"史賽克"全人工膝關節系統:髌骨	"STRYKER" SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM:PATELLA	73-3110:3910;(980101更正為73-3110:3308;3508;3708;3710;3910)	EA	衛署醫器輸字第009931號	史賽克	許可證註銷,故取消給付。	19	111/10/01
60	FBKPA8100NS2	"史賽克"全人工膝關節組(高彎曲度)	"STRYKER" SCORPIO NRG TOTAL KNEE SYSTEM	82-2-0308:82-3-1124;80-4403L:80-4413R;81-4403R:81-4413L;7115-0003:7115-0013;73-3110:3910;3044-0026:0032	SET	衛署醫器輸字第016983號 +021200號 +021655號 +009931號 +010568號	史賽克	許可證註銷,故取消給付。	14	111/10/01
61	FBKRA6000NS2	"好美得卡-奧斯得寧"斯高比歐人工膝關節系統:再置換	"HOWMEDICA OSTEONICS" SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM:REVISION SYSTEM	1010401重新整理由以下特材組合;FBKF26000NS2;FBKT26000NS2;FBKL26000NS2;FBKP17331NS2	SET	衛署醫器輸字第021496號 +009931號	史賽克	許可證註銷,故取消給付。	6	111/10/01
62	CDP01PS200KQ	"優式"鉑絲第導管導入器組-(21GA 套管式診斷針+同軸4FR擴張器+6FR 護套組+導線*1(0.018英吋))	"Uresil" POSI-STICK 2 Introducer Sets-(21GA DIAGNOSTIC NEEDLE+COAXIAL 4FR DILATOR+ 6FR SHEATH SET+GUIDEWIRE*1(0.018"))	PS2-00	組	衛部醫器輸字第029672號	美實	許可證逾期,故取消給付。	7	111/10/01

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共133項（項次1~項次133，詳頁次2-1~2-15）										
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至111年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	健保給付生效日期
63	CDP01PS21SKQ	"優式"鉑絲第導管導入器組-(5FR 含鎖定制導針之擴張器+0.038英寸導線)	"Uresil" POSI-STICK 2 INTRODUCER SETS-(5FR DILATOR WITH LOCKING TROCAR+GUIDEWIRE*1(0.038"))	PS2-1S	組	衛部醫器輸字第029672號	美實	許可證逾期，故取消給付。	7	111/10/01
64	CDP01PS238KQ	"優式"鉑絲第導管導入器組-(21GA 套管式診斷針+同軸4FR擴張器+6FR 護套組+導線*2(0.018, 0.035英寸 OR 0.038英寸))	"URESIL" POSI-STICK 2 INTRODUCER SETS-(NEEDLE+COAXIAL 4FR DILATOR+6FR SHEATH SET+GUIDEWIRE*2(0.018, 0.035" or 0.038"))	PS2-35;PS2-38;PS2-35SW;PS2-38SW	組	衛部醫器輸字第029672號	美實	許可證逾期，故取消給付。	4	111/10/01
65	CGDW1PS218KQ	"優式"鉑絲第導管導入器組-0.018英寸鎳鉻合金導線(帶有軟性白金前端，70CM)	"URESIL" POSI-STICK 2 INTRODUCER SETS-(0.018" NITINOL GUIDEWIRE WITH FLOPPY PLATINUM TIP, 70CM)	PS2-18	條	衛部醫器輸字第029672號	美實	許可證逾期，故取消給付。	1	111/10/01
66	FBA022867NSN	"施樂輝"骨釘與骨板:Π型骨釘(鈷鉻鉗)	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE: BONE STAPLE	12-8673:75	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期，故取消給付。	1	111/10/01
67	FBA022868NSN	"施樂輝"骨釘與骨板:Π型骨釘(鈷鉻鉗)	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE: BONE STAPLE	12-8698:99	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期，故取消給付。	2	111/10/01
68	FBA022869NSN	"施樂輝"骨釘與骨板:Π型骨釘(鈷鉻鉗)	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE: BONE STAPLE	12-8690:97	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期，故取消給付。	5	111/10/01
69	FBA022872NSN	"施樂輝"骨釘與骨板:Π型骨釘(鈷鉻鉗)	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE: BONE STAPLE	12-8720:27	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期，故取消給付。	5	111/10/01
70	FBEPF2482NSN	"施樂輝"骨釘與骨板:半針	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE: HALF PIN	12-4828:30	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期，故取消給付。	4	111/10/01
71	FBEPF24831SN	"施樂輝"骨釘與骨板:半針	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE: HALF PIN	12-4831	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期，故取消給付。	4	111/10/01
72	FBEPF2483NSN	"施樂輝"骨釘與骨板:半針	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE: HALF PIN	12-4833	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期，故取消給付。	6	111/10/01

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共133項（項次1~項次133，詳頁次2-1~2-15）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至111年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	健保給付生效日期
73	FBEP248XNSN	"施樂輝"骨釘與骨板:全針	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE:FULL PIN	12-4826	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期，故取消給付。	5	111/10/01
74	FBP011403NSN	"施樂輝"骨釘與骨板:1/3管型骨板	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE:ONE-THIRD TUBULAR PLATE	71140-302:308;309:312	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期，故取消給付。	8	111/10/01
75	FBP011413NSN	"施樂輝"骨釘與骨板:1/2管型骨板	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE:SEMI-TUBULAR PLATE	71141-302:307;308:312	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期，故取消給付。	7	111/10/01
76	FBP011480NSN	"施樂輝"骨釘與骨板:1/4管型骨板	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE:QUARTER TUBULAR PLATE	71148-003:008	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期，故取消給付。	6	111/10/01
77	FBP021402NSN	"施樂輝"骨釘與骨板:小型T/L骨板	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE:SMALL PLATE	71140-202:212	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期，故取消給付。	14	111/10/01
78	FBP021412NSN	"施樂輝"骨釘與骨板:加壓骨板	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE:BROAD PLATE	71141-206:218	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期，故取消給付。	14	111/10/01
79	FBP021414NSN	"施樂輝"骨釘與骨板:加壓骨板	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE:NARROW PLATE	71141-402:416;418:424	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期，故取消給付。	12	111/10/01
80	FBP021460NSN	"施樂輝"骨釘與骨板:迷你骨板	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE:MINI PLATE	71146-020:026	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期，故取消給付。	5	111/10/01
81	FBP026028NSN	"施樂輝"骨釘與骨板:迷你骨板	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE:MINI PLATE	7114-6028	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期，故取消給付。	13	111/10/01
82	FBP031005NSN	"施樂輝"骨釘與骨板:骨板	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE:TIBIAL HEAD BUTTRESS PLATE	7114-1005:1113	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期，故取消給付。	8	111/10/01
83	FBP031400NSN	"施樂輝"骨釘與骨板:重建型骨板	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE:RECONTRACTION PLATE	71140-003:016	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期，故取消給付。	19	111/10/01

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共133項(項次1~項次133,詳頁次2-1~2-15)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至111年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	健保給付生效日期
84	FBP031406NSN	"施樂輝"骨釘與骨板:骨板	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE:CLOVERLEAF PLATE	71140-603:604	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期,故取消給付。	8	111/10/01
85	FBP031407NSN	"施樂輝"骨釘與骨板:骨板	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE:BUTTRESS PLATE	71140-704:706;804:904	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期,故取消給付。	23	111/10/01
86	FBP031415NSN	"施樂輝"骨釘與骨板:骨板	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE:SPOON PLATE	71141-505:506	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期,故取消給付。	6	111/10/01
87	FBP031416NSN	"施樂輝"骨釘與骨板:骨板	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE:BUTTRESS PLATE	71141-603:608	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期,故取消給付。	23	111/10/01
88	FBP03401XNSN	"施樂輝"骨釘與骨板:重建型骨板	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE:RECONTRACTION PLATE	71140-104:122;606:618	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期,故取消給付。	19	111/10/01
89	FBP03404XNSN	"施樂輝"骨釘與骨板:T型骨板	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE:T-PLATE	71140-403:406	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期,故取消給付。	14	111/10/01
90	FBP03405XNSN	"施樂輝"骨釘與骨板:T型骨板	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE:T-PLATE	71140-503:505	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期,故取消給付。	14	111/10/01
91	FBP03460XNSN	"施樂輝"骨釘與骨板:迷你型骨板	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE:MINI PLATE	7114-6031;6033:6038;6044:6047	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期,故取消給付。	15	111/10/01
92	FBP035020NSN	"施樂輝"骨釘與骨板:迷你型骨板	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE:MINI PLATE	7114-5020	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期,故取消給付。	13	111/10/01
93	FBP04142XNSN	"施樂輝"骨釘與骨板:彎角型骨板	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE:ANGLED BLADE PLATE	71142-007:015;107:115	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期,故取消給付。	10	111/10/01
94	FBP04254XNSN	"施樂輝"骨釘與骨板:彎角型骨板	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE:ANGLED BLADE PLATE	71225-400:422	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期,故取消給付。	10	111/10/01
95	FBS011622NSN	"施樂輝"骨釘與骨板:皮質骨釘	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE:CORTEX SCREW	711-61606:620;506:520;62206	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期,故取消給付。	14	111/10/01

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共133項(項次1~項次133,詳頁次2-1~2-15)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至111年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	健保給付生效日期
96	FBS01225XNSN	"施樂輝"骨釘與骨板:皮質骨釘4.5MM	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE:CORTEX SCREW 4.5MM	71225-014;070;072;145	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期,故取消給付。	11	111/10/01
97	FBS02223XNSN	"施樂輝"骨釘與骨板:鬆質骨釘	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE:CANCELLOUS SCREW	71223-010;100;210;250;255;300	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期,故取消給付。	12	111/10/01
98	FBS02229XNSN	"施樂輝"骨釘與骨板:鬆質骨釘	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE:CANCELLOUS SCREW	7122-6030;60;6075;6150	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期,故取消給付。	13	111/10/01
99	FBS032252NSN	"施樂輝"骨釘與骨板:踝骨骨釘	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE:MALLEOLAR SCREW	71225225;71225270	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期,故取消給付。	9	111/10/01
100	FBS04216XNSN	"施樂輝"骨釘與骨板:中空骨釘	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE:CANNULATED SCREW	12-1654;12-1668	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期,故取消給付。	21	111/10/01
101	FBS042170NSN	"施樂輝"骨釘與骨板:中空骨釘	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE:CANNULATED SCREW	121700;15;625;44;810;70	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期,故取消給付。	21	111/10/01
102	FBS071430NSN	"施樂輝"骨釘與骨板:墊片	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE:WASHER	71143010;43007;43013	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期,故取消給付。	10	111/10/01
103	FBW011610NSN	"施樂輝"骨釘與骨板:柯氏骨鋼絲	"SMITH & NEPHEW" TC-100 SCREW AND PLATE:K-WIRE	7116-2006;1008;1016;1020	EA	衛署醫器輸字第008699號	史耐輝	許可證逾期,故取消給付。	15	111/10/01
104	TSS014227AF9	福爾語音型血糖機:血糖試紙	FORA BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM	TD-4227	片	衛署醫器製字第002340號	泰博	許可證逾期,故取消給付。	80	111/10/01
105	TSS014231AF9	福爾易退片血糖測試系統:血糖試紙	FORA BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM	TD-4231	片	衛署醫器製字第002349號	泰博	許可證逾期,故取消給付。	80	111/10/01
106	FBEF1640014U	康定非動力式環型骨科牽引器及配件(未滅菌)-股骨基本組(全環+直型螺紋桿+六角螺母+六角螺釘+槽型墊片+內螺紋連接套)	Carefix Nonpowered orthopedic traction apparatus and accessories(Non-Sterile)-FEMORAL BASIC FRAME	按組件組合(6420-14-06;08;6420-11-00;20;40;60;80;6420-12-00;20;6411-40-30;40;60;80;6411-41-00;20;50;6411-60-40;60;80;6411-61-00;20;40;60;80;6411-62-00;50;6411-63-00;50;64116400;6416-1407;1610;6416-3410;6416-26-12;16;20;25;30;6417-24-09;14;64172612;6412-56-02;04;06)	組	衛部醫器陸輸壹字第003523號	海曼	許可證註銷,故取消給付。	3	111/10/01

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共133項(項次1~項次133,詳頁次2-1~2-15)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至111年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	健保給付生效日期
107	FBEF1640024U	康定非動力式環型骨科牽引器及配件(未滅菌)-股骨延長組(全環+直型螺紋桿+六角螺母+六角螺釘+槽型墊片+內螺紋連接套+延長調節器II型)	Carefix Nonpowered orthopedic traction apparatus and accessories(Non-Sterile)-FEMORAL LENGTHENING FRAME	按組件組合(6420-14-06;08;6420-11-00;20;40;60;80;6420-12-00;20;6411-40-30;40;60;80;6411-41-00;20;50;6411-60-40;60;80;6411-61-00;20;40;60;80;6411-62-00;50;6411-63-00;50;64116400;6416-1407;1610;6416-3410;6416-26-12;16;20;25;30;6417-24-09;14;64172612;6412-56-02;04;06;6458-26-04;06;08;10;12;14;16;6458-24-04;06)	組	衛部醫器陸輸壹字第003523號	海曼	許可證註銷,故取消給付。	4	111/10/01
108	FBEF1640034U	康定非動力式環型骨科牽引器及配件(未滅菌)-股骨移位組(全環+直型螺紋桿+六角螺母+六角螺釘+槽型墊片)	Carefix Nonpowered orthopedic traction apparatus and accessories(Non-Sterile)-FEMORAL BONE TRANSPORT FRAME	按組件組合(6420-14-06;08;6420-11-00;20;40;60;80;6420-12-00;20;6411-40-30;40;60;80;6411-41-00;20;50;6411-60-40;60;80;6411-61-00;20;40;60;80;6411-62-00;50;6411-63-00;50;64116400;6416-1407;1610;6416-3410;6416-26-12;16;20;25;30;6417-24-09;14;64172612)	組	衛部醫器陸輸壹字第003523號	海曼	許可證註銷,故取消給付。	3	111/10/01
109	FBEF2640014U	康定非動力式環型骨科牽引器及配件(未滅菌)-脛骨基本組(全環+直型螺紋桿+六角螺母+六角螺釘+槽型墊片+內螺紋連接套)	Carefix Nonpowered orthopedic traction apparatus and accessories(Non-Sterile)-TIBIAL BASIC FRAME	按組件組合(6420-14-06;08;6420-11-00;20;40;60;80;6420-12-00;20;6411-40-30;40;60;80;6411-41-00;20;50;6411-60-40;60;80;6411-61-00;20;40;60;80;6411-62-00;50;6411-63-00;50;64116400;6416-1407;1610;6416-3410;6416-26-12;16;20;25;30;6417-24-09;14;64172612;6412-56-02;04;06)	組	衛部醫器陸輸壹字第003523號	海曼	許可證註銷,故取消給付。	4	111/10/01
110	FBEF2640024U	康定非動力式環型骨科牽引器及配件(未滅菌)-脛骨移位組(全環+直型螺紋桿+六角螺母+六角螺釘+槽型墊片)	Carefix Nonpowered orthopedic traction apparatus and accessories(Non-Sterile)-TIBIAL BONE TRANSPORT FRAME	按組件組合(6420-14-06;08;6420-11-00;20;40;60;80;6420-12-00;20;6411-40-30;40;60;80;6411-41-00;20;50;6411-60-40;60;80;6411-61-00;20;40;60;80;6411-62-00;50;6411-63-00;50;64116400;6416-1407;1610;6416-3410;6416-26-12;16;20;25;30;6417-24-09;14;64172612;)	組	衛部醫器陸輸壹字第003523號	海曼	許可證註銷,故取消給付。	3	111/10/01

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共133項(項次1~項次133,詳頁次2-1~2-15)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至111年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	健保給付生效日期
111	FBEF2640034U	康定非動力式環型骨科牽引器及配件(未滅菌)-脛骨延長組(全環+直型螺紋桿+六角螺母+六角螺釘+槽型墊片+內螺紋連接套+延長調節器II型)	Carefix Nonpowered orthopedic traction apparatus and accessories(Non-Sterile)-TIBIAL SINGLE LENGTHENING FRAME	按組件組合(6420-14-06;08;6420-11-00;20;40;60;80;6420-12-00;20;6411-40-30;40;60;80;6411-41-00;20;50;6411-60-40;60;80;6411-61-00;20;40;60;80;6411-62-00;50;6411-63-00;50;64116400;6416-1407;1610;6416-3410;6416-26-12;16;20;25;30;6417-24-09;14;64172612;6412-56-02:04;06;6458-26-04;06;08;10;12;14;16;6458-24-04;06)	組	衛部醫器陸輸壹字第003523號	海曼	許可證註銷,故取消給付。	4	111/10/01
112	FBEF2640044U	康定非動力式環型骨科牽引器及配件(未滅菌)-脛骨雙層延長組(全環+直型螺紋桿+六角螺母+六角螺釘+槽型墊片+內螺紋連接套+延長調節器II型)	Carefix Nonpowered orthopedic traction apparatus and accessories(Non-Sterile)-TIBIAL DOUBLE LENGTHENING FRAME	按組件組合(6420-14-06;08;6420-11-00;20;40;60;80;6420-12-00;20;6411-40-30;40;60;80;6411-41-00;20;50;6411-60-40;60;80;6411-61-00;20;40;60;80;6411-62-00;50;6411-63-00;50;64116400;6416-1407;1610;6416-3410;6416-26-12;16;20;25;30;6417-24-09;14;64172612;6412-56-02:04;06;6458-26-04;06;08;10;12;14;16;6458-24-04;06)	組	衛部醫器陸輸壹字第003523號	海曼	許可證註銷,故取消給付。	4	111/10/01
113	FBEF2640054U	康定非動力式環型骨科牽引器及配件(未滅菌)-脛骨畸形組(全環+直型螺紋桿+六角螺母+六角螺釘+槽型墊片+內螺紋連接套+內螺紋扁柱)	Carefix Nonpowered orthopedic traction apparatus and accessories(Non-Sterile)-TIBIAL DEFORMITY FRAME	按組件組合(6420-14-06;08;6420-11-00;20;40;60;80;6420-12-00;20;6411-40-30;40;60;80;6411-41-00;20;50;6411-60-40;60;80;6411-61-00;20;40;60;80;6411-62-00;50;6411-63-00;50;64116400;6416-1407;1610;6416-3410;6416-26-12;16;20;25;30;6417-24-09;14;64172612;6412-56-02:04;06;6414-56-01:06)	組	衛部醫器陸輸壹字第003523號	海曼	許可證註銷,故取消給付。	3	111/10/01
114	FBEF3640014U	康定非動力式環型骨科牽引器及配件(未滅菌)-踝骨基本組(全環+直型螺紋桿+六角螺母+六角螺釘+槽型墊片+內螺紋連接套)	Carefix Nonpowered orthopedic traction apparatus and accessories(Non-Sterile)-ANKLE BASIC FRAME	按組件組合(6420-14-06;08;6420-11-00;20;40;60;80;6420-12-00;20;6411-40-30;40;60;80;6411-41-00;20;50;6411-60-40;60;80;6411-61-00;20;40;60;80;6411-62-00;50;6411-63-00;50;64116400;6416-1407;1610;6416-3410;6416-26-12;16;20;25;30;6417-24-09;14;64172612;6412-56-02:04;06)	組	衛部醫器陸輸壹字第003523號	海曼	許可證註銷,故取消給付。	4	111/10/01

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共133項(項次1~項次133,詳頁次2-1~2-15)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至111年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	健保給付生效日期
115	FBEF4640014U	康定非動力式環型骨科牽引器及配件(未滅菌)-肱骨基本組(全環+直型螺紋桿+六角螺母+六角螺釘+槽型墊片+內螺紋連接套)	Carefix Nonpowered orthopedic traction apparatus and accessories(Non-Sterile)-HUMERAL BASIC FRAME	按組件組合(6420-14-06;08;6420-11-00;20;40;60;80;6420-12-00;20;6411-40-30;40;60;80;6411-41-00;20;50;6411-60-40;60;80;6411-61-00;20;40;60;80;6411-62-00;50;6411-63-00;50;64116400;6416-1407;1610;6416-3410;6416-26-12;16;20;25;30;6417-24-09;14;64172612;6412-56-02;04;06)	組	衛部醫器陸輸壹字第003523號	海曼	許可證註銷,故取消給付。	3	111/10/01
116	FBEF4640024U	康定非動力式環型骨科牽引器及配件(未滅菌)-肱骨移位組(全環+直型螺紋桿+六角螺母+六角螺釘+槽型墊片)	Carefix Nonpowered orthopedic traction apparatus and accessories(Non-Sterile)-HUMERAL BONE TRANSPORT FRAME	按組件組合(6420-14-06;08;6420-11-00;20;40;60;80;6420-12-00;20;6411-40-30;40;60;80;6411-41-00;20;50;6411-60-40;60;80;6411-61-00;20;40;60;80;6411-62-00;50;6411-63-00;50;64116400;6416-1407;1610;6416-3410;6416-26-12;16;20;25;30;6417-24-09;14;64172612)	組	衛部醫器陸輸壹字第003523號	海曼	許可證註銷,故取消給付。	3	111/10/01
117	CLS0501648HR	"赫士睿"浦朗幫浦輸液套管組	"HOSPIRA" PLUMSET I. V. PUMP SET	1648;1651	SET	衛署醫器輸字第009812號	艾希優	許可證逾期,故取消給付。	1	111/10/01
118	CLS0602427HR	"赫士睿"浦朗幫浦輸液套管組	"HOSPIRA" PLUMSET I. V. PUMP SET	2427	SET	衛署醫器輸字第009812號	艾希優	許可證逾期,故取消給付。	2	111/10/01
119	LEE01TBVRHKH	"奧斯卡"暫時型心律調節器導線	"OSCOR" TB TEMPORARY BIPOLAR PACING LEAD	TBV4FS;TBV5FS;TBV6FS;TBV4FU;TBV5FU;TBV6FU;TB RH4FS;TBRH5FS;TBRH6FS;TBRH4FU;TBRH5FU;TBRH6FU	組	衛署醫器輸字第023510號	傳永	許可證逾期,故取消給付。	4	111/10/01
120	TSS01G421SVL	愛奧樂血糖測試儀:專用試紙	BIOLAND BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM	G-421S	片	衛署醫器製字第002341號	愛奧樂	許可證逾期,故取消給付。	80	111/10/01
121	FALSNTORCIA1	"愛爾康"可舒妥瑞明散光矯正單片型軟式人工水晶體(可濾部分藍光):散光功能軟式人工水晶體	ACRYSOF TORIC SINGLE-PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS	SN60T3;SN60T4;SN60T5	EA	衛署醫器輸字第018269號	愛爾康	許可證逾期,故取消給付。	30	111/10/01
122	FALSNMULTTA1	"愛爾康"可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體(可濾部分藍光)	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS	SND1T2;SND1T3;SND1T4;SND1T5;(SND1T6自1041101生效)	片	衛署醫器輸字第023602號	愛爾康	許可證逾期,故取消給付。	10	111/10/01
123	FBA04SB050PQ	"瑞安"生骨替代物	"PURZER" SINBONE BONE REPLACEMENT	SB050;SB060	EA	衛署醫器製字第000948號	瑞安	許可證逾期,故取消給付。	2	111/10/01
124	FBA04SB0X0PQ	"瑞安"生骨替代物	"PURZER" SINBONE BONE REPLACEMENT	SB010;SB020	BOX	衛署醫器製字第000948號	瑞安	許可證逾期,故取消給付。	2	111/10/01

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共133項(項次1~項次133,詳頁次2-1~2-15)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至111年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	健保給付生效日期
125	FALSNWAVE6HY	豪雅預載式單片型人工水晶體:非球面+黃色人工水晶體	HOYA iSert Preloaded Intraocular Lens	251	片	衛部醫器輸字第030443號	維州	許可證註銷,故取消給付。	53	111/10/01
126	CRG0329651UC	愛治喘噴藥輔助器	AeroChamber Vent Chamber	85851	個	衛部醫器輸字第029651號	銓鼎	許可證逾期,故取消給付。	2	111/10/01
127	WDD08X1111QY	"新世捷"德力裁剪型不自黏親水性敷料(滅菌):11CM×11CM	"SYSTAGENIX" TIELLE XTRA NON-ADHESIVE HYDROPOLYMER DRESSING (STERILE):11CM×11CM	MTP301	EA	衛署醫器輸壹字第011347號	德嘉	許可證逾期,故取消給付。	2	111/10/01
128	WDD08X1520QY	"新世捷"德力裁剪型不自黏親水性敷料(滅菌)15X20CM	"SYSTAGENIX" TIELLE XTRA NON-ADHESIVE HYDROPOLYMER DRESSING (STERILE)15X20CM	MTP302	EA	衛署醫器輸壹字第011347號	德嘉	許可證逾期,故取消給付。	13	111/10/01
129	WDD08P9595QY	"新世捷"德力填塞型親水性敷料(滅菌):9.5CM×9.5CM	"SYSTAGENIX" TIELLE PACKING HYDROPOLYMER DRESSING (STERILE):HYDROCOLLOID DRESSING 9.5CM×9.5CM	MT2450	EA	衛署醫器輸壹字第011629號	德嘉	許可證逾期,故取消給付。	38	111/10/01
130	FALSNTORCY1W	千禧力視非球面散光矯正單片型人工水晶體(非球面、散光矯正、可濾部份藍光)	MBI PreciSAL Toric One-Piece Intraocular Lens (Aspheric, Toric, Blue Light-Filtering)	SAL T302A	片	衛部醫器輸字第029413號	應用奈米	許可證逾期,故取消給付。	30	111/10/01
131	CKN02NS004SG	十美牌腎盂管	SIGMA NEPHROSTOMY CATHETER	NS004	條	衛部醫器製字第005729號	聯和	許可證逾期,故取消給付。	4	111/10/01
132	CPM01SC441SG	"十美牌"中央靜脈壓測量套	"SIGMA" CVP-SCALE SYSTEM:CVP SCALE SYSTEM+3 WAY	SC441	SET	衛署醫器製字第000658號	聯和	許可證逾期,故取消給付。	2	111/10/01
133	FBHL11260NS2	"史賽克"全人工髖關節系統:髖臼杯內襯	"STRYKER" OMNIFIT HIP SYSTEM:HA HIP INSERT	2001;2041;2041C-26XX;28XX	EA	衛署醫器輸字第010012號	史賽克	許可證註銷,故取消給付。	19	111/10/01

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

二、核價類別變更及價格調整品項共1項(項次134, 詳頁次2-16)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	原核價類別	原支付點數	初核變更之核價類別	變更後支付點數	變更核價類別說明	給付規定	健保給付生效日期
134	CEP0108317P2	"太平洋" 壓力延長管	"PAHSCO" PRESSURE TUBE	I08317:8;I08323:4;I08329:30(刪除 I08324;I08329;I08330自 1110501生 效);(I08320;I08321;I08418自1110501生 效);(I08401:2;I08316;I08427:8;I08403:5;I08417;I08327自1120401生效)	個	衛署醫器製字第000996號	太平洋	輸液連接管/ 低壓 (≤300PSI)/ ANY SIZE	6.3	壓力連接管/ 中壓(300- 799PSI)/ANY SIZE/附M-F 接頭	25.3	1. 依醫療器材許可證變更功能類別, 自CEE01A1(輸液連接管/低壓(≤300PSI)/ANY SIZE)變更為CEP01A1(壓力連接管/中壓(300-799PSI)/ANY SIZE/附M-F接頭), 並依CEP01A1同功能類別(如特材代碼CEP01ETP01M6)調整支付點數。2. 併同擴增產品型號 I08401:2;I08316;I08427:8;I08403:5;I08417;I08327。	無	112/04/01

報告案 3

111 年收載新功能類別特材申報情形及預算支用結果
報告案。

報告案第 3 案

案由：111 年收載新功能類別特材申報情形及預算支用結果報告案。

說明：

- 一、 111 年「新醫療科技」項目新增新功能特材預算，醫院總額部門為 7.64 億元，西醫基層未編列預算。
- 二、 截至 8 月，本會議通過之新特材計 124 品項及修訂給付規定 1 項，推估預算約 6.61 億元，已完成公告生效新特材計 96 品項及修訂給付規定 1 項，另 28 品項依程序辦理公告及依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第 61-1 條規定辦理相關事宜。
- 三、 爰上開完成公告實施之新功能特材計 96 品項及修訂給付規定 1 項，推估預算約 5.65 億元，經扣減被替代品項點數後，111 年截至 7 月該些公告特材醫院實際申報點數約 0.93 億點，西醫基層尚無申報資料（詳附件，頁次：報 3-2~報 3-8）。

報告案第3案 111年起收載新功能特材申報情形報告案

【附件】

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共擬會議日 期	單位	新功能特材 納入時支付點 數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估			新功能特材 生效日起 111年(截至7月)申報數 -醫院總額		新功能特材 生效日起 111年(截至7月)申報數 -西醫基層		新功能特材 生效日起 111年(截至7月)實際申報點數 -醫院總額		新功能特材 生效日起 111年(截至7月)實際申報點數 -西醫基層			
									被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=BC*成長率 或 (2)E=共擬會議討論之推估 量	被替代品項 支付點數 Re	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 G	申報點數 H (千點)	申報使用量 I	申報點數 J (千點)	1.申報年度無調整支付點數： F=(A-Re)*G(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點)	1.申報年度無調整支付點數： F=(A-Re)*I(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點)	
13	雙迴路透析導管組	111/3/1	CKDD1390062C	"柯惠"急性血液透 析導管(C+N+G+D)- 小兒	111/1/20	組	2,031	2,031													
14	雙迴路透析導管組	111/3/1	CKDD1390012C	"柯惠"急性血液透 析導管(C+N+G+D)- 小兒	111/1/20	組	2,031	2,031				8	17								
15	雙迴路透析導管組	111/3/1	CKDD1HD001BQ	"邦特"血液透析導 管組-小兒	111/1/20	組	2,031	2,031													
16	雙迴路透析導管組	111/3/1	CKDD2SL02PM0	"美德康"矽質血液 透析導管與配件-小 兒	111/1/20	組	6,040	6,040	40		101	14	89				35				
17	雙迴路透析導管組	111/3/1	CKDD2SL08PM0	"美德康"長期矽質 血液透析導管與配 件-小兒	111/1/20	組	6,040	6,040													
											【說明】 原支付點數3,509點 ，111/3/1拆分出兒 童使用之功能核價類 別，調整支付點數為 6,040，財務支出共 101,000點【6,040- 3,509*40】。										
18	客製化電腦輔助型 顱顏骨固定系統組 (骨網片+骨釘)	111/4/1	FPP08KTGB465	"西安康拓"顱骨 修補系統	111/1/20	組	108,893	108,893	15%	316	48	90,744	871								
											【說明】 目前顱骨缺損修補，仍 以Ti-Mesh為主流，本 案醫材主要用於某些其 達不到的情況，且使用 上需事前審查，爰預估 使用量約為Ti-Mesh的 10%-15%。										
19	青光眼引流裝置	111/4/1	FAD013422652	保羅青光眼房水引 流植入物	111/1/20	組	28,855	28,855		5	60	19,900	537	1	30			54			
20	青光眼引流裝置	111/4/1	FAD01K120951	愛減青光眼用舒壓 導流瓣膜	111/1/20	組	28,855	28,855						5	151						
											【說明】 本案特材相對應診療項 目為「青光眼導管置入 術(診療項目代碼： 85823B)」，依學會代 表及與會專家共識，年 使用量約為60組。										

報告案第3案 111年起收載新功能特材申報情形報告案

【附件】

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共擬會議日 期	新功能特材 單位 納入時支付點 數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估			新功能特材 生效日起 111年(截至7月)申報數 -醫院總額		新功能特材 生效日起 111年(截至7月)申報數 -西醫基層		新功能特材 生效日起 111年(截至7月)實際申報點數 -醫院總額		新功能特材 生效日起 111年(截至7月)實際申報點數 -西醫基層		
								被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=BC*成長率 或 (2)E=共擬會議討論之推估 量	被替代品項 支付點數 Re	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 G	申報點數 H (千點)	申報使用量 I	申報點數 J (千點)	1.申報年度無調整支付點數： F-(A-Re)*G(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點)	1.申報年度無調整支付點數： F-(A-Re)*I(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點)
21	肋骨固定骨板	111/5/1	FBPR1MTRPLS1	“信迪思”梅翠思 肋骨固定系統-肋骨 骨板	111/1/20	個	38,151	38,151	無										
22	肋骨固定骨板	111/5/1	FBPR1MXRPLS1	“信迪思”梅翠思 肋骨固定系統-肋骨 骨板	111/1/20	個	38,151	38,151		【說明】 每人給付3個骨板為限 ，預估使用量510人， 預估年使用量1,530 【510*3】。	【說明】 每人給付3個骨板及 18支骨釘為限，計 206,253點 【38,151*3+5,100*1 8】，預估使用量510 人，財務支出共 105,189,030點 【206,253*510】。		245	9,347					
23	肋骨固定骨板	111/5/1	FBPR1RFBRPWR	“生邁”藍帶肋骨 固定系統-肋骨骨板	111/1/20	個	38,151	38,151					95	3,624					
24	肋骨固定骨板	111/5/1	FBPR106178JP	愛派司肋骨固定系 統-肋骨鎖定骨板	111/1/20	個	38,151	38,151					208	7,958					
25	肋骨固定骨板	111/5/1	FBPR17083253	鉋賽總固定系統- 2.4mm 鎖定加壓骨 板(肋骨)	111/1/20	個	38,151	38,151					9	343					
26	肋骨固定骨板	111/5/1	FBPR141106Y2	“亞太醫療”肋骨 固定系統-肋骨骨板	111/1/20	個	38,151	38,151											
27	肋骨固定骨板	111/5/1	FBPR12950854	“奧澄”肋骨骨板 系統-肋骨骨板	111/1/20	個	38,151	38,151					33	1,259					
28	肋骨固定骨板	111/5/1	FBPR10000156	“柯斯達”肋骨固 定系統-肋骨鎖定骨 板	111/1/20	個	38,151	38,151					40	1,526					
29	肋骨固定骨板	111/5/1	FBPR1RSRBP57	“苜思特”鈦金屬 內固定系統-肋骨骨 板	111/1/20	個	38,151	38,151											
30	肋骨固定骨板	111/9/1	FBPR173581V2	“總欵”胸肋骨板 系統-肋骨骨板	新增既有 品項	個	38,151	38,151											
31	肋骨鎖定骨釘	111/5/1	FBSR1MTRSCS1	“信迪思”梅翠思 肋骨固定系統-肋骨 骨釘	111/1/20	支	5,100	5,100		9,180			618	3,309					
32	肋骨鎖定骨釘	111/5/1	FBSR1MXRSCS1	“信迪思”梅翠思 肋骨固定系統-肋骨 骨釘	111/1/20	支	5,100	5,100		【說明】 每人給付18支骨釘限， 預估使用量510人，預 估年使用量9,180 【510*18】。			1,555	8,282					
33	肋骨鎖定骨釘	111/5/1	FBSR1RFBR5WR	“生邁”藍帶肋骨 固定系統-肋骨骨釘	111/1/20	支	5,100	5,100					589	3,150					
34	肋骨鎖定骨釘	111/5/1	FBSR106178JP	愛派司肋骨固定系 統-肋骨鎖定螺釘	111/1/20	支	5,100	5,100					1,173	6,255					
35	肋骨鎖定骨釘	111/5/1	FBSR17083353	鉋賽總固定系統-肋 骨鎖定骨釘	111/1/20	支	5,100	5,100					54	289					
36	肋骨鎖定骨釘	111/5/1	FBSR144207Y2	“亞太醫療”肋骨 固定系統- 2.4,2.7,2.9鎖定骨 釘	111/1/20	支	5,100	5,100											
37	肋骨鎖定骨釘	111/5/1	FBSR12950854	“奧澄”骨釘系統- 2.7mm互鎖骨釘	111/1/20	支	5,100	5,100					180	964					
38	肋骨鎖定骨釘	111/5/1	FBSR10000256	“柯斯達”肋骨固 定系統-鎖定骨釘	111/1/20	支	5,100	5,100					246	1,317					
39	肋骨鎖定骨釘	111/5/1	FBSR1RSRBS57	“苜思特”鈦金屬 內固定系統-肋骨鎖 定骨釘	111/1/20	支	5,100	5,100											
40	肋骨鎖定骨釘	111/9/1	FBSR173582V2	“總欵”胸肋骨板 系統-肋骨鎖定骨釘	新增既有 品項	支	5,100	5,100											

報告案第3案 111年起收載新功能特材申報情形報告案

【附件】

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共擬會議日 期	新功能特材 單位 納入時支付點 數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估			新功能特材 生效日起 111年(截至7月)申報數		新功能特材 生效日起 111年(截至7月)申報數		新功能特材 生效日起 111年(截至7月)實際申報點數		新功能特材 生效日起 111年(截至7月)實際申報點數			
								被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=BC*成長率 或 (2)E=共擬會議討論之推估 量	被替代品項 支付點數 Re	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 G	申報點數 H (千點)	申報使用量 I	申報點數 J (千點)	醫院總額 -醫院總額	醫院總額 -西醫基層	醫院總額 -醫院總額
41	門形骨釘 BONE STAPLE	111/5/1	FBA02176228B	“拜歌博”門型釘	111/3/17	個	19,551	19,551	結絡鉗門型骨釘、埋頭中空加壓骨釘	100%、50%	400、360	1,000	978、12,000							
42	門形骨釘 BONE STAPLE	111/5/1	FBA0240120W2	“瑞德”夏勒足踝骨釘骨板系統-爪型骨板骨釘組	111/3/17	組	19,551	19,551												
43	門形骨釘 BONE STAPLE	111/5/1	FBA0243110W2	“瑞德”夏勒足踝骨釘骨板系統-加壓骨釘(加壓騎馬釘)	111/3/17	組	19,551	19,551						8	164					
44	門形骨釘 BONE STAPLE	111/5/1	FBA0240130W2	“瑞德”夏羅特足踝固定系統-爪型骨板組	111/3/17	組	19,551	19,551												
45	門形骨釘 BONE STAPLE	111/5/1	FBA0243111W2	“瑞德”夏羅特足踝固定系統-加壓骨釘	111/3/17	個	19,551	19,551												
46	門形骨釘 BONE STAPLE	111/5/1	FBA02294668C	“艾克曼”動力加壓式骨板	111/3/17	組	19,551	19,551												
47	周邊血管內套膜支架	111/6/1	CBC07BXA01GX	“艾爾”威爾棒球囊擴張式人工血管支架-含生物表面肝素塗層	111/1/20	組	87,800	87,800	周邊動脈血管支架及傳輸裝置-含生物表面肝素塗層(自膨式支架含人工血管, 支架長25:99mm)、周邊動脈血管支架及傳輸裝置(球擴式覆膜支架, 直徑5:11mm)、周邊動脈血管支架及傳輸裝置(球擴式覆膜支架, 直徑12:16mm)	15%、90%、90%	2789、746、21	1,212	64,552、79,852、95,078							
48	深層腦部刺激器之立體定位套組	111/6/1	FND04FM400M4	“美敦力”基準點標記物(5個)	111/3/17	組	30,600	30,600	無			283	21,996	10	306				1,097	
49	深層腦部刺激器之立體定位套組	111/6/1	FND04FC291M4	“美敦力”微目標新動脈系統及“美敦力”微目標電極(植入管套組1組及微目標電極1個)	111/3/17	組	34,250	34,250				99		1	34					
50	深層腦部刺激器之立體定位套組	111/6/1	FND04FC292M4	“美敦力”微目標新動脈系統及“美敦力”微目標電極(植入管套組1組及微目標電極2個)	111/3/17	組	54,050	54,050				184		14	757					
51	輸尿管組	111/7/1	CKD0103901CK	“曲克”舒笑列雙豬尾支架組-兒科	111/5/19	組	4,500	4,500	無			200	900							

報告案第3案 111年起收載新功能特材申報情形報告案

【附件】

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共擬會議日 期	單位	新功能特材 納入時支付點 數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估			新功能特材 生效日起 111年(截至7月)申報數		新功能特材 生效日起 111年(截至7月)申報數		新功能特材 生效日起 111年(截至7月)實際申報點數	新功能特材 生效日起 111年(截至7月)實際申報點數	
									被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=BC*成長率 或 (2)E=共擬會議討論之推估 量	被替代品項 支付點數 Re	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 G	申報點數 H (千點)	申報使用量 I	申報點數 J (千點)
52	顱內壓監測裝置	111/7/1	CPV01SPB01AE	雅氏-史密伯格 顱內壓監測器-測量探 針	111/3/17	組	19,607	19,607	無			2,100		61,483	30	615		2,844
53	顱內壓監測裝置	111/7/1	CPV0182631CM	"柯特曼"顱內壓監 視器用監測裝置-顱 內壓監測裝置基本 組	111/3/17	組	19,607	19,607							13	268		
54	顱內壓監測裝置	111/7/1	CPV0182632CM	"柯特曼"顱內壓監 視器用監測裝置-顱 內壓監測裝置	111/3/17	組	19,607	19,607							39	803		
55	顱內壓監測裝置	111/7/1	CPV0182638CM	"柯特曼"顱內壓監 視器用監測裝置-顱 內壓監測裝置顱柱 組	111/3/17	組	19,607	19,607										
56	顱內壓監測裝置	111/7/1	CPV011104G79	"納特思" 凱米諾 顱內壓監測導管	111/3/17	組	19,607	19,607							6	124		
57	顱內壓監測裝置	111/7/1	CPV019294692	"諾美德科" 顱內 監測器-導管 (NEUROVENT-P/顱內 壓)	111/3/17	組	19,607	19,607							33	679		
58	顱內壓監測裝置	111/7/1	CPV011104H79	"納特思" 凱米諾 顱內壓監測導管-具 其他附加功能(引 流)	111/3/17	組	22,565	22,565			900				3	71		
59	顱內壓監測裝置	111/7/1	CPV011CP82CM	"柯特曼"顱內壓監 測系統-腦式 室監測導管組	111/3/17	組	22,565	22,565							1	24		
60	顱內壓監測裝置	111/7/1	CPV01SPB02AE	雅氏-史密伯格 顱內壓監測器-測量探 針套組	111/3/17	組	22,565	22,565							9	213		
61	顱內壓監測裝置	111/7/1	CPV019295692	"諾美德科" 顱內 監測器-導管 (NEUROVENT/顱內壓 +引流drainage)	111/3/17	組	22,565	22,565							2	47		
62	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA0318397DP	"帝富"康富脊椎骨 水泥(7c. c.)	111/3/17	組	68,000	68,000	無		2,338		199,604					17,704
63	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA0318391DP	"帝富"康富脊椎骨 水泥(11c. c.)	111/3/17	組	68,000	68,000							1	68		
64	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA0328391DP	"帝富"康富脊椎骨 水泥系統	111/3/17	組	68,000	68,000							116	7,891		
65	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA03T321K63	"特科漢"海維佳脊 椎骨水泥系統	111/3/17	組	68,000	68,000							55	3,740		
66	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA0304066S9	"史賽克" 高黏度 脊椎骨水泥特材- 20g	111/3/17	組	68,000	68,000							2	136		
67	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA033426870	"脊而益" 穩固椎體 成形術高黏度骨水 泥	111/3/17	組	68,000	68,000							1	68		
68	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA03CX01AM4	"美敦力" 愛派克 骨水泥	111/3/17	組	68,000	68,000										
69	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA033319380	"泰格瑞斯"曼帝克 高密度骨水泥系統	111/3/17	組	68,000	68,000							12	816		
70	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA03TM45263	"特科漢" 椎體成 形術骨水泥	111/3/17	組	20,000	20,000			2,031				28	588		
71	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA0304062S9	"史賽克" 顯影脊 椎骨水泥	111/3/17	組	20,000	20,000										
72	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA033427171	"脊而立" 菲斯特椎 體成形術骨水泥	111/3/17	組	20,000	20,000							2	42		
73	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA03SPN0173	"泰克美" 脊固骨 水泥	111/3/17	組	20,000	20,000							75	1,572		

報告案第3案 111年起收載新功能特材申報情形報告案

【附件】

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共擬會議日 期	單位	新功能特材 納入時支付點 數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估				新功能特材 生效日起 111年(截至7月)申報數 -醫院總額		新功能特材 生效日起 111年(截至7月)申報數 -西醫基層		新功能特材 生效日起 111年(截至7月)實際申報點數 -醫院總額		新功能特材 生效日起 111年(截至7月)實際申報點數 -西醫基層	
									被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=BP*C或成長率或 (2)E=共擬會議討論之推估 量	被替代品項 支付點數 Re	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 G	申報點數 H (千點)	申報使用量 I	申報點數 J (千點)	1.申報年度無調整支付點數: F=(A-Re)*G(千點) 2.申報年度有調整支付點數: (當時支付點數-Re)*申報量(千點)	1.申報年度無調整支付點數: F=(A-Re)*I(千點) 2.申報年度有調整支付點數: (當時支付點數-Re)*申報量(千點)
74	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA033001464	"賀利氏"歐斯特保 普樂斯脊椎骨水泥	111/3/17	組	20,000	20,000												
75	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA032059164	"賀利氏"歐斯特 保脊椎專用骨水泥	111/3/17	組	20,000	20,000					45	941						
76	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA03012304T	"泰瑞斯"蒙締客脊 椎用成形骨泥	111/3/17	組	20,000	20,000					15	315						
77	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA0313C204T	"泰瑞斯"蒙締客 脊椎用成形骨泥組	111/3/17	組	20,000	20,000												
78	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA03BA0015Y	擎力美椎體骨水泥 (滅菌)	111/3/17	組	20,000	20,000					14	294						
79	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA03BA00167	琳榭椎體骨水泥	111/3/17	組	20,000	20,000												
80	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA031031074	"艾普"邦思斯脊椎 專用骨水泥	111/3/17	組	20,000	20,000					5	105						
81	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA03213BC83	"泰科妮美"歐嘉 菲斯骨水泥	111/3/17	組	20,000	20,000					1	21						
82	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA034129S19	"葛柔波絲"佛崔 斯帕恩骨水泥-脊椎 用	111/3/17	組	20,000	20,000												
83	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA03GUTW172	"強翼"脊固骨水 泥	111/3/17	組	20,000	20,000					16	330						
84	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA03BAR2075	"佰門"巴克萊骨 水泥-脊椎用20g	111/3/17	組	20,000	20,000					1	21						
85	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA03BAR3075	"佰門"巴克萊骨 水泥-脊椎用30g	111/3/17	組	20,000	20,000												
86	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA03CMV01WG	"台微醫"椎體成形 術骨水泥	111/3/17	組	20,000	20,000					21	441						
87	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA03333667E	"奧斯特"注射式脊 椎骨水泥	111/3/17	組	20,000	20,000					15	315						
88	冠狀動脈前置導管	111/8/1	CGPG1T0R02AS	"朝日"通納斯支 撐導管	111/5/19	條	11,536	11,536	無		200		2,307							
89	冠狀動脈前置導管	111/8/1	CGPG1T0R01AS	"朝日"微導管- Tornus	111/5/19	條	11,536	11,536												
90	無導線心律調節器	111/8/1	FHP03MC1AVM4	"美敦力"脈克拉無 導線房室傳導節律 系統及"美敦力"脈 克拉親水性塗層血 管導引鞘	111/5/19	組	393,845	393,845	單腔無導線心律調 節器(含導引鞘)		120	336,620	22,816							
91	跗瑪式骨髓內固定 釘組 GAMA LOCKING NAIL SYSTEM	111/9/1	FBNG1P2170S1	"信迪思"長股骨髓 內釘系統/上端長股 骨髓內釘組(長度 170mm)	111/5/19	組	45,000	45,000	TITANIUM Gamma 3 Locking Nail System(NAILX1+SC REW3)、DHS Compression Hip Screw System(PLATE+LAG SCREW+COM. SCREW)		2,177、 1,907	1,960	19,036、 6,796	54,072						
92	跗瑪式骨髓內固定 釘組 GAMA LOCKING NAIL SYSTEM	111/9/1	FBNG1052729R	愛派司亞洲解剖型 髓內釘系統組/亞洲 解剖型前傾體部髓 內釘_XS(長度 170mm)	111/5/19	組	45,000	45,000												

報告案第3案 111年起收載新功能特材申報情形報告案

【附件】

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共擬會議日 期	單位	新功能特材 納入時支付點 數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估			新功能特材 生效日起 111年(截至7月)申報數 -醫院總額		新功能特材 生效日起 111年(截至7月)申報數 -西醫基層		新功能特材 生效日起 111年(截至7月)實際申報點數 -醫院總額		新功能特材 生效日起 111年(截至7月)實際申報點數 -西醫基層		
									被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=B*C*成長率 或 (2)E=共擬會議討論之推估 量	被替代品項 支付點數 Re	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 G	申報點數 H (千點)	申報使用量 I	申報點數 J (千點)	1.申報年度無調整支付點數： F=(A-Re)*G(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點)	1.申報年度無調整支付點數： F=(A-Re)*I(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點)
93	腦血管夾 ANEURYSM CLIP	111/9/1	SCV0208051AE	"雅氏" 鈦合金腦血 管瘤夾	111/7/21	支	11,500	11,500	腦血管夾ANEURYSM CLIP(鉗絡合金), 未分類型	1,064		1,550	2,908	13,318						
94	腦血管夾 ANEURYSM CLIP	111/9/1	SCV0217001M1	"瑞德"腦動脈瘤夾 (鈦合金)	111/7/21	支	11,500	11,500												
95	鈦金屬釘匣(GIA 自動手術縫合器 用)	111/10/1	SAU0760AXT2C	"柯惠"內視鏡自動 手術縫合槍及縫合 釘-tri-staple/黑 釘(60mm且釘閉合高 度>=3mm)	111/7/21	匣	6,774	6,774	鈦金屬釘匣/旋轉 式鈦金屬釘匣(手 術切割縫合用)≥ 60mm(4排釘/6排 釘)	6%	80,092	4,810	5,891	4,247						
96	鈦金屬釘匣(GIA 自動手術縫合器 用)	111/10/1	SAU0745AXT2C	"柯惠"內視鏡自動 手術縫合槍及縫合 釘-tri-staple/黑 釘(45mm且釘閉合高 度>=3mm)	111/7/21	匣	5,569	5,569	鈦金屬釘匣/旋轉 式鈦金屬釘匣(手 術切割縫合 用)45mm~59mm(4 排釘/6排釘)											
97	修訂「胸主動脈支 架系統」給付規定 (A220-6)	111/7/1			111/5/19							70		27,615	120	50,723		12,229		
【說明】 111/5/19共擬會議同 意本案修訂給付規定 以新功能特材預算支 應，以平均1件之 申報點數約394,493 點，計算財務支出 27,614,510點 【394,493*70】。											【說明】 與前一年同期相比，增加點 數12,228,724點。									
總計											565,001		131,682		92,984					

註1：資料來源：三代倉儲；特材主檔、門診、交付、住院明細及醫令檔(111.8.29擷取)
 註2：申報資料範圍：總額內案件，不含本署代辦項目(如預防保健、勞保局職災案件)。
 註3：被替代品項核價類別：被新特材取(替)代之健保類似品項核價類別。
 註4：年替代率：如專家或文獻指出有明確替代情形，依該品項實際替代比例或其他方式計算。
 註5：預估新功能特材年使用量：暫以該品項提案推估納入健保給付後，按成長率計算第3年使用量。
 註6：本表新特材品項合後續納入給付之比照品項與既有品項，其共擬會議日期以「新增既有品項」註記。

報告案 4

108 年至 110 年連續 3 年特約院所無申報量特材品項之健保給付案。

108年至110年連續3年特約院所無申報 量特材品項之健保給付案

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第60次(111年9月)會議
111年9月15日

法源依據

- 全民健康保險藥物給付項目及支付標準第50條規定：

本標準已收載之特殊材料品項，如連續三年（含）無醫令申報量，且有替代性品項可供病人使用者，該品項不予列入本標準。但如有特殊情形，藥物許可證之持有廠商或保險醫事服務機構得向保險人提出說明，經提藥物擬訂會議審議同意後，得保留二年，並以一次為限。

本案說明

- 108年至110年連續3年特約院所無申報量之特材品項計**658項**，本署於111年5月25日函請**112家**特材廠商，前述品項之藥物許可證持有廠商及特約院所，若有特殊情形或無替代品項者，向本署提出說明，若無特殊情形者，本署將依行政程序辦理。
- 依廠商及特約院所回復意見，及排除查核期間支付點數歸0及許可證逾期，經確認保留及刪除品項共計**601項**。

3

(一) 601品項廠商及特約院所回復結果

回復單位	保留品項		刪除品項	
	回復意見	品項數	回復意見	品項數
廠商 (112家)	①用於兒童、重症病人、屬特殊規格、具廠牌專一性或屬整組之組件。	33	①刪除品項	208
	②與醫院簽訂採購合約，尚在履約期限。	44	②未回復意見(52家)	111
	③已有醫院採購，並檢附證明資料。	9		
	④其他原因：仍有市場需求、少數病人使用、將參與醫院標案、持續推廣中等。	196		
	小計	保留品項(A)	282	刪除品項(B)
總計(A+B)			601	

回復單位	保留品項		刪除品項	
	回復意見	品項數	回復意見	品項數
特約 院所	①與醫院簽訂採購合約，尚在履約期限。	1	①刪除品項	16
	②已有醫院採購，並檢附證明資料。	1	②未回復意見	583
	小計	保留品項(C)	2	刪除品項(D)
總計(C+D)			601	

(二) 601品項經健保署確認並建議後續辦理情形

序號	建議保留品項		序號	建議刪除品項		說明
	說明	品項數		說明	品項數	
①	廠商或特約院所建議保留品項	208	①	廠商或特約院所建議刪除品項	206	建議刪除
②	111年有申報量	23	②	廠商及特約院所皆未回復意見	106	視同無意見，建議刪除
			③	廠商建議保留，惟109年已保留1次，截至111年仍無申報量，且有替代品項。	58	依藥物支付標準第50條規定辦理，建議刪除
小計	保留品項(E)	231	刪除品項(F)		370	
總計(E+F)		601				

5

擬辦：

- 本案如經同意確認，依上開說明，108年至110年連續3年特約院所無申報量之特材品項共計**601項**：
 - 保留品項計**231項**。
 - 刪除品項計**370項**(如附件)，並依程序辦理暫予公告實施。

108至110年連續3年特約院所無申報量之特材-刪除品項370項

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
1	ACM012HFRXMR	"美瑞特" 多路水接頭: 2-PORTS 及高壓連接管	"MERIT" MANIFOLD:2-PORTS WITH HIGH PRESSURE TUBING	202HF-RX;502HF-RX	EA	衛署醫器輸字第010140號	美瑞特	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
2	ACM01MFD425S	"昕力" 一次性使用連通器:4路	"SunMed" Manifold And Stopcocks:4 PORT	SM-MF-41;SM-MF-42	個	衛部醫器陸輸字第000819號	凱薩琳	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
3	ACS01NCN3SNR	"尼普洛" 三方活塞	"NIPRO" DISPOSABLE 3-WAY STOPCOCK	#NCN3	EA	衛署醫器輸字第011161號	華江	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
4	ACS01STP34H9	"華億"體外循環管組:三、四路活塞接頭	"HYM" HEART LUNG PACK:3 & 4 WAY STOPCOCKS	46-000160-00:02;46-000159-00;46-000157-00:01;46-000158-00	EA	衛署醫器製字第001297號	華億	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
5	ACY01NYC00GJ	"吉生"Y型連接器組:氣球導管或導引管用接頭(單Y型)	"JSM"Y CONNECTOR KIT	09-110001-01	EA	衛署醫器製字第003751號	吉生	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
6	ACY01NYC11GJ	"吉生"Y型連接器組(含導引支撐器+扭力控制器)	"JSM"Y CONNECTOR KIT(WITH INSERTION TOOL+TORQUE DEVICE)	09-110111-01	EA	衛署醫器製字第003751號	吉生	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
7	BBP0400315DD	"沙克"開口型便袋(未滅菌):單片式便袋(含人工皮+不織布)	"DANSAC" SOLO DRAINABLE POUCHES (NON-STERILE):ONE PIECE SOLO MINI DRAINABLE POUCH	315-15;316-15	EA	衛署醫器輸壹字第002290號	佳醫	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
8	CBB0141550CD	"考迪斯"保飛力斯穿皮式經管腔造形導管	"CORDIS" POWERFLEX PERCUTANEOUS TRANSLUMINAL ANGIOPLASTY(PTA) CATHETER	415-5020:5060;415-6020:6060;(415-5020:5060-T;V;S;M;X;Y;415-6020:6060-T;V;S;M;X;Y;自970401起生效)	EA	衛署醫器輸字第008511號	埃默高	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
9	CBB01DR035BA	"巴德"杜拉德經皮穿刺血管成形術氣球擴張導管	"Bard" Dorado PTA Balloon Dilatation Catheter	DR-40-32;42;44;DR-40-5:9-2;4;8;DR-80;120;135-3;4-2;4;10;DR-80;135-5:8-2;3;4;6;8;10;DR-80-9;10-2;3;4;8;DR-120-5:8-2;4;10;DR-120-9;10-2;4;DR-120-108;DR-135-9-2;3;4;DR-135-10-2;4;DR-80;135-5:8-1H	支	衛部醫器輸字第030601號	巴德	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
10	CBB01LYNX18R	"雅瑟斯"林可斯周邊血管氣球導管	"Arthesys"Lynx PTA Catheter	26101-001:008;027:034;053:060;066:073;079:086;196:203;209:216;092:099;105:112;118:125;131:138;222:229;144:151	支	衛部醫器輸字第030402號	華億	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
11	CBB01TER155U	"泰速-35"氣球擴張導管	"TERSUS"0.035"PTA Balloon Dilatation Catheter	TER-520:540;560:580;5100;5120;5150-S;L;TER-620:640;660:680;6100;6120;6150-S;L;TER-720:740;760:780;7100;7120;7150-S;L;TER-820:840;860:880;8100;8120;8150-S;L;TER-920:940;960-S;L;TER980S;TER-1020:1040;1060-S;L;TER1080S	條	衛部醫器輸字第029958號	捷銳	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
12	CBB0342610CD	"考迪斯"速立刻擴張導管	"CORDIS" SLEEK OTW PERCUTANEOUS TRANSLUMINAL ANGIOPLASTY (PTA) CATHETER L15:100MM	426-12;15-01X;426-20;25;30;35;40;50-02X;4261502-L;W;X;426-15;20;25;30;35;40;50-04;08;10-L;W;X	個	衛部醫器輸字第026374號	埃默高	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
13	CBB03BTK225R	"泰速-14"氣球擴張導管(D:2-4MM;L:150-220MM)	"Tersus-14"BTK PTA Balloon Dilatation Catheter	BTK-20;25;30;35;40-150;220-S;L	條	衛部醫器輸字第029954號	捷銳	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
14	CBB03BTK805R	"泰速-14"氣球擴張導管(D:2-4MM;L:20-100MM)	"Tersus-14"BTK PTA Balloon Dilatation Catheter	BTK-20;25;30;35;40-20;60;80;100-S;L	條	衛部醫器輸字第029954號	捷銳	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
15	CBB03DR035BA	"巴德"杜拉德經皮穿刺血管成形術氣球擴張導管(下肢血管)	"Bard"Dorado PTA Balloon Dilatation Catheter	DR-80;135-4:7-12;15;17;20	支	衛部醫器輸字第030601號	巴德	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
16	CBB03LYNX28R	"雅瑟斯"林可斯周邊血管氣球導管(下肢血管)	"Arthesys"Lynx PTA Catheter	26101-501:508;527:534;553:560;566:573;579:586;696:703;709:716;592:599;605:612	支	衛部醫器輸字第030402號	華億	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
17	CBB03LYNX38R	"雅瑟斯"林可斯周邊血管氣球導管(下肢血管)	"Arthesys"Lynx PTA Catheter	26101-618:625;631:638;722:729;644:651	支	衛部醫器輸字第030402號	華億	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
18	CBB03PR0205F	"艾拉維"派威018周邊血管氣球擴張導管(L:20:100MM)	"ArraVasc"Pirouette 018 PTA Catheter	80-20-021-30A;50A;80-40;50;60;70-040;060-45A;80-20;25-060;080;100-90A;80-30;35;40;50;60;70;80-040;060;080;100-90A;80-90-040;060;080-90A;80-20;25;30;35;40-061;081;101-30A;50A;80-30;35;40;50;60-041-30A;50A;80-50;60;70-081;101-30A;50A	支	衛部醫器輸字第030286號	奕達生技	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
19	CBB03PR1505F	"艾拉維"派威018周邊血管氣球擴張導管(L:150:300MM)	"ArraVasc"Pirouette 018 PTA Catheter	80-30;35-150;200-90A;80-40;50;60-150;200;250-90A;80-70-150-90A;80-20;25;30;35;40;50;60;70-15;20;25-130A;150A;80-20;25;30-30-130A;150A	支	衛部醫器輸字第030286號	奕達生技	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
20	CBC0210125AB	"亞培"全能自擴型血管支架系統(腸骨血管支架)	"ABBOTT" ABSOLUTE PRO VASCULAR SELF-EXPANDING STENT SYSTEM	10125-28:32;34:38-20:40;60:100	組	衛署醫器輸字第024518號	雅培	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
21	CBC04FCLP1G9	法西里-比比 自膨式支架(淺股動脈支架L:20-120MM)	Facile-PP Self Expanding Stent	60;70;80;90;100;110-PPS-20;40;60;80;100;120-80;120	組	衛部醫器輸字第030785號	連鑑	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
22	CBC04FCLP2G9	法西里-比比 自膨式支架(淺股動脈支架L:150MM)	Facile-PP Self Expanding Stent	60;70;80;90;100;110-PPS-150-80;120	組	衛部醫器輸字第030785號	連鑑	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
23	CBC05NBS04L1	"博而騰"瑞磊恩伯斯胸主動脈覆膜支架暨導載輸送系統(使用4支(含)以上)	"BOLTON" RELAY NBS THORACIC STENT-GRAFT WITH PLUS DELIVERY SYSTEM	依特材代碼:CBC05NBS01L1之型號	組	衛部醫器輸字第026220號	泰爾茂	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
24	CBC05RELAYL1	"博而騰"瑞磊胸主動脈覆膜支架暨導載輸送系統(使用1支)	"BOLTON" RELAY PLUS THORACIC STENT GRAFT WITH A TRANSPORT DELIVERY SYSTEM	28-M322090222290S.;28-M346250462690S;28-M328155242290S.;28-M346250422690S	組	衛署醫器輸字第022127號	泰爾茂	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
25	CBP01107TBRB	"奧爾"第二代塞費爾進階冠狀動脈球囊擴張術導管	"OrbusNeich" Sapphire II PRO Coronary Dilatation Catheter	210;212-053;083;103;153-5U;215;220;225;230-103;123;153-5U;217;222;227;232;235;240-103;153;203-5U;215;220;225;230-203-5U;225;230;235-303-5U	條	衛部醫器輸字第029129號	祥豐	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
26	CBP01AARPC7X	阿受斯皮可冠狀動脈支架系統(冠狀動脈支架)	Arthos Pico Stent Implantation System	20;22;25;27-ICS-8;12;16;19;24;28;34;38-P;30;32;35;40-ICL-10;14;18;24;28;34;38-P	組	衛部醫器輸字第030712號	連鑑	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
27	CBP0338081SB	"波士頓科技"冠狀動脈擴張導管	"BOSTON SCIENTIFIC" QUANTUM MAVERICK PTCA DILATATION CATHETER	H74938081-08200:30400	SET	衛署醫器輸字第020891號	波士頓	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
28	CBP06FB2EL3X	"上海微創"法爾貝德冠狀動脈塗藥支架系統	"Shanghai MicroPort" Firebird2 Rapamycin-Eluting Coronary CoCr Stent System	G-25;27;30;35;40-13;18;23;29;33	組	衛部醫器陸輸字第000912號	心健	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
29	CDD0451075P2	"太平洋"真空傷口引流套(滅菌)	"PAHSCO" WOUND DRAINAGE SYSTEM (STERILE)	08770;08771;08772;08760;08761;08762	SET	衛部醫器製壹字第005107號	太平洋	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
30	CDD0451076P2	"太平洋"真空傷口引流套(滅菌)	"PAHSCO" WOUND DRAINAGE SYSTEM (STERILE)	08705;08706;08707	SET	衛部醫器製壹字第005107號	太平洋	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
31	CDD0455192P2	"太平洋"密閉式真空傷口引流套(滅菌)	"PAHSCO" CLOSED WOUND DRAINAGE SYSTEM (STERILE)	S50101:105;S50120:124;S50301:305;S50325:329	組	衛部醫器製壹字第005192號	太平洋	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
32	CDD0551073P2	"太平洋"真空傷口引流套(滅菌)-矽質傷口引流管	PAHSCO" WOUND DRAINAGE SYSTEM (STERILE)	08711;	EA	衛部醫器製壹字第005107號	太平洋	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
33	CDD0651072P2	"太平洋"真空傷口引流套(滅菌)-矽質真空引流球	"PAHSCO" WOUND DRAINAGE SYSTEM (STERILE)	08701;08709	EA	衛部醫器製壹字第005107號	太平洋	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
34	CDD1100002U7	"普威"穿刺導引器:5-12MM(穿刺針×1+外管×2+內建可變式轉接頭×2)	"UNIMAX" SURGICAL TROCAR	FSK405100;FSK410100;FSK412100;FSK405070	EA	衛署醫器製字第002216號	普威	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
35	CDD1105123L7	拉吉士穿刺套管:5-12MM(防滑套管2支,穿刺針1支,多功能轉換器2組)	LAGIS TROCAR	TR-06C2;TR-06L2;TRO-11C2;TRO-11B2;TRO-12C2;TRO-12B2;(TR-06L2自1061101起刪除)	組	衛署醫器製字第001783號	常廣	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
36	CDD110612YL7	大吉士穿刺套管(穿刺內管X1+穿刺外管X1+可變式轉接頭X1)	LAGIS TROCAR	TRO-08V1	組	衛署醫器製字第002898號	常廣	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
37	CDD11FPK03ET	"愛惜康"外科套管針:穿刺針×1+外管×3+內建固定轉接頭×3	"ETHICON" FLEXIPATH SURGICAL TROCAR	FPK02;FPK03	SET	衛署醫器輸字第011421號	壯生	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
38	CDD11GT501QW	"台灣先進"拋棄式穿刺套管5MM(穿刺針1+外管1+內建固定式轉接頭1)	"TAIWAN SURGICAL" DISPOSABLE TROCAR	TDT-05070;05100	組	衛部醫器製字第004489號	台灣先進	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
39	CDLP16421TB0	"長安"腦脊髓分引流系統	"BMI" CSF SHUNTING SYSTEM	06421T;06422T	組	衛署醫器製字第001388號	長安	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
40	CDP01PV630LY	"奧林柏斯"單次用膽道引流支架(膽道支架套組:含推送管*1+膽道支架*1)	"OLYMPUS" SINGLE USE BILIARY DRAINAGE STENT V	(PBD-V630P-0705;0707;0709;0712;0715);(PBD-V630P-0805;0807;0809;0812;0815);(PBD-V630P-1005;1007;1009;1012;1015);(PBD-V630P-1205;1207;1209;1212;1215);(PBD-V631P-0705;0707;0709;0712;0715);(PBD-V631P-0805;0807;0809;0812;0815);(PBD-V631P-1005;1007;1009;1012;1015);(PBD-V631P-1205;1207;1209;1212;1215);(PBD-V632P-0705;0707;0709;0712;0715);(PBD-V632P-0805;0807;0809;0812;0815);(PBD-V632P-1005;1007;1009;1012;1015);(PBD-V632P-1205;1207;1209;1212;1215)	組	衛部醫器輸字第027971號	元利	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
41	CDP02PEBSTFG	"福萊克斯"膽道引流管	"ENDO-FLEX" BILIARY STENT	PE20007003;PE20410015	EA	衛部醫器輸字第027489號	香港商利和	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
42	CDVP19003AM4	"美敦力"腦脊髓液引流套件組及附件:腦室腹腔分流術導管組	"MEDTRONIC" CSF FLOW CONTROL SHUNTS AND ACCESSORIES:V-P SHUNT KIT	9003-A;B;C	EA	衛署醫器輸字第009959號	美敦力	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
43	CDVPB28803CM	"美的思"柯特曼史特爾引流閥-附配件及抗菌導管	"Medos" Codman Certas Plus Programmable Valve-ATTACHMENT AND BACTISEAL CATHETER	82-8803	組	衛部醫器輸字第025303號	科舉	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
44	CDVPB28804CM	"美的思"柯特曼史特爾引流閥-具抗虹吸裝置	"Medos" Codman Certas Plus Programmable Valve -SIPHONGUARD	82-8804	組	衛部醫器輸字第025303號	科舉	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
45	CEE010544A3N	"根本"高壓延長管-螺旋管300PSI	"NEMOTO" Pressure Tube	TM0544A	條	衛部醫器製字第004316號	太平洋	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
46	CEE010544H3N	"根本"高壓延長管	"NEMOTO" Pressure Tube	TM0544H0A	條	衛部醫器製字第004316號	太平洋	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
47	CEE0108100P2	"太平洋"延長管	"PAHSCO" EXTENSION SETS	I08100	EA	衛署醫器製字第000428號	太平洋	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
48	CEE0180015P2	"太平洋"延長管	"PAHSCO" EXTENSION SETS	I08001.15	EA	衛署醫器製字第000428號	太平洋	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
49	CEE01CH151U2	"愛西優"可來福藥物準備系統組件(玻璃瓶用)	"ICU" ChemoClave Drug Preparation System-IV Bag Access Spike Clave Check Valve	CH-15	個	衛部醫器輸字第028861號	艾希優	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
50	CEE01ET12CLL	"怡安"輸液延長管	"LILY" EXTENSION TUBE	CET-120C	EA	衛署醫器製字第000894號	怡安	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
51	CEP01PT500SG	"十美牌"耐壓延長管	"SIGMA" PRESSURE TUBE	SMET0611:SMET0617	EA	衛署醫器製字第000997號	聯和	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
52	CEP01PTPVCJ	"吉生"壓力連接管	"JSM" PRESSURE TUBING	04-000-005;010;015;025;030;050;060;075;090;100;120;150;180;210;240-01	EA	衛署醫器製字第003083號	吉生	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
53	CFD0679010FL	艾極管灌餵食管袋組合套:經皮內視鏡胃造瘻組	AG FREKA FEEDING TUBE SET :PEG KIT	7901051	SET	衛署醫器輸字第017729號	費森尤斯卡比	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
54	CGBK1BSM01CK	"曲克"並史密斯馬洪膽結石移除套組	"COOK" BEAN-SMITH MAHORN BILIARY STONE REMOVAL SET	BSM-100;200;300	組	衛署醫器輸字第020479號	曲克	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
55	CGDW108011ST	"聖猷達"海卓史蒂爾導引線(鍍合金)	"ST. JUDE" HYDROSTEER GUIDEWIRES	408011;12;24;25	EA	衛署醫器輸字第010298號	雅培	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
56	CGDW135284AG	"雅客"導引線	"ARGON" GUIDE WIRES	AG395284	EA	衛署醫器輸字第007023號	寶密	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
57	CGDW1APGW1H9	"華億"心導管包:導引導線	"HYM" ANGIO PACK:GUIDE WIRE	20-1002-01-01;02	EA	衛署醫器製字第001681號	華億	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
58	CGPG118085ZF	"史特勞斯"區克斯極緻/選擇支撐導管(角度型)	"SPECTRANETICS" QUICK-CROSS EXTREME/SELECT SUPPORT CATHETERS	518-077;079;081;083;085;087;089;091;093	EA	衛署醫器輸字第024974號	六霖	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
59	CGPW12234NAB	"亞培"高鐸格導管引線	"ABBOTT" HI-TORQUE GUIDE WIRE	22235M;22235MJ;22359M-901;22399M	EA	衛署醫器輸字第008338號	雅培	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
60	CGPW1223MNAB	"亞培"高鐸格導管引線	"ABBOTT" HI-TORQUE GUIDE WIRE	22317M;22317MJ;22317MJ-903;22318M;22318MJ;22339M;22339MJ;22349M;22349MJ	EA	衛署醫器輸字第008338號	雅培	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
61	CGPW128000AB	"亞培"高鐸格導管引線	"ABBOTT" HI-TORQUE GUIDE WIRE	28000-HC;28000J-HC	EA	衛署醫器輸字第008338號	雅培	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
62	CGPW19660NAB	"亞培"高鐸格導管引線	"ABBOTT" HI-TORQUE GUIDE WIRE	1009660;1009660J	EA	衛署醫器輸字第008338號	雅培	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
63	CGPW1AHWR3AS	"朝日"冠狀動脈導引線紫苑	"ASAHI" PTCA GUIDE WIRE ASAHI SION	AHW14R301S	EA	衛署醫器輸字第021758號	興東	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
64	CGPW1N6W19AB	"亞培"第六代血栓防護盾系統-過濾輸送金屬絲	"ABBOTT" EMBOSHIELD NAV6 EMBOLIC PROTECTION SYSTEM-BAREWIRE	22444-19;22445-19;22446-19	條	衛署醫器輸字第022102號	雅培	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
65	CGPW1WNGW9AB	亞培高鐸格威恩血管導線	"ABBOTT" HI-TORQUE WINN GUIDE WIRE	1012466;1012468;1012470;1012472;1012474	EA	衛署醫器輸字第023301號	雅培	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
66	CGS0130484BB	"柏朗" 舒載皮下植入式注射座	"B. BRAUN" CELSITE IMPLANTABLE PORTS: INTRODUCER KIT	0443-0484;0492;0700	SET	衛署醫器輸字第008312號	台灣柏朗	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
67	CGS0146151AG	"雅容" 導引器組	"ARGON" INTRODUCER KITS AND TRAY: INTRODUCER KIT	496151;496152;496153;496154	EA	衛署醫器輸字第007021號	實密	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
68	CGS016207DM4	"美敦力" 導線導引器	"MEDTRONIC" PERCUTANEOUS LEAD INTRODUCERS	6207D:6212D ; 6207D:6212D;(型號重整為62-07;08;09;10;11-D1自1090901生效)(62-07;08;09;10;11-BTK-D1自1090901生效)	組	衛署醫器輸字第010125號	美敦力	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
69	CGS01RCF01CK	"曲克" 闕克芙爾引導器組	"COOK" CHECK-FLO PERFORMER INTRODUCER SETS	RCF-5.0:8.0-35;38-25-J	SET	衛署醫器輸字第010363號	曲克	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
70	CGS01TR482AB	茵給桔導管導引器	ENGAGE ENGAGE TR INTRODUCER(RADIA INTRODUCER)	C408525;C408526;C408527;C408534;C408535;C408536	組	衛署醫器輸字第021864號	雅培	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
71	CGS01VASC PBK	"百多力" 維斯柯碧剝離式導引裝置組	"BIOTRONIK" VascoPeel Peel-away Introducer Set	VascoPeel 6F;VascoPeel 7F;VascoPeel 8F;VascoPeel 9F;VascoPeel 10F;VascoPeel 10.5F;VascoPeel 11F;VascoPeel 12F	組	衛署醫器輸字第030195號	百多力	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
72	CHC01CA410R5	"里凡諾瓦" 心臟麻痺轉接器(多功灌注轉接器)	"LivaNova" Cardioplegia Adapters(MULTIPLE PERFUSION ADAPTER)	CA-40010	條	衛署醫器輸字第010379號	中訊企業	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
73	CHF0696345M4	"美敦力" 套管: 套管及導管	"MEDTRONIC" BIO-MEDICUS CANNULA	CB96345-023:029	EA	衛署醫器輸字第010023號	美敦力	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
74	CHR01AR109L5	"加州" 動脈根部套管: 前注導管	"CALIFORNIA" AORTIC ROOT CANNULAE	10009:10016;23009;AR-10218	EA	衛署醫器輸字第010406號	興東	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
75	CHR01AR212R5	"里凡諾瓦" 動脈根部套管(有排氣管)	"LivaNova" Aortic Root Cannulae	AR-11112;11114;11116	支	衛署醫器輸字第010406號	中訊企業	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
76	CHT01CH207H9	"華億" 體外循環管組	"HYM" HEART LUNG PACK	32-000207-01	SET	衛署醫器製字第001297號	華億	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
77	CHT01HTA12H9	"華億"體外循環管組	"HYM" HEART LUNG PACK:HSIN TUNG A12 ADULT	32-000401-05	SET	衛署醫器製字第001297號	華億	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
78	CHT0546203H9	"華億"體外循環管組:氧分壓測定接頭	"HYM" HEART LUNG PACK:STATSAT CONNECTOR	46-000203-01;46-000203-02;46-000203-03	EA	衛署醫器製字第001297號	華億	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
79	CKD01US102CK	曲克由尼維莎結實型和柔軟型輸尿管內置支架組	"COOK" UNIVERSA FIRM AND SOFT URETERAL STENT SET	USI-624:628;724:728-R-T;USI-624:628;728-T(刪除USI-624:628;724:728-R-T自1070101生效)	組	衛署醫器輸字第021869號	曲克	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
80	CKDD1883CK2C	"柯惠"急性血液透析導管(C+N+G+D)	"Covidien" Acute Hemodialysis Catheters	8830415003;8832539006;8830415003;8832539006(刪除8832539006自1110301生效)	組	衛署醫器輸字第009562號	美敦力	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
81	CKN01SDNS1AN	"安吉美爾德"經皮腎造口引流管組	"Angiomed" Soft-Drain Nephrostomy Set	552200-6:9-0	組	衛部醫器輸字第030132號	巴德	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
82	CKN04SDNS1AN	"安吉美爾德"經皮腎造口引流管組	"Angiomed" Soft-Drain Nephrostomy Set	552240-6:9-0	條	衛部醫器輸字第030132號	巴德	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
83	CLPA2AC0016W	以和拋棄式輸液幫浦(100ml/24hrs)	E-WHA Disposable Infusion Pump	AC1001	組	衛署醫器輸字第022661號	費森尤斯卡比	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
84	CLPA2LC0016W	以和拋棄式輸液幫浦(250ml/24hrs)	E-WHA Disposable Infusion Pump	LC2001	組	衛署醫器輸字第022661號	費森尤斯卡比	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
85	CLPA2LC0026W	以和拋棄式輸液幫浦(250ml/48hrs)	E-WHA Disposable Infusion Pump	LC2002	組	衛署醫器輸字第022661號	費森尤斯卡比	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
86	CLPAT44338BB	"柏朗"紓賽植入型血管注射系統(P+C+N)	"B. Braun" Celsite Implantable vascular access systems(P+C+N)	ST3010TW;T305	組	衛部醫器輸字第025367號	台灣柏朗	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
87	CLS05087MYBB	柏朗史倍司輸液套-幫浦輸液套/卡棒式	Infusomat Space Line Infusion Pump Administration Sets-Pump set/Anti-free Flow	8700087SP	組	衛署醫器輸字第018757號	台灣柏朗	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
88	CLS07031013B	"康德萊"輸血器(帶針)	"KDL" Transfusion Set with Needle	SX01001;SX01010;SX01015;SX01024	個	衛部醫器陸輸字第000633號	廣翼	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
89	CLS09010123B	"康德萊"輸血器(帶針)	"KDL" Transfusion Set with Needle	SX01011;SX01014;SX01025;SX01028	個	衛部醫器陸輸字第000633號	廣翼	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
90	CMV03614XNCM	"賽瑞諾華斯"愛捷第導引線	"Cerenovus" Agility Steerable Guidewire	614-178;614-179	EA	衛署醫器輸字第009403號	壯生	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
91	CMW01SY1GHQK	"栓塞球"微粒子栓塞物(1ml)	"BIOSPHERE" EMBOSPHERE MICROSPHERES(1ml)	S210GH;S410GH; S610GH;S810GH; S1010GH	瓶	衛署醫器輸字第010177號	銀鐸	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
92	CPC01PTT11BB	舒欽抗感染單腔中心靜脈導管組	CERTOFIX CENTRAL VENOUS CATHETER(PROTECT 1 LUMEN)	4160266P;4160290P;4160320P;4160789P	SET	衛署醫器輸字第021570號	台灣柏朗	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
93	CRT02U0794GC	"綠十字"氣管切開套管-無球	"GREEN CROSS" TRACHEOSTOMY TUBE-WITHOUT/CUFF	YJ-64	個	衛署醫器陸輸字第000090號	益江	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
94	CXE0102943BA	"巴德"歐文診斷電極導管	"BARD" WOVEN DIAGNOSTIC ELECTRODE CATHETERS	002943	條	衛署醫器輸字第010053號	波士頓	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
95	CXE0140053SB	"波士頓科技"維肯電極導管-10極(彎度固定)	"Boston Scientific" Viking Diagnostic Electrode Catheters-Deca	M0044005-30:36-0	條	衛署醫器輸字第010044號	波士頓	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
96	CXE02CSBDOWE	"百歐森偉伯斯特"偉伯司特自動辨識雙向可彎式冠狀靜脈竇電生理導管-10極	"Biosense Webster" Webster CS Catheter with EZ Steer Technology and Auto ID Technology	BD710-DF;FJ-282CT	條	衛署醫器輸字第023773號	壯生	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
97	CXE04CR7TCWE	"百歐森偉伯斯特"磁場遙控尖端可調彎式診斷/電燒電生理導管-攝氏	"BIOSENSE WEBSTER" RMT DIAGNOSTIC/ABLATION DEFLECTABLE TIP CATHETER-CELSIUS RMT	CR7TCS4RT	條	衛署醫器輸字第017096號	壯生	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
98	FALSMUF6005K	"威朗"博科視單片式球面人工水晶體	"Valeant Med" FOCUSforce ULTRAflex Spheric Intraocular Lens	UF60125;UF60130	片	衛部醫器輸字第029976號	博士倫	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
99	FALSNMULT15K	“威朗”博科視多焦點人工水晶體	“Valeant Med” FOCUSFORCE RE-VISION Multifocal Intraocular Lens	A100	片	衛部醫器輸字第030268號	博士倫	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
100	FALSNWAVE85K	“威朗”博科視非球面人工水晶體	“Valeant Med” FOCUSforce Aspheric Intraocular Lens	AS60125;AS60130	片	衛部醫器輸字第030009號	博士倫	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
101	FBA0403G05BC	"瑪蘭尼"博萌得多孔雙相人工替代骨: 2-3MM 5CC	"BIOMATLANTE" MBCP BONE SUBSTITUTE	0503G05	BOX	衛署醫器輸字第010949號	歐強	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
102	FBA040C02BWG	"台微醫"康骨益人工骨替代物:塊材2.0CM3	"WILTROM" OSTEOCERA BONE GRAFT SUBSTITUTE:2.0CM3	OC-B01;OC-B02	BOX	衛署醫器製字第003271號	台灣微創	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
103	FBA040C02GWG	"台微醫"康骨益人工骨替代物(2.0CM3)	"Wiltrom" Osteocera Bone Graft Substitute(2.0CM3)	OC-G21;OC-G22;OC-G23	盒	衛署醫器製字第003271號	台灣微創	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
104	FBA040C05BWG	"台微醫"康骨益人工骨替代物:塊材5.0CM3	"WILTROM" OSTEOCERA BONE GRAFT SUBSTITUTE:5.0CM3	OC-B03;OC-B06	BOX	衛署醫器製字第003271號	台灣微創	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
105	FBA040C10BWG	"台微醫"康骨益人工骨替代物:塊材10.0CM3	"WILTROM" OSTEOCERA BONE GRAFT SUBSTITUTE:10.0CM3	OC-B05;OC-B08	BOX	衛署醫器製字第003271號	台灣微創	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
106	FBA0410045S1	"信迪思"人工替代骨植入物:12.5X12.5X10MM	"SYNTHE" CHRONOS IMPLANTS	710.045S	EA	衛署醫器輸字第010576號	壯生	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
107	FBA0410047S1	"信迪思"人工替代骨植入物:20X20X10MM	"SYNTHE" CHRONOS IMPLANTS	710.047S	EA	衛署醫器輸字第010576號	壯生	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
108	FBA0410103FV	"維網"博納骨人工骨替代物	BONAGRAFT SYNTHETIC BONE SUBSTITUTE	F07-010103;010203;010303;010403;010503	VIAL	衛署醫器製字第002393號	維網	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
109	FBA0410104FV	博納骨人工骨替代物(1g)	BONAGRAFT SYNTHETIC BONE SUBSTITUTE	F07-010101; F07-010201; F07-010301; F07-010401; F07-010501	瓶	衛署醫器製字第002393號	維網	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
110	FBA0410105FV	博納骨人工骨替代物(2.5g)	BONAGRAFT SYNTHETIC BONE SUBSTITUTE	F07-010102; F07-010202; F07-010302; F07-010402; F07-010502	瓶	衛署醫器製字第002393號	維網	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
111	FBA044020RW2	"瑞德" 骨骼替代品:2CC	"WRIGHT" OSTOSET PELLETS:2CC	8400-0106	BOX	衛署醫器輸字第008723號	傑奎	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
112	FBA04AG01RF8	"台塑生醫"人工代用骨(再吸收骨填充物)	"FORMOSA" BONE GRAFT-CALTRIX(RESORBABLE BONE VOID FILLER)	FBMAGR-01	EA	衛署醫器製字第002768號	台塑生醫	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
113	FBA04AG03RF8	"台塑生醫"人工代用骨(再吸收骨填充物)	"FORMOSA" BONE GRAFT-CALTRIX(RESORBABLE BONE VOID FILLER)	FBMAGR-03	EA	衛署醫器製字第002768號	台塑生醫	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
114	FBA04AG10RF8	"台塑生醫"人工代用骨(再吸收骨填充物)	"FORMOSA" BONE GRAFT-CALTRIX(RESORBABLE BONE VOID FILLER)	FBMAGR-10	EA	衛署醫器製字第002768號	台塑生醫	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
115	FBA04AX0A1HY	艾沛瓷骨移植替代物:塊狀	APACERAM BONE GRAFT SUBSTITUTE-TYPE AX BLOCK	TYPE AX BLOCK A-1	EA	衛署醫器輸字第024045號	博而美	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
116	FBA04AX0A2HY	艾沛瓷骨移植替代物:塊狀	APACERAM BONE GRAFT SUBSTITUTE-TYPE AX BLOCK	TYPE AX BLOCK A-2	EA	衛署醫器輸字第024045號	博而美	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
117	FBA04AX0A3HY	艾沛瓷骨移植替代物:塊狀	APACERAM BONE GRAFT SUBSTITUTE-TYPE AX BLOCK	TYPE AX BLOCK A-3	EA	衛署醫器輸字第024045號	博而美	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
118	FBA04B01141U	"尼諾斯"人工替代骨(滅菌):塑膠陶磁類1ML	NUROS BONE GRAFT SUBSTITUTE(STERILE)	NBP10;BGA10;BGB10;BGC10;BGD10	EA	衛署醫器製字第003611號	亞東創新	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
119	FBA04B07143V	骨立活人工替代骨(滅菌)1CC	VitOs M Bone Graft Substitute (Sterile)1CC	NBP10;BGA10;BGB10;BGC10;BGD10 ; (NBP10;BGA10;BGB10;BGC10;BGD10);(VBP10;VGA10;VGB10;VGC10;VGD10自1110101生效)	盒	衛部醫器製字第004835號	賀斯幅	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
120	FBA04CA01RF8	"台塑生醫"人工代用骨(再吸收骨填充物)	"FORMOSA" BONE GRAFT-CALTRIX(RESORBABLE BONE VOID FILLER)	FBMCAL-01	EA	衛署醫器製字第002768號	台塑生醫	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
121	FBA04CP0156N	肯柏世人工骨填充物-1.5c.c.	CAPOSS Bone Graft Substitute	T015A:F;B015A:F	盒	衛部醫器製字第005272號	旭諾	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
122	FBA04CP0756N	肯柏世人工骨填充物-7.5c.c.	CAPOSS Bone Graft Substitute	T075A:F;B075A:F	盒	衛部醫器製字第005272號	旭諾	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
123	FBA04CP2006N	肯柏世人工骨填充物-20c.c.	CAPOSS Bone Graft Substitute	T200A:F;B200A:F	盒	衛部醫器製字第005272號	旭諾	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
124	FBA04CP3006N	肯柏世人工骨填充物-30c.c.	CAPOSS Bone Graft Substitute	T300A:F;B300A:F	盒	衛部醫器製字第005272號	旭諾	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
125	FBA04CS102Z6	"美瑞世"人工骨:2CC	"MERRIES" UNI-OSTEO:2CC	CS01020	EA	衛署醫器製字第001467號	傑奎	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
126	FBA04CS110Z6	"美瑞世"人工骨:10CC	"MERRIES" UNI-OSTEO:10CC	CS01100	EA	衛署醫器製字第001467號	傑奎	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
127	FBA04FM01GLB	富瑞密骨酪填補顆粒1CC	FORAMIC BONE GRAFT SUBSTITUTE	FM-G-0025;FM-G-0050;FM-G-0100	BOX	衛署醫器製字第001198號	和康	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
128	FBA04FM02CLB	富瑞密骨酪填補顆粒2CC	FORAMIC BONE GRAFT SUBSTITUTE	FM02;(FM-G-0200自1020501生效)	EA	衛署醫器製字第001198號	和康	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
129	FBA04FM10CLB	富瑞密骨酪填補顆粒10CC	FORAMIC BONE GRAFT SUBSTITUTE	FM-10	VIAL	衛署醫器製字第001198號	和康	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
130	FBA04HT021PQ	"瑞安" 生骨替代物二代	"PURZER" SINBONEHT BONE REPLACEMENT	HT021	EA	衛署醫器製字第001952號	瑞安	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
131	FBA04MA001HY	艾沛瓷骨移植替代物:顆粒	APACERAM BONE GRAFT SUBSTITUTE, TYPE AX GRANULE	TYPE AX GRANULE MA-1:4	EA	衛署醫器輸字第024045號	博而美	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
132	FBA04MA002HY	艾沛瓷骨移植替代物:顆粒	APACERAM BONE GRAFT SUBSTITUTE, TYPE AX GRANULE	TYPE AX GRANULE MA-1:4	EA	衛署醫器輸字第024045號	博而美	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
133	FBA04MA010HY	艾沛瓷骨移植替代物:顆粒	APACERAM BONE GRAFT SUBSTITUTE, TYPE AX GRANULE	TYPE AX GRANULE MA-1:4	EA	衛署醫器輸字第024045號	博而美	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
134	FBA04TP0014R	瑞奇人工骨(0.5CC-1CC)	RICH Bone Substitute(0.5CC-1CC)	TPB10;TP02051-2;TP05101-2;TP02051;TP05101;TP10201;TP30001	包	衛部醫器製字第004865號	禾祺銳	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
135	FBA04TP0024R	瑞奇人工骨(2CC-2.5CC)	RICH Bone Substitute(2CC-2.5CC)	TPB25;TP02052;TP05102;TP10202;TP30002	包	衛部醫器製字第004865號	禾祺銳	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
136	FBEF100002RK	瑞寶億骨外固定系統:單邊延長組	REBORN ESSENCE EXTERNAL FIXATION SYSTEM:UNI-LENGTHENING SET	70-14;15-0120;7055-0815;0820;7064-0820;7063-2025;按組件組合	EA	衛署醫器製字第003253號	寶億生技	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
137	FBEF100003RK	瑞寶億骨外固定系統:骨盆架框組	REBORN ESSENCE EXTERNAL FIXATION SYSTEM:PELVIC FRAME SET	70-14;15-0120;7055-0815;0820;7064-0820;7063-2025;7033-2020;按組件組合	EA	衛署醫器製字第003253號	寶億生技	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
138	FBEF2D0005RK	瑞寶億骨外固定系統:脛骨移位組	REBORN ESSENCE EXTERNAL FIXATION SYSTEM:TIBIAL BONE TRANSPORT SET	7091-0714:0720;7054-0708:0725;7411-1120;7431-0101;(7092-0714:0720自1010701生效);按組件組合	SET	衛署醫器製字第003253號	寶億生技	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
139	FBEF50019ND1	壯衛士骨外固定器:調整桿	TRAUMA-FIX EXTERNAL FIXATION SYSTEM:ADJUSTABLE TELESCOPICCONNECTING ROD	D19250;19300;S19200	EA	衛署醫器製字第001864號	寶楠	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
140	FBEH111491BM	"邦美"發現肘關節系統-肱骨組件	"Biomet" Discovery Elbow System-Humeral Component	1149-04:09;1149-14:19	個	衛部醫器輸字第030027號	捷邁	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
141	FBEU111482BM	"邦美"發現肘關節系統-尺骨組件	"Biomet" Discovery Elbow System-Ulnar Component	1148-12;13;16;17;22;23;26;27;32;33;36;37	個	衛部醫器輸字第030027號	捷邁	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
142	FBHAA4894NZ1	"西美-杜密特"骨金屬髖關節墊片(鈦金屬)	"Zimmer-TMT" Trabecular Metal Acetabular Augment	(00-4894-050;054;058;062;066;070-10;15);(00-4894-050;054;058;062;066-20;30)	個	衛署醫器輸字第018406號	捷邁	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
143	FBHBA7000NS2	"好美得卡奧斯得寧"愛克雷得髖關節系統-雙極式	"HOWMEDICA OSTEONICS" ACCOLADE FEMORAL HIP SYSTEM-BIPOLAR	由以下特材代碼組合:FBHS160ACNS2;FBHH16260NS2;FBHB1UH10NS2	組	衛署醫器輸字第024813號+021427號+019147號	史賽克	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
144	FBHBCERA3BM	"邦美"艾可陶瓷半人工髖關節系統-Biolox Delta	"Biomet" Echo Ceramic Bipolar System-Biolox Delta	由以下特材組合:FBHC15000NZ1;FBHC19090NBM;FBHS17862NZ1;FBHS17711NZ1;FBHS12900NZ1;FBHS16010NZ1;FBHS17850NZ1;FBHS17857NZ1;FBHCCERA2Z1;FBHS11924NBM;FBHCCERA1BM	組	衛署醫器輸字第009975+008736+011510+014133+022415號+衛部醫器輸029090+026806+030202+030380號	捷邁	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
145	FBHBCERA6S2	"好美得卡奧斯得寧"愛克雷得髖關節系統-陶瓷雙極式	"HOWMEDICA OSTEONICS" ACCOLADE FEMORAL HIP SYSTEM-CERAMIC BIPOLAR	由以下特材代碼組合:FBHS160ACNS2;FBHCCERA1S2;FBHB1UH10NS2	組	衛署醫器輸字第024813號+010293號+021427號	史賽克	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
146	FBHBCERR5BM	"邦美"艾可陶瓷半人工髖關節系統-Biolox Option	"Biomet" Echo Ceramic Bipolar System-Biolox Option	由以下特材組合:FBHC15000NZ1;FBHC19090NBM;FBHS17862NZ1;FBHS17711NZ1;FBHS12900NZ1;FBHS16010NZ1;FBHS17850NZ1;FBHS17857NZ1;FBHCCERR3Z1;FBHS11924NBM;FBHCCERA2BM	組	衛署醫器輸字第009975+008736+011510+014133+022415號+衛部醫器輸029090+026806+030202+030380號	捷邁	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
147	FBHC1P1CUPDP	"帝富"必耐久人工髖臼系統:髖臼杯	"DEPUY" PINNACLE HIP SYSTEM:CUP	1217-010;110;220;120;320;-48:66;1217-310-44:66;1217-200;300-38:72;1217-060;160-54:80;1217-070;170-54:72	EA	衛署醫器輸字第022363號	壯生	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
148	FBHPA1000NDP	"帝富"全人工髖關節系統	"DEPUY" AML TOTAL HIP SYSTEM	按組件型號組合	SET	衛署醫器輸字第009211號	壯生	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
149	FBHPA6000NS2	"好美得卡奧斯得寧"愛克雷得髖關節系統	"HOWMEDICA OSTEONICS" ACCOLADE FEMORAL HIP SYSTEM	由以下特材代碼組合:FBHS160ACNS2;FBHL16200NS2;FBHL16201NS2;FBHL11236NS2;FBHH16260NS2;FBHC154NXNS2	組	衛署醫器輸字第024813號+010293號+019314號+011235號+022771號+024932號+019147號	史賽克	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
150	FBHPA9000TBM	"邦美"今適穩人工髖關節系統	"Biomet"G7 Total Hip System	由以下特材代碼組合:FBHC10214NBM;FBHL19866NBM;FBHH19915NBM;FBHC18753NZ1;FBHH18018NZ1;FBHS17862NZ1;FBHS17711NZ1;FBHS12900NZ1;FBHS17850NZ1;FBHL18751NZ1;FBHC16200NZ1;FBHL16305NZ1;FBHS16010NZ1;FBHC18755NZ1;FBHS17857NZ1;(FBHS1924NBM自1070701生效);(FBHS16010NZ1;FBHC18755NZ1自1090501刪除);由以下特材代碼組合:FBHC10214NBM;FBHL19866NBM;FBHH19915NBM;FBHC18753NZ1;FBHH18018NZ1;FBHS17862NZ1;FBHS17711NZ1;FBHS12900NZ1;FBHS17850NZ1;FBHL18751NZ1;FBHC16200NZ1;FBHL16305NZ1;FBHS16010NZ1;FBHC18755NZ1;FBHS17857NZ1;(FBHS1924NBM自1070701生效);(FBHS16010NZ1;FBHC18755NZ1自1090501刪除);【自1110301產品型號重整,由以下特材代碼組合:FBHC10214NBM;FBHL19866NBM;FBHH19915NBM;FBHC18753NZ1;FBHH18018NZ1;FBHS17862NZ1;FBHS17711NZ1;FBHS12900NZ1;FBHS17850NZ1;FBHL18751NZ1;FBHC16200NZ1;FBHL16305NZ1;FBHS17857NZ1;FBHS11924NBM;(FBHH18022N40;FBHL10568NBM;FBHL134998Z1自1100301生效)】	組	衛署醫器輸字第021835+021851+008736+011510+014133號+衛部醫器輸字第025775+030214+029866+029915號+030380號+034829+030568+034998號	捷邁	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
151	FBHPAKT2TBM	"邦美"今適穩組合式人工髖關節系統	"Biomet"G7 Kinectiv Total Hip System	由以下特材代碼組 合:FBHC10214NBM;FBHL19866NBM;FBHH19915NBM;FBHC18753NZ1;FBHH18018NZ1;FBHS1KTV1NZ1;FBHL18751NZ1;FBHC16200NZ1;FBHL16305NZ1;FBHC18755NZ1;(FBHC18755NZ1自1090501刪除);由以下特材代碼組 合:FBHC10214NBM;FBHL19866NBM;FBHH19915NBM;FBHC18753NZ1;FBHH18018NZ1;FBHS1KTV1NZ1;FBHL18751NZ1;FBHC16200NZ1;FBHL16305NZ1;FBHC18755NZ1;(FBHC18755NZ1自1090501刪除);(FBHH18022N40;FBHL10568NBM;FBHL134998Z1自1110301生效)	組	衛署醫器輸字第021835+021851+008736+019267+022215號+衛部醫器輸字第025775+030214+029866+029915+034829+030568+034998號	捷邁	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
152	FBHPCERA5S2	"好美得卡奧斯得寧"愛克雷得人工髖關節系統-陶瓷頭+陶瓷內襯	"HOWMEDICA OSTEONICS" ACCOLADE FEMORAL HIP SYSTEM-CERAMIC HEAD+CERAMIC LINER	由以下特材代碼組 合:FBHS160ACNS2;FBHLCERA1S2;FBHHC CERA1S2;FBHC154NXNS2	組	衛署醫器輸字第024813號+010293號	史賽克	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
153	FBHPCERA6BM	"邦美"今適穩組合式陶瓷人工髖關節系統	"Biomet"G7 Kinectiv Ceramic Total Hip System	由以下特材代碼組 合:FBHC10214NBM;FBHL19866NBM;FBHHC CERA1BM;FBHC16200NZ1;FBHL16305NZ1;FBHHC CERA2Z1;FBHS1KTV1NZ1;FBHC18753NZ1;FBHL18751NZ1;FBHC18755NZ1;(FBHC18755NZ1自1090501刪除);由以下特材代碼組 合:FBHC10214NBM;FBHL19866NBM;FBHHC CERA1BM;FBHC16200NZ1;FBHL16305NZ1;FBHHC CERA2Z1;FBHS1KTV1NZ1;FBHC18753NZ1;FBHL18751NZ1;FBHC18755NZ1;(FBHC18755NZ1自1090501刪除);(FBHL10568NBM;FBHL134998Z1自1110301生效)	組	衛署醫器輸字第021835+021851+022415+019267+022215號+衛部醫器輸字第025775+030214+029866+030202+030568+034998號	捷邁	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
154	FBHPCERA6S2	"好美得卡奧斯得寧"愛克雷得髖關節系統-陶瓷頭	"HOWMEDICA OSTEONICS" ACCOLADE FEMORAL HIP SYSTEM-CERAMIC HEAD	由以下特材代碼組合:FBHS160ACNS2;FBHL16200NS2;FBHL16201NS2;FBHL11236NS2;FBHHCERA1S2;FBHC154NXNS2	組	衛署醫器輸字第024813號 +010293號 +019314號 +011235號 +022771號 +024932號	史賽克	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
155	FBHPCERE7BM	"邦美"今適穩陶瓷人工髖關節系統-Option	"Biomet"G7 Ceramic Total Hip System-Option	由以下特材代碼組合:FBHC10214NBM;FBHL19866NBM;FBHHC CERA2BM;FBHHCERR3Z1;FBHC16200NZ1;FBHL16305NZ1;FBHS17862NZ1;FBHS17711NZ1;FBHS12900NZ1;FBHS17850NZ1;FBHS16010NZ1;FBHC18755NZ1;FBHS17857NZ1;FBHC18753NZ1;FBHL18751NZ1;(FBHS1924NBM自1070701生效);(FBHS16010NZ1;FBHC18755NZ1自1090501刪除);由以下特材代碼組合:FBHC10214NBM;FBHL19866NBM;FBHHC CERA2BM;FBHHCERR3Z1;FBHC16200NZ1;FBHL16305NZ1;FBHS17862NZ1;FBHS17711NZ1;FBHS12900NZ1;FBHS17850NZ1;FBHS16010NZ1;FBHC18755NZ1;FBHS17857NZ1;FBHC18753NZ1;FBHL18751NZ1;(FBHS1924NBM自1070701生效);(FBHS16010NZ1;FBHC18755NZ1自1090501刪除);(FBHL10568NBM;FBHL134998Z1自1110301生效)	組	衛署醫器輸字第021835+021851+022415+008736+011510+014133號+衛部醫器輸字第025775+030214+029866+030202+030380號 +030568+034998號	捷邁	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
156	FBHPCCERE8BM	"邦美"今適穩組合式陶瓷人工髖關節系統-Option	"Biomet"G7 Kinectiv Ceramic Total Hip System-Option	由以下特材代碼組 合:FBHC10214NBM;FBHL19866NBM;FBHHC CERA2BM;FBHHCERR3Z1;FBHC16200NZ1;FBHL16305NZ1;FBHS1KTV1NZ1;FBHC18755NZ1;FBHC18753NZ1;FBHL18751NZ1;(FBHC18755NZ1自1090501刪除);由以下特材代碼組 合:FBHC10214NBM;FBHL19866NBM;FBHHC CERA2BM;FBHHCERR3Z1;FBHC16200NZ1;FBHL16305NZ1;FBHS1KTV1NZ1;FBHC18755NZ1;FBHC18753NZ1;FBHL18751NZ1;(FBHC18755NZ1自1090501刪除);(FBHL10568NBM;FBHL134998Z1自1110301生效)	組	衛署醫器輸字第021835+021851+022415+019267+022215號+衛部醫器輸字第025775+030214+029866+030202+030568+034998號	捷邁	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
157	FBHRA1000NDP	"帝富"全人工髖關節系統:重建型全人工髖關節組	"DEPUY"AML TOTAL HIP SYSTEM:REVISION TOTAL HIP SYSTEM	按組件型號組合	SET	衛署醫器輸字第009211號	壯生	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
158	FBHRA8000TBM	"邦美"今適穩重建型人工髖關節系統	"Biomet"G7 Revision Total Hip System	由以下特材代碼組 合:FBHC10214NBM;FBHL19866NBM;FBHH19915NBM;FBHC18753NZ1;FBHH18018NZ1;FBHS30102NZ1;FBHS37846NZ1;FBHL18751NZ1;FBHC16200NZ1;FBHL16305NZ1;FBHC18755NZ1;(FBHC18755NZ1自1090501刪除);由以下特材代碼組 合:FBHC10214NBM;FBHL19866NBM;FBHH19915NBM;FBHC18753NZ1;FBHH18018NZ1;FBHS30102NZ1;FBHS37846NZ1;FBHL18751NZ1;FBHC16200NZ1;FBHL16305NZ1;FBHC18755NZ1;(FBHC18755NZ1自1090501刪除);(FBHH18022N40;FBHL10568NBM;FBHL134998Z1自1110301生效)	組	衛署醫器輸字第021835+021851+008736+023407號+衛部醫器輸字第025775+030214+029866+029915+034829+030568+034998號	捷邁	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
159	FBHRCCERE5BM	"邦美"今適穩陶瓷重建型人工髖關節系統-Option	"Biomet"G7 Ceramic Revision Total Hip System-Option	由以下特材代碼組合:FBHC10214NBM;FBHL19866NBM;FBHHC CERA2BM;FBHHCERR3Z1;FBHC16200NZ1;FBHL16305NZ1;FBHS30102NZ1;FBHS37846NZ1;FBHC18755NZ1;FBHC18753NZ1;FBHL18751NZ1;(FBHC18755NZ1自1090501刪除);由以下特材代碼組合:FBHC10214NBM;FBHL19866NBM;FBHHC CERA2BM;FBHHCERR3Z1;FBHC16200NZ1;FBHL16305NZ1;FBHS30102NZ1;FBHS37846NZ1;FBHC18755NZ1;FBHC18753NZ1;FBHL18751NZ1;(FBHC18755NZ1自1090501刪除);(FBHL10568NBM;FBHL134998Z1自1110301生效)	組	衛署醫器輸字第021835+021851+022415+008736+023407號+衛部醫器輸字第025775+030214+029866+030202+030568+034998號	捷邁	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
160	FBHS1135XNDP	"帝富"全人工髖關節系統:股骨柄	"DEPUY" AML TOTAL HIP SYSTEM:STEM	1354-12:17;1357-42:46;(1554-02:08;42:48;1557-42:48;1345-20:27;1354-12:17;1357-42:46自1020801刪除)	EA	衛署醫器輸字第009211號	壯生	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
161	FBHS11924NBM	"邦美"人工髖關節艾可股骨柄	"Biomet"Hip Joint Replacement Prostheses Echo Femoral Stem	12-1503-07:17;12-1513-07:09;11;13;15;17;1920-07:21;1924-07:21;1930-07:21;1928-07:08	支	衛部醫器輸字第030380號	捷邁	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
162	FBHS160ACNS2	"好美得卡奧斯得寧"愛克雷得髖關節系統-股骨柄	"HOWMEDICA OSTEONICS" ACCOLADE FEMORAL HIP SYSTEM-HIP STEM	605-7;8-0-230;335;435;537;637;740-D;6077-0-130;230;335;435;537;637;740;840	支	衛署醫器輸字第024813號	史賽克	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
163	FBKA27510NS2	"好美得卡-奧斯得寧"斯高比歐全人工膝關節系統:股骨墊片	"HOWMEDICA OSTEONICS" SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM:FEMORAL AUGMENTATION	(75-1-3-03;05;07;09;11;13-05;10)(75-1-03;05;07;09;11;13-15);(75-4-03;05;07;09;11;13-10);(75-5-03;05;07;09;11;13-05)	EA	衛署醫器輸字第021496號	史賽克	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
164	FBKE21890NW2	"瑞德"人工膝關節系統:重建型延長型股骨骨柄	"WRIGHT" KNEE SYSTEM:REVISION FEMORAL LONG STEM	1890-0036;0038;0030;0032	EA	衛署醫器輸字第007187號	裕強	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
165	FBKF15970NZ1	"西美"人工膝關節:股骨組件	"ZIMMER" NEXGEN FEMORAL COMPONENT(CR)	5966;5970;5972-01:02;(00-5966-013:017-01:02;00-5970-011:017-01:02;自1030501生效)	EA	衛署醫器輸字第007513號+025302號	台灣捷邁	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
166	FBKF15996TZ1	"西美"人工膝關節:股骨組件	"ZIMMER" NEXGEN FEMORAL COMPONENT(LPS)	5996-11:18-01:02;(00-5996-011:018-51;52自;941001生效)(00-5996-011:018-51;52自1030501刪除);(00-5996-013:018-51:52;00-5996-013:017-01:02;自1030501生效)	EA	衛署醫器輸字第007513號+025302號	台灣捷邁	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
167	FBKF1921CASN	"史耐輝"全膝關節系統-CR股骨植入物	"Smith & Nephew" Anthem CR Total Knee System-Femoral Components(CR)	714229-21:26;33:38;41:46;53:58	個	衛部醫器輸字第030244號	史耐輝	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
168	FBKF26000NS2	"好美得卡-奧斯得寧"斯高比歐人工膝關節系統:重建型股骨	"HOWMEDICA OSTEONICS" SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM:FEMORAL COPMONENT	76-4003L;R:4013L;R;76-4103L;R:4113L;R;(1010401整理76-40;41-03;05:07;09;11;13-R;L)	EA	衛署醫器輸字第021496號	史賽克	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
169	FBKL10460NJJ	"帝富"人工膝關節:脛骨襯墊	"DEPUY" P. F. C. M KNEE SYSTEM: INSERT	4601:4695;4020:4395	EA	衛署醫器輸字第008168號	壯生	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
170	FBKL15971NZ1	"西美"人工膝關節:脛骨襯墊	"ZIMMER" NEXGEN COMPLETE KNEE SOLUTION:ARTICULAR SURFACE	5972-20;21;30;31;40;50	EA	衛署醫器輸字第007513號	捷邁	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
171	FBKL15996NZ1	"西美"人工膝關節:脛骨襯墊	"ZIMMER" NEXGEN COMPLETE KNEE SOLUTION:NEXGEN TIBIAL ARTICULAR SURFACE	5996-20:51-09:23	EA	衛署醫器輸字第007513號	捷邁	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
172	FBKL19602NJJ	"帝富"人工膝關節:脛骨襯墊	"DEPUY" P. F. C. M KNEE SYSTEM:TIBIAL INSERT	96-0200:0275;96-0310:0385	EA	衛署醫器輸字第008168號	壯生	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
173	FBKL1961CASN	"史耐輝"全膝關節系統-CR 脛骨襯墊	"Smith & Nephew" Anthem CR Total Knee System-CR HF Insert	714229-61:69;71:79;81:82	個	衛部醫器輸字第030244號	史耐輝	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
174	FBKP1574CASN	"史耐輝"全膝關節系統-髌骨植入物	"Smith & Nephew" Anthem CR Total Knee System-Patella Components	714205-74;76;78;80	個	衛部醫器輸字第030244號	史耐輝	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
175	FBKPA244CASN	"史耐輝"全膝關節系統-高彎曲度全人工膝關節系統	"Smith & Nephew" Anthem CR Total Knee System-CR High Flex	由以下特材代碼組合: FBKF1921CASN;FBKT1691CASN;FBKL1961CASN;FBKP1574CASN	組	衛部醫器輸字第030244號	史耐輝	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
176	FBKT10411NJJ	"帝富"人工膝關節:脛骨基座	"DEPUY" P. F. C. M KNEE SYSTEM:TIBIAL BASE	0122:6597;2-7005-02	EA	衛署醫器輸字第008168號	壯生	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
177	FBKT1691CASN	"史耐輝"全膝關節系統-人工脛骨板	"Smith & Nephew" Anthem CR Total Knee System-Tibial Base Plate	714226-91:98;714228-41:48	個	衛部醫器輸字第030244號	史耐輝	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
178	FBN04525125H	"鴻君"骨髓內釘系統/鎖定螺絲	"HC" Nail System/Locking Screw	(HN03-05-2525;3030;3535;4040;4545;5050;5555;6060;6565;7070;7575;8080;8585;9090;9595;0000;0505;1010;1515;2020;2513;3015;3518;4020;4523;5025;5528;6030;6533;7035;7538;8040;8543;9045;9548;0050;0553;1055;1558;2010-S)	支	衛部醫器製字第005911號	鴻君	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
179	FBN05091315H	"鴻君"骨髓內釘系統/脛骨髓內釘組	"HC" Nail System /Tibial Nail(Nail*1+Screw*4+End Cap*1)	【Nail : (HN03-09:12-240;255;270;285;300;315;330;345;360;375;390;405;420-1S)(HN03-13-300;315;330;345;360;375;390;405;420-1S)】 【Screw : (HN03-040045S)(HN03-05-2525;3030;3535;4040;4545;5050;5555;6060;6565;7070;7575;8080;8585;9090;9595;0000;0505;1010;1515;2020;2513;3015;3518;4020;4523;5025;5528;6030;6533;7035;7538;8040;8543;9045;9548;0050;0553;1055;1558;2010-S)】 【End Cap : (HN03-10:15-0012S)】	組	衛部醫器製字第005911號	鴻君	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
180	FBN05091325H	"鴻君"骨髓內釘系統/股骨髓內釘組	"HC" Nail System /Femoral Nail(Nail*1+Screw*4+End Cap*1)	【Nail : (HN03-09:12-260;280;300;320;340;360;380;400;420;440;460;480-2S)(HN03-13-300;320;340;360;380;400;420;440;460;480-2S)】 【Screw : (HN03-040045S)(HN03-05-2525;3030;3535;4040;4545;5050;5555;6060;6565;7070;7575;8080;8585;9090;9595;0000;0505;1010;1515;2020;2513;3015;3518;4020;4523;5025;5528;6030;6533;7035;7538;8040;8543;9045;9548;0050;0553;1055;1558;2010-S)】 【End Cap : (HN03-10:15-0012S)】	組	衛部醫器製字第005911號	鴻君	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
181	FBNG1101235H	"鴻君"骨髓內釘系統/股骨頸髓內釘組	"HC" Nail System /Femoral Neck Nail(Nail*1+Screw*4+End Cap*1)	由下列特材代碼組合:FBNG2101235H;FBN04525125H;FBNG3100285H;FBNG3117115H	組	衛部醫器製字第005911號	鴻君	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
182	FBNG14003NS9	"史賽克"脛股骨固定系統:骨髓內釘組	"STRYKER" GAMMA3 SYSTEM	4003-0822S;4060-0070S;0130S;(4120;4125;4130-;0170S;1180S;1200S;2170S;2200S)	SET	衛署醫器輸字第013922號	史賽克	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
183	FBNG2101235H	"鴻君"骨髓內釘系統/股骨頸髓內釘	"HC" Nail System /Femoral Neck Nail(Nail*1+End Cap*1)	【Nail : (HN03-10:12-170;200-3S)(HN03-10:12-170;200-4S)】 【End Cap : (HN03-10:15-0012S)】	支	衛部醫器製字第005911號	鴻君	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
184	FBNG3100285H	"鴻君"骨髓內釘系統/固定螺絲	"HC" Nail System/Set Screw	HN03-102830S	支	衛部醫器製字第005911號	鴻君	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
185	FBNG3117115H	"鴻君"骨髓內釘系統/拉力螺絲	"HC" Nail System/Lag Screw	(HN03-11-70;75;80;85;90;95;00;05;11-30S)	支	衛部醫器製字第005911號	鴻君	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
186	FBP0124201V2	"鏡鈦"骨釘骨板植入物(管型骨板2.7MM)	"INTAI" BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(TUBULAR PLATE 2.7MM)	242003;008	個	衛署醫器製字第002074號	鏡鈦	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
187	FBP0140302SN	"史耐輝"骨釘與骨板-1/3軸環管型骨板	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-One-Third Tubular Plates with Collar	7114-0302:0310;0312	個	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
188	FBP0141302SN	"史耐輝"骨釘與骨板-半管型骨板	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-Semi-Tubular Plates	7114-1302:1312	個	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
189	FBP0147003SN	"史耐輝"骨釘與骨板-1/4管型骨板	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-Quarter-Tubular Plates	7114-7001:7004;8003:8008	個	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
190	FBP020LC275H	"鴻君"骨板骨釘系統II-2.7低接觸動態加壓骨板	"HC" Bone Plates and Bone Screws II-2.7 Limited Contact Dynamic Compression Plate	HN02-S25-2402;3303;4204;5105;6006;6907;7808;8709;9610;1011;1112;1213;1314	個	衛部醫器製字第006024號	鴻君	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
191	FBP0240402SN	"史耐輝"骨釘與骨板-3.5mm小型加壓板	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-3.5mm Small Compression Plates	7114-0202:0210;0212;0214;0216;0218;0220;0222	個	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
192	FBP02408085H	"鴻君"骨板骨釘系統/加長窄型骨板	"HC" BONE PLATES AND SCREWS/LENGTHENING NARROW PLATE	HN02-403008L;404008L;405008L;406008L;407008L;408008L	個	衛部醫器製字第004670號	鴻君	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
193	FBP0241206SN	"史耐輝"骨釘與骨板-4.5mm寬型加壓板	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-4.5mm Board Compression Plates	7114-1206:1210;1212;1214;1216;1218	個	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
194	FBP0241402SN	"史耐輝"骨釘與骨板-4.5mm窄型骨板	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-4.5mm Narrow Compression Plates	7114-1402:1416;1418;1420;1424	個	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
195	FBP0241900SN	"史耐輝"骨釘與骨板-2.7mm小型加壓骨板	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-2.7mm Small Compression Plates	7114-1900;1902;1904:1910;1912	個	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
196	FBP02458105H	"鴻君"骨板骨釘系統/加長寬型骨板	"HC" BONE PLATES AND SCREWS/LENGTHENING WIDE PLATE	HN02-454008L;456008L;455010L;457010L;459010L;451110L	個	衛部醫器製字第004670號	鴻君	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
197	FBP0246020SN	"史耐輝"骨釘與骨板-2.0mm 直型骨板	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-2.0mm Straight Plate	7114-6020;6022;6024;6026	個	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
198	FBP03156185H	"鴻君"骨板骨釘系統/可彎曲骨板15度	"HC" BONE PLATES AND SCREWS/RECONSTRUCTION PLATE(LC-DCP)	HN02-157006L;159408L;151210L;151412L;151714L;151916L;152118L	個	衛部醫器製字第004670號	鴻君	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
199	FBP0324348S1	"信迪思"骨板植入物:迷你型Adaption骨板	"SYNTHESE" BONE PLATE IMPLANT:MINI PLATE	(243.48自1010101刪除);(246.48自89/10/1生效);(243.48自960101生效)	EA	衛署醫器輸字第007815號	壯生	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
200	FBP0324807V2	"鏡鈦"骨釘骨板植入物(骨踝支撐骨板4.5MM)	"INTAI" BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(CONDYLAR BUTTRESS PLATE4.5MM)	240707;715;240807;815	個	衛署醫器製字第002074號	鏡鈦	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
201	FBP03253055H	鴻君"骨板骨釘系統/支撐Y型骨板	"HC" BONE PLATES AND SCREWS/BUTTRESS Y FORK PLATE	HN02-258213L;251115L;258223L;251125L	個	衛部醫器製字第004670號	鴻君	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
202	FBP03253065H	"鴻君"骨板骨釘系統/T型肱骨骨板	"HC" BONE PLATES AND SCREWS/T HUMERAL PLATE	HN02-256913L;258514L;251015L;251216L;256923L;258524L;251025L;251226L	個	衛部醫器製字第004670號	鴻君	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
203	FBP03254125H	"鴻君"骨板骨釘系統/支撐-骨盆骨板	"HC" BONE PLATES AND SCREWS/PELEVIS AND ACETABULUM PLATE-SHERMAN TYPE	HN02-256404L;251006L;251509L;252112L	個	衛部醫器製字第004670號	鴻君	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
204	FBP0340016SN	"史耐輝"骨釘與骨板-4.5mm重建骨板	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-4.5mm RECONTRACTION PLATE	7114-0003:0016	個	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
205	FBP0340104SN	"史耐輝"骨釘與骨板-3.5mm重建骨板;彎曲型重建骨板	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-3.5mm Reconstruction Plates;Curved Reconstruction Plates	7114-0104:0116;0118;0120;0122;0606;0608;0610;0612;0614;0616;0618;7012	個	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
206	FBP0340403SN	"史耐輝"骨釘與骨板-小型T型骨板	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-Small T-Plates	7114-0403:0406	個	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
207	FBP0340503SN	"史耐輝"骨釘與骨板-小型T型骨板	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-Small T-Plates	7114-0503:0505	個	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
208	FBP0340603SN	"史耐輝"骨釘與骨板-小型首箔型骨板	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-Small Cloverleaf Plates	7114-0603;0604;0625:0629	個	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
209	FBP0340704SN	"史耐輝"骨釘與骨板-T型支撐型骨板;L型支撐型骨板	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-T-Buttress Plates;L-Buttress Plates	7114-0704:0706;0804;0904	個	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
210	FBP0341003SN	"史耐輝"骨釘與骨板-側邊脛骨支撐型骨板	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-Lateral Tibial Head Buttress Plates	7114-1003;1005;1007;1009;1011;1013;1105;1107;1109;1111;1113	個	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
211	FBP0341505SN	"史耐輝"骨釘與骨板-湯匙型骨板	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-Spoon Plate	7114-1505;1506	個	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
212	FBP0341603SN	"史耐輝"骨釘與骨板-大型T型骨板	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-Large T-Plates	7114-1603:1606;1608	個	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
213	FBP0342007SN	"史耐輝"骨釘與骨板-髁支撐骨板	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-Condylar Buttress Plates	7114-2007;2009;2011;2013;2015;2107;2109;2111;2113;2115	個	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
214	FBP0344010SN	"史耐輝"骨釘與骨板-跟骨骨板	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-Calcaneal Plates with Templates	7114-4010:4012	個	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
215	FBP0345020SN	"史耐輝"骨釘與骨板-1.5mm直型骨板	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-1.5mm Straight Plate	7114-5020	個	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
216	FBP0345022SN	"史耐輝"骨釘與骨板-1.5mm;2.0mm T型骨板	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-1.5mm;2.0mm T-Plates	7114-5022;5024;6030;6032;6034	個	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
217	FBP0345030SN	"史耐輝"骨釘與骨板-1.5mm;2.0mm H型骨板	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-1.5mm;2.0mm H-Plates	7114-5030;6048	個	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
218	FBP0346036SN	"史耐輝"骨釘與骨板-2.0mm L型骨板;2.7mm T型骨板	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-2.0mm L-Plate;2.7mm T-Plate	7114-6036;6038;6044;6046;7006	個	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
219	FBP0346040SN	"史耐輝"骨釘與骨板-2.0mm;2.7mm髁骨板	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-2.0mm;2.7mm Condylar Plates	7114-6040;7008;7010	個	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
220	FBP04238NNS1	"信迪思"骨板植入物:彎角型骨板	"SYNTHES" BONE PLATE IMPLANT: ANGLED BLADE PLATE	238.24:98;(238.240:980自960101生效)	EA	衛署醫器輸字第007815號	壯生	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
221	FBP0425320SN	"史耐輝"骨釘與骨板-成人截骨骨板	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-Adult Osteotomy Plates	7122-5320:5330;5332:5356	個	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
222	FBP0425400SN	"史耐輝"骨釘與骨板-95°成人葉狀骨板	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-95° Adult Blade Plates	7122-5400:5425	個	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
223	FBP0425430SN	"史耐輝"骨釘與骨板-95°髁骨板	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-95° Condylar Plates	7122-5430:5441	個	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
224	FBP0425500SN	"史耐輝"骨釘與骨板-130°彎曲成人骨板	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-130° Adult Angled Plates;Angled Blade Plates	7122-5500:5506;5508:5521;5530:5541	個	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
225	FBP0425600SN	"史耐輝"骨釘與骨板-90°嬰兒截骨骨板	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-90° Infant Osteotomy Blade Plate;Child Osteotomy Plates	7122-5600:5603;5620:5625	個	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
226	FBP0425610SN	"史耐輝"骨釘與骨板-115°分叉嬰兒葉狀骨板	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-115° Bifurcated Infant Blade Plate	7122-5610;5611	個	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
227	FBP0425640SN	"史耐輝"骨釘與骨板-90°青少年截骨骨板	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-90° Adolescent Osteotomy Plates	7122-5640:5644	個	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
228	FBP04283XNS1	"信迪思"骨板植入物:彎角型骨板	"SYNTHE" BONE PLATE IMPLANT: ANGLED BLADE PLATE	283.400:460;283.600:660;283.900:960	EA	衛署醫器輸字第007815號	壯生	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
229	FBPN229368V2	"鏡鈦"骨釘骨板植入物/史氏骨針	"INTAI" BONE SCREW and BONE PLATE IMPLANT/K-PIN	293680:690;293730:740;292001:009;292101:109;292201:209;292301:309;291504:510;291005:011;291529:535;291580:585;291030:036;29430;29443:470;292021:029;292121:129;292221:229;292321:329;292041:049;292141:149;291055:061;292241:249;292341:349;291554:560;292061:069;292161:169;291080;291580:585;292261:269;292361:369;293350:360;293400:590	支	衛署醫器製字第002074號	鏡鈦	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
230	FBS0125716SN	"史耐輝"骨釘與骨板-3.5mm;4.5mm骨幹骨釘	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-3.5mm;4.5mm Shaft Screws	(7122-57-16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;45;50);(7122-58-22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58;60;64;68;72;76;80;85;90;95);7122-5900	支	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
231	FBS0141440V2	"鏡鈦"骨釘骨板植入物(皮質骨釘鈦4.5mm)	"INTAI" BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT((CORTEX SCREW T6A14V4.5mm)	4140012:160;4142022:115	個	衛署醫器製字第002074號	鏡鈦	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
232	FBS0149714SN	"史耐輝"骨釘與骨板-4.5mm皮質骨釘	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-4.5mm Cortex Screws	(7114-97-14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;;44;46;48;50;52;54;56;58;60;62;64;66;68;70;72;76;80;85;90;95);(7114-98-00;05;10;15;20;25;30;35;40;45);(7122-50-14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58;60;62;64;66;68;70;72;76;80;85;90;95);(7122-51-00;05;10;15;20;25;30;35;40;45)	支	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
233	FBS0161506SN	"史耐輝"骨釘與骨板-皮質骨釘	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-Cortex Screws	(7116-1506;1512;1514;1516;1518;1520);(7114-9106;9112;9114;9116;9118;9120;9122;9124);(7116-1606;1612;1614;1616;1618;1620);(7114-9006;9012;9014;9016;9018;9020;9022;9024);(7116-2206;08;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;36;38);(7114-9306;08;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38);(7116-2106;08;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34);(7114-9206;08;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38);(7122-0006;08;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;45;50);(7114-9406;08;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;45;50;55;60;65;70);(7122-2010;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95);(7114-9510;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95);(7122-2100;05;10;15;20;30);(7114-9600;05;10;15;20;25;30)	支	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
234	FBS0223010SN	"史耐輝"骨釘與骨板-4.0mm 螺紋海綿骨釘;部分螺紋海綿骨釘	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-4.0mm Threaded Cancellous Screws;Partially Threaded Cancellous Screws	(7122-3010;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;35;36;40;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95);7122-3100;(7122-32-10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;35;40;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95);7122-3300	支	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
235	FBS0226030SN	"史耐輝"骨釘與骨板-6.5mm海綿骨釘	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-6.5mm Cancellous Screws	(7122-60-30;35;40;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95);(7122-61-00;05;10;15;20;25;30;35;40;45;50);(7122-80-45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95);(7122-81-00;05;10;15;20;25;60;35;40;45;50);(7122-90-25;30;35;40;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95);(7122-91-00;05;10;15;20;25;30;35;40;45;50)	支	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
236	FBS0325225SN	"史耐輝"骨釘與骨板-4.5 mm 踝骨釘	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plates-4.5 mm Malleolar Screws	7122-52-25;30;35;40;45;50;55;60;65;70	支	衛部醫器輸字第031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
237	FBS0412675SN	"史耐輝"中空骨旋釘	"Smith & Nephew" Cannulated Screws/Hip Pin System(30:135MM)	12-1654:1675	支	衛署醫器輸字第020643號	史耐輝	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
238	FBS0421184V2	"鏡鈦"骨釘骨板植入物/中空骨釘	"INTAI" BONE SCREW and BONE PLATE IMPLANT/CANNULATEDSCREW2.4-7.3mm	2118010:030;2118417:430;2026008:040;2027014:040;2050010:060;2052010:060;2076010:050;2077016:050;2145020:072;2147020:072;2084030:180;2085045:180;2086020:180;2080030:150;2090045:150;2094020:150;2088030:160;2098045:150;2096020:130	支	衛署醫器製字第002074號	鏡鈦	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
239	FBS0421810SN	"史耐輝"中空骨旋釘	"SMITH & NEPHEW" CANNULATED SCREWS	12-1810:70;12-1625:44;7110-0045:130	EA	衛署醫器輸字第020643號	史耐輝	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
240	FBS0461110SN	"史耐輝"中空骨旋釘	"Smith & Nephew" Cannulated Screws(6.5mm*40:110mm) /Titanium	7116-1040:1110	支	衛署醫器輸字第 020643號	史耐輝	連續3年無醫令申報量，且 有替代品項可供病人使用 者，不列入健保給付。	112/04/01
241	FBS0721991V2	"鏡鈦"骨釘骨板植入物/ 墊圈	"INTAI" BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT/Washer Dia4.5/7.0/13.0mm	2199070;2199080;2199090	個	衛署醫器製字第 002074號	鏡鈦	連續3年無醫令申報量，且 有替代品項可供病人使用 者，不列入健保給付。	112/04/01
242	FBS0743104SN	"史耐輝"骨釘與骨板-骨 釘墊片	"Smith&Nephew" TC-100 Screws and Plate- Washer	7114- 3104;3107;3110;3113;3004;3007;3010 ;3013	個	衛部醫器輸字第 031015號	史耐輝	連續3年無醫令申報量，且 有替代品項可供病人使用 者，不列入健保給付。	112/04/01
243	FBS0800234S2	"史賽克"前十字韌帶界 面固定螺釘	"STRYKER" ACL INTERFERENCE SCREW	234-010-051:056;234-030-042:051	支	衛部醫器輸字第 025763號	史賽克	連續3年無醫令申報量，且 有替代品項可供病人使用 者，不列入健保給付。	112/04/01
244	FBS0818065T1	"邁特"美來構界面螺釘 系統	"Mitek" Milagro Interference Screw System	2318- 00;03:05;07;09:10;20;15:32;35;40;4 5;50;55;60;65	個	衛部醫器輸字第 028053號	壯生	連續3年無醫令申報量，且 有替代品項可供病人使用 者，不列入健保給付。	112/04/01
245	FBSCM6487NH1	"好美得卡"人工替換物 組合系統:訂製型人工肩 關節系統	"HOWMEDICA" MODULAR REPLACEMENT SYSTEM:CASTOM MADE HUMERAL PROTHESIS	按組件型號組合	SET	衛署醫器輸字第 009339號	史賽克	連續3年無醫令申報量，且 有替代品項可供病人使用 者，不列入健保給付。	112/04/01
246	FBSF101640B0	"長安" 脊頸椎內固定系 統:二節	"BMI" SPINAL FIXATION SYSTEM:TITANIUM LUMBAR SPINAL SYSTEM (PX2+SX4)	XCP40X2+120-6040X4	SET	衛署醫器製字第 000981號	長安	連續3年無醫令申報量，且 有替代品項可供病人使用 者，不列入健保給付。	112/04/01
247	FBSF101641B0	"長安" 脊頸椎內固定系 統:三節	"BMI" SPINAL FIXATION SYSTEM:TITANIUM LUMBAR SPINAL SYSTEM (PX2+SX6)	XCP41X2+120-6040X6	SET	衛署醫器製字第 000981號	長安	連續3年無醫令申報量，且 有替代品項可供病人使用 者，不列入健保給付。	112/04/01
248	FBSF101643B0	"長安" 脊頸椎內固定系 統:三節(免事前審查)	"BMI" SPINAL FIXATION SYSTEM:TITANIUM LUMBAR SYSTEM (SX6+RX2)	170-5030:39+PR70:PR100	SET	衛署醫器製字第 000981號	長安	連續3年無醫令申報量，且 有替代品項可供病人使用 者，不列入健保給付。	112/04/01
249	FBSF1245755H	"鴻君" 椎弓螺絲系統-二 節(免事前審查)	"HC" SPINAL FIXATION SYSTEM(RX2+SX4)	由以下特材代碼組 合:FBSF4045755H;FBSF2050605H	組	衛部醫器製字第 005067號	鴻君	連續3年無醫令申報量，且 有替代品項可供病人使用 者，不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
250	FBSF1345755H	"鴻君"椎弓螺絲系統-三節(免事前審查)	"HC" SPINAL FIXATION SYSTEM(RX2+SX6)	由以下特材代碼組合:FBSF4045755H;FBSF2050605H	組	衛部醫器製字第005067號	鴻君	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
251	FBSF13820NS9	"史賽克"喜爾脊椎系統:二節前置脊椎固定	"STRYKER" XIA SPINAL SYSTEM:TWO LEVEL	03802040;03802600;03820425;03821760	SET	衛署醫器輸字第009422號+020147號	史賽克	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
252	FBSF140001RK	瑞寶億前路固定系統	REBORN ESSENCE ANTERIOR FIXATION SYSTEM:TITANIUM ANTERIOR SPINAL SYSTEM(PX1+SX4)	445-45U;50U;55U;60U;65U;70U;80U;90U;95U;100U;110U;418-20U;22U;25U;30U;35U;40U;45U;50U;55U	SET	衛署醫器製字第002741號	寶億生技	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
253	FBSF177403Y2	"亞太醫療" C型後方脊椎固定系統:三節	"SYNTEC" C-SHAPE POSTERIOR SPINAL FIXATION SYSTEM:TITANIUM O TYPE (RX2+SX6)	77-4030:455+33:36;765905:30	SET	衛署醫器製字第001022號	亞太	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
254	FBSF181NP2Y2	"亞太醫療"路易橋脊椎固定系統:二節(免事前審查)	"SYNTEC" BRIDGE SPINAL FIXATION SYSTEM(RX2+SX4)	816020:970;817020:970;818020:970;819020:970;820001:019;820029:047;820057:064	SET	衛署醫器製字第002566號	亞太	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
255	FBSF1BAR12L2	"阿伐泰克"脊椎連接系統:二節(SX4+RX2)	"Alphatec" ISOBAR TTL Vertebral Connection Systems	由以下特材代碼組合:FBSF2BAR2SL2;FBSF4BAR4SL2	組	衛署醫器輸字第020555號	科舉	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
256	FBSF1BAR13L2	"阿伐泰克"脊椎連接系統:三節(SX6+RX2)	"Alphatec" ISOBAR TTL Vertebral Connection Systems	由以下特材代碼組合:FBSF2BAR2SL2;FBSF4BAR4SL2	組	衛署醫器輸字第020555號	科舉	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
257	FBSF2050605H	"鴻君"椎弓螺絲系統-連接桿(免事前審查)	"HC" SPINAL FIXATION SYSTEM-ROD(免事前審查)	HN01-1050-10;40;45;50;60;70;80;90;HN01-1055-10;40;45;50;60;70;80;90;HN01-1060-10;40;45;50;60;70;80;90	支	衛部醫器製字第005067號	鴻君	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
258	FBSF26202NS1	"信迪思"潘吉雅脊椎固定系統:固定桿(長節)	"SYNTHES" PANGEA SPINE SYSTEM: ROD(長節)	04.622.314:317;04.622.352:355	EA	衛署醫器輸字第018777號	壯生	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
259	FBSF2820ONLY2	"亞太醫療"路易橋脊椎固定系統:固定桿(免事前審查)	"SYNTEC" BRIDGE SPINAL FIXATION SYSTEM:TITANIUM ROD	820020:028;820048:056;820065:074	EA	衛署醫器製字第002566號	亞太	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
260	FBSF2820NSY2	"亞太醫療"路易橋脊椎固定系統:固定桿(免事前審查)	"SYNTEC" BRIDGE SPINAL FIXATION SYSTEM:TITANIUM ROD	820001:019;820029:047;820057:064	EA	衛署醫器製字第002566號	亞太	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
261	FBSF2887CSY2	"亞太醫療"高立捷脊椎固定系統:脊椎固定桿(短節)	"SYNTEC" COLISEUM SPINAL FIXATION SYSTEM:ROD	887-0-40;45;50;60;70;80;90;887-100	EA	衛署醫器製字第003085號	亞太	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
262	FBSF2BAR2LL2	"阿伐泰克"脊椎連接系統:固定桿長節	"Alphatec" ISOBAR TTL Vertebral Connection Systems:ROD	12TG55-110;12TG55-130;12TG55-230;12TG55-400	支	衛署醫器輸字第020555號	科舉	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
263	FBSF2BAR2SL2	"阿伐泰克"脊椎連接系統:固定桿(短節)	"Alphatec" ISOBAR TTL Vertebral Connection Systems:ROD45-95MM	12TG55-045;12TG55-055;12TG55-065;12TG55-075;12TG55-085;12TG55-095	支	衛署醫器輸字第020555號	科舉	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
264	FBSF4045755H	"鴻君"椎弓螺絲系統-椎弓螺絲(免事前審查)	"HC" SPINAL FIXATION SYSTEM-PEDICLE SCREW	HN01-0145;0150;0155;0160;0165;0170;0175;0245;0250;0255;0260;0265;0270;0275;0345;0350;0355;0360;0365;0370;0375;0445;0450;0455;0460;0465;0470;0475-30;60;NH01-051055	支	衛署醫器製字第005067號	鴻君	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
265	FBSF44004TWG	"威創"脊椎固定系統:脊椎U型固定螺釘折斷(免事前審查)	"WILTROM" SPINAL FIXATION SYSTEM:PEDICLE SCREW REDUCTION U TYPE	40040025:40;40041030:45;40042030:50;40043030:55;40044030:70;40045030:70;40046030:70;40047035:70(刪除40040025:40;40041030:45;40042030:50;40043030:55;40044030:70;40045030:70;40046030:70;40047035:70自1080301生效)[型號重整4014-(00-25;30;35;40);(10-30;35;40;45);(20-30;35;40;45;50);(30-30;35;40;45;50;55);(40;50;60-30;35;40;45;50;55;60;65;70);(70-35;40;45;50;55;60;65;70)自1080301生效]	支	衛署醫器製字第003123號	台灣微創	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
266	FBSF44008TV2	"鏡鈦" 脊椎固定系統/脊椎中空U型多軸向骨釘	"INTAI" SPINAL FIXATION SYSTEM/Cannulated Pedicle Screw Poly-Axial U type	(400810-25;30;35;40);(400820-30;35;40;45);(400840-30;35;40;45;50)(400850-30;35;40;45;50;55);(4008-60;70;80-30;35;40;45;50;55;60;65;70);(400890-35;40;45;50;55;60;65;70);(4008-60;70;80-80;90;10自1080701生效);(400810-25;30;35;40);(400820-30;35;40;45);(400840-30;35;40;45;50)(400850-30;35;40;45;50;55);(4008-60;70;80-30;35;40;45;50;55;60;65;70);(400890-35;40;45;50;55;60;65;70);(4008-60;70;80-80;90;10自1080701生效);[(4022-45-25;30;35;40);(4022-50-30;35;40;45);(4022-55-30;35;40;45;50);(4022-60-30;35;40;45;50;55);(4022-65;70;75-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10)自1110101生效]	支	衛署醫器製字第002926號	台灣微創	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
267	FBSF44009TV2	"鏡鈦" 脊椎固定系統:脊椎骨釘-中空U型多軸向折斷	"INTAI" SPINAL FIXATION SYSTEM:CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION U TYPE	40090025:40;40091030:45;40092030:50;40093030:55;40094030:70;40095030:70;40096030:70;40097035:70;(4009-40;50;60-80;90;10自1080701生效);40090025:40;40091030:45;40092030:50;40093030:55;40094030:70;40095030:70;40096030:70;40097035:70;(4009-40;50;60-80;90;10自1080701生效);[(4023-45-25;30;35;40);(4023-50-30;35;40;45);(4023-55-30;35;40;45;50);(4023-60-30;35;40;45;50;55);(4023-65;70;75-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10)自1110101生效]	支	衛署醫器製字第002926號	台灣微創	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
268	FBSF448231S9	"史賽克"喜爾脊椎系統:中空螺釘	"STRYKER" XIA SPINAL SYSTEM:CANNULATED SCREW	482315-35;40;45;50;482316-30;35;40;45;50;55;482317-30;35;40;45;50;55	EA	衛署醫器輸字第009422號	史賽克	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
269	FBSF44989NS1	"信迪思"克里斯脊椎系統:固定螺釘	"SYNTHESE" CLICK X PEDICLE SYSTEM:SCREW	(498.501:508;501V:508V;560:567;560V:567V;791V:798V;974:978;986:993;994:999);(499.000:070;550:557;500V:507V;520V:527V)	EA	衛署醫器輸字第019169號	壯生	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
270	FBSF46201NS1	"信迪思"潘吉雅脊椎固定系統:固定螺釘	"SYNTHESE" PANGEA SPINE SYSTEM:SCREW	(04.620.000;420:445;525:555;625:665;725:799;825:899);(04.622.420:445;525:555;625:665;725:799;825:899;930:999)	EA	衛署醫器輸字第018777號	壯生	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
271	FBSF4884CHY2	"亞太醫療"高立捷脊椎固定系統:固定螺釘	"SYNTEC" COLISEUM SPINAL FIXATION SYSTEM:POLYAXIAL SCREW	884-0:9-30;35;40;45;884-4:9-50;55;884-0:1-20;25;885-0:9-30;35;40;45;885-4:9-50;55;885-0:1-20;25	EA	衛署醫器製字第003085號	亞太	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
272	FBSF56201NS1	"信迪思"潘吉雅脊椎固定系統:橫向固定桿	"SYNTHESE" PANGEA SPINE SYSTEM:TRANSVERSE CONNECTORS	497.796:799;04.620.203;205;(497.796:799自990401刪除)	EA	衛署醫器輸字第018777號	壯生	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
273	FBSF5821NHY2	"亞太醫療"路易橋脊椎固定系統:橫向固定桿(免事前審查)	"SYNTEC" BRIDGE SPINAL FIXATION SYSTEM:TRANSVERSE LINK	821001:003;821005+821006+821007	EA	衛署醫器製字第002566號	亞太	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
274	FBSFA00002RK	瑞寶億頸椎椎間融合器	ReBorn Essence Cervical Intervertebral Cage-Titanium	655-25;26;27;28;29;20-123;844-05123;05143;06123;06143;07133;07143;07153;08143;08153;09143;09153;10153(844-07123自1060901生效)	顆	衛署醫器製字第002856號	寶億生技	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
275	FBSFA055413Z	"克萊兒"艾迪斯頸椎融合器	"Clariance" Idys-C cage cervical	(05541-3:4-05:10);(05541-3:4-05:10--s)	個	衛部醫器輸字第030573號	利民	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
276	FBSFA6741SS9	"史賽克"梭利斯椎頸護架系統(滅菌)	"STRYKER" SOLIS CERVICAL CAGE SYSTEM(STERILE)(PEEK)	6741204S;6741209S;6741404S;6741409S	個	衛署醫器輸字第023152號	史賽克	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
277	FBSFA7091NY2	"亞太醫療"鈦合金錐體:脊椎間體護架	"SYNTEC" TITANIUM VETEBRAE INTERBODY CAGE	709101:709185	EA	衛署醫器製字第001128號	亞太	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
278	FBSFACH11NXA	"全合"頸椎椎間融合器	"AAXTER" CERVICAL CAGE	(CH20;40-512;612;712;812;912);(CH20;40-514;614;714;814;914);(CH21-012;112;014;114);(CH41-012;112;014;114)	EA	衛署醫器製字第002748號	全合	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
279	FBSFC95051S1	"信迪思"頸椎固定植入物:頸椎固定夾	"SYNTHESE" CERVIFIX IMPLANTS:LAMINA CLAMPS	498.950:951	支	衛署醫器輸字第010437號	壯生	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
280	FBSFCASCS2AQ	穩特頸椎骨板系統:固定螺絲	WINLOC CERVICAL PLATE SYSTEM:TITANIUM SCREW	1426-12:1426-26;1427-12:1427-26	EA	衛署醫器製字第002773號	冠亞生技	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
281	FBSFCTRYC21C	"司佰特"頸椎間植入物:二節	SPINEART CERVICAL IMPLANTS	MOS-PL04-20;25;30-S;PL06-35:55;-S;PL08-60;65;70-S;PL10-80;90;-S;(SCREW代碼FBSFCTRYCS1C)	SET	衛署醫器輸字第021460號	讚賀	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
282	FBUL19672NJJ	"帝富"人工膝關節:半膝關節襯墊	"DEPUY" P. F. C. M KNEE SYSTEM:UNICOMPARTMENTAL TIBIAL INSERT COMPONENT	96-7001:7045	EA	衛署醫器輸字第008168號	壯生	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
283	FHFCDCA5HFBK	"百多力"安心可磁振造影植入式心臟去顫器(Intica5)(CRTD)	"BIOTRONIK" Intica Implantable Defibrillator with a conditional intended use in a MRI environment	Intica 5 DF-1;DF4/IS-1 HF-T	個	衛部醫器輸字第030619號	百多力	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
284	FHFCDCA7HFBK	"百多力"安心可磁振造影植入式心臟去顫器(Intica7)(CRTD)	"BIOTRONIK" Intica Implantable Defibrillator with a conditional intended use in a MRI environment	Intica 7 DF-1;DF4/IS-1 HF-T	個	衛部醫器輸字第030619號	百多力	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
285	FHFCDQ367MST	"聖猷達"克卓亞速拉植入式心律去顫器(四極)	"SJM" Quadra Assura Implantable Cardioverter Defibrillator	CD3367-40;CD3367-40C;CD3367-40Q;CD3367-40QC	個	衛部醫器輸字第028256號	雅培	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
286	FHG110504OMP	"印帕"聚四氟乙烯人工血管	"IMPRA" EPTFE VASCULAR GRAFT:STRAIGHT GRAFT	40S05	EA	衛署醫器輸字第009250號	巴德	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
287	FHG120405TMP	"印帕"卡邦人工血管	"IMPRA" CARBOFLO VASCULAR GRAFT	50S04TWC;50S05TWC;50S06TWC;50S07TWC;50S08TWC	EA	衛署醫器輸字第010188號	巴德	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
288	FHP01ADAPSM4	"美敦力"黛拉心臟節律系統	"MEDTRONIC" ADAPTA PACING SYSTEM	ADSR01;ADSR03;ADSR06	EA	衛署醫器輸字第018079號	美敦力	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
289	FHP01ASSRUST	"聖猷達"安速拉第心臟節律器-單腔	"SJM" Assurity Pulse Generator(SR)	Assurity PM1240;Assurity+PM1260	個	衛部醫器輸字第027439號	雅培	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
290	FHP01ENDRUST	"聖猷達"恩德拉第心臟節律器-單腔	"SJM" Endurity Pulse Generator(SR)	EndurityPM1160	個	衛部醫器輸字第027440號	雅培	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
291	FHP01SD01SM4	"美敦力"賽亞心臟節律器	"MEDTRONIC" SENSIA PACEMAKER	SED01	EA	衛署醫器輸字第023214號	美敦力	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
292	FHP41N3432VW	"維喜"人工血管接環-雙環型	"VASORING" VASCULAR RING CONNECTOR	VRC-3432;3232;3032;2830;2630;2430;2228;2027;1827;1625;1424;1223;1021-N	個	衛署醫器製字第002593號	宇仁	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
293	FHP5600793BA	"巴德"心血管補片:2.5CM*10.2CM	"BARD" CARDIOVASCULAR PATCH:CARDIOVASCULAR FABRICS	007942(100/4/1刪除);007937	EA	衛署醫器輸字第014396號	巴德	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
294	FHP5607968BA	"巴德"心血管補片	"BARD" CARDIOVASCULAR PATCH:SURGICAL FELTS	007968;007977	EA	衛署醫器輸字第014396號	巴德	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
295	FHP5607976BA	"巴德"心血管補片	"BARD" CARDIOVASCULAR PATCH:SURGICAL FELTS	007976	EA	衛署醫器輸字第014396號	巴德	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
296	FHPDDR35UST	"聖猷達"弗帝法亞速拉植入式心律去顫器(射頻雙腔型)	"SJM" Fortify Assura Implantable Cardioverter Defibrillator	CD2359-40;CD2359-40C;CD2359-40Q;CD2359-40QC	個	衛署醫器輸字第024173號	雅培	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
297	FHPDVR35UST	"聖猷達"弗帝法亞速拉植入式心律去顫器(射頻單腔型)	"SJM" Fortify Assura Implantable Cardioverter Defibrillator	CD1359-40;CD1359-40C;CD1359-40Q;CD1359-40QC	個	衛署醫器輸字第024173號	雅培	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
298	FHPHFRCRXBPBK	"百多力"可洛進化版植入式心導線(包括配件)	"BIOTRONIK" COROX PROMRI OTW IMPLANTABLE CORONARY SINUS LEADS INCL. ACCESSORIES	COROXPROMRIOTW75-BP381487;85-BP381488;OTWS75-BP381489;85-BP381490;OTWL75-BP381492;85-BP381491	EA	衛署醫器輸字第024514號	百多力	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
299	FHPL11888NST	"聖猷達"心臟節律器導線	"SJM" IMPLANTABLET CARDIAC PACING LEADS	TENDRIL ST 1888TC;1882TC	EA	衛署醫器輸字第010378號	雅培	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
300	FHPL11888UST	"聖猷達"佩斯賽得心臟節律器導線	"SJM" PACESETTER TENDRIL IMPLANTABLE CARDIAC PACING LEAD	TENDRIL ST 1882TC/1888TC	組	衛署醫器輸字第009581號	雅培	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
301	FHPL1B4456GU	"佳騰"纖幼植入式起搏電極導線	"GUIDANT" FINELINE II PACING LEAD	4456:4459;4479:4480;4469:4474	EA	衛署醫器輸字第010619號	波士頓	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
302	FHVD13000TED	"愛德華"卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜-MAGNA	"EDWARDS" CARPENTIER-EDWARDS PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS-MAGNA	3000TFX;7000TFX	EA	衛署醫器輸字第018210號	台灣愛德華	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
303	FHX02FX15RTM	"泰爾茂"菲斯膜型人工心肺(人工心肺及動脈過濾器)	"TERUMO" CAPIOX FX	CX*FX05;15;25;W;E(CX*FX15;25W;E自1040701刪除,重新整理型號為CX*FX05W;E自1040701生效)	組	衛署醫器輸字第020176號	泰爾茂	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
304	FHX03FX251TM	"泰爾茂"菲斯膜型人工心肺(人工心肺及動脈過濾器)	"Terumo" Capiiox FX	CX*FX15W;CX*FX15E;CX*FX25W;CX*FX25E	組	衛署醫器輸字第020176號	泰爾茂	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
305	FHX04A21E1H9	"華億"體外循環管組	"HYM" HEART LUNG PACK	32000199-01;32000199-03	SET	衛署醫器製字第001297號	華億	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
306	FHX04A2729H9	"華億"體外循環管組	"HYM" HEART LUNG PACK	32000199-07	SET	衛署醫器製字第001297號	華億	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
307	FHX04A2730H9	"華億"體外循環管組	"HYM" HEART LUNG PACK	32000199-09	SET	衛署醫器製字第001297號	華億	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
308	FHX04A31CPH9	"華億"體外循環管組	"HYM" HEART LUNG PACK	32000199-11	SET	衛署醫器製字第001297號	華億	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
309	FNP9166048AE	雅氏雷歐普代用腦膜	"AESCULAP" LYOPLANT	1066048	片	衛署醫器輸字第023264號	台灣柏朗	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
310	FPP0142006Y2	"亞太醫療"顱顏面骨板系統/迷你T型骨板4-7孔	"SYNTEC"Craniomaxillofacial Plate System/Mini T-Shape Plate 0.6，1.0mm	PT420131;PT420132;PT420231;PT420232;PT420233;PT420234;Mini-4205;Mini-4206;Mini-4207	個	衛部醫器製字第005059號	亞太醫療	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
311	FPP0142007Y2	"亞太醫療"顱顏面骨板系統/迷你雙T型骨板4-6孔	"SYNTEC"Craniomaxillofacial Plate System/Mini Double T-Shape Plate 1.0mm	PT420241;PT420242	個	衛部醫器製字第005059號	亞太醫療	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
312	FPP0142010Y2	"亞太醫療"顱顏面骨板系統/迷你眼眶用骨板6-8孔	"SYNTEC"Craniomaxillofacial Plate System/Mini Orbita Plate，Curvede 0.6，1.0mm	PT420140;PT420141;PT420258;PT420259	個	衛部醫器製字第005059號	亞太醫療	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
313	FPP0204449S1	"信迪思"髁頭重建系統(下顎髁頭固定器+固定骨板)	"SYNTHESE"CONDYLAR HEAD ADD-ON SYSTEM(CONDYLAR HEAD ADD-ON AND FIXATION PLATE)	04.449.000;04.449.010;04.449.020;04.449.030;04.449.040	SET	衛署醫器輸字第019753號	壯生	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
314	FPP060632NLE	"史賽克 雷賓格爾"下頷骨系統:迷你方型骨板 3x2 孔	"STRYKER LEIBINGER" UNIVERSAL MANDIBLE SYSTEM:MINI PLATE 3x2 HOLE	55-06320	EA	衛署醫器輸字第010537號	史賽克	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
315	FPP0615001Y2	"亞太醫療"顱顏面骨板系統/迷你方型骨板 2x2	"SYNTEC"Craniomaxillofacial Plate System/Mini Square Segment Plat 0.6;1.0mm	PT420150;PT420261;PT420155;PT420266	個	衛部醫器製字第005059號	亞太醫療	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
316	FPP0615002Y2	"亞太醫療"顱顏面骨板系統/迷你方型骨板(3x2)	"SYNTEC"Craniomaxillofacial Plate System/Mini Square Segment Plat 0.6;1.0mm	PT420151;PT420262;PT420156;PT420267	個	衛部醫器製字第005059號	亞太醫療	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
317	FPP0615003Y2	"亞太醫療" 顱顏面骨板系統/迷你方型骨板(4x2)	"SYNTEC"Craniomaxillofacial Plate System/Mini Square Segment Plat 0.6;1.0mm	PT420152;PT420263;PT420157;PT420268	個	衛部醫器製字第005059號	亞太醫療	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
318	FPP0615004Y2	"亞太醫療" 顱顏面骨板系統/迷你方型骨板(4x4)(4X6)	"SYNTEC"Craniomaxillofacial Plate System/Mini Square Segment Plat 0.6mm	PT420153;PT420154;PT420158;PT420159	個	衛部醫器製字第005059號	亞太醫療	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
319	FPP070633NLE	"史賽克 雷賓格爾"下頷骨系統:顯微方型骨板微骨板6x2孔	"STRYKER LEIBINGER" UNIVERSAL MANDIBLE SYSTEM:MICRO PLATE 6x2 HOLE	55-06233;(55-04233自1030101生效)	EA	衛署醫器輸字第010537號	史賽克	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
320	FPP0718059EJ	"歐特美"速固硬式固定系統:顯微方型骨板 2x3孔	"OSTEOMED"FAST-FLAP NEURO FIXATION SYSTEM:MICRO PLATE 2x3HOLE	218-0059	EA	衛署醫器輸字第017435號	歐強	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
321	FPP0755404Y2	"亞太醫療" 顱顏面骨板系統/微型L型骨板5-8孔(左/右)	"SYNTEC"Craniomaxillofacial Plate System/MICRO L-SHAPE PLATE 0.6MM(R/L)	055-42007;055-42008;055-42009;055-42010	個	衛部醫器製字第005059號	亞太醫療	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
322	FPP0755405Y2	"亞太醫療" 顱顏面骨板系統/微型T型骨板90度5-7孔	"SYNTEC"Craniomaxillofacial Plate System/Micro T-Shape Plate 0.6mm	055-42011;055-42012	個	衛部醫器製字第005059號	亞太醫療	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
323	FPP0755406Y2	"亞太醫療" 顱顏面骨板系統/微型雙T型骨板7-14孔	"SYNTEC"Craniomaxillofacial Plate System/Micro Double T-Shape Plate 0.6mm	055-42013;055-42014;055-42015	個	衛部醫器製字第005059號	亞太醫療	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
324	FPP0755410Y2	"亞太醫療" 顱顏面骨板系統/微型方型骨板(2x2)	"SYNTEC"Craniomaxillofacial Plate System/Micro Square Segments Plate 0.6mm	055-42021;055-42026	個	衛部醫器製字第005059號	亞太醫療	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
325	FPP0755411Y2	"亞太醫療" 顱顏面骨板系統/微型方型骨板(3x2)	"SYNTEC"Craniomaxillofacial Plate System/Micro Square Segments Plate 0.6mm	055-42022;055-42027	個	衛部醫器製字第005059號	亞太醫療	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
326	FPP0755412Y2	"亞太醫療"顱顏面骨板系統/微型方型骨板(4x2)	"SYNTEC"Craniomaxillofacial Plate System/Micro Square Segments Plate 0.6mm	055-42023;055-42028	個	衛部醫器製字第005059號	亞太醫療	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
327	FPP0755413Y2	"亞太醫療"顱顏面骨板系統/微型方型骨板(4x4)	"SYNTEC"Craniomaxillofacial Plate System/Micro Square Segments Plate 0.6mm	055-42024;055-42029	個	衛部醫器製字第005059號	亞太醫療	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
328	FPP0755414Y2	"亞太醫療"顱顏面骨板系統/微型方型骨板(6x4)	"SYNTEC"Craniomaxillofacial Plate System/Micro Square Segments Plate 0.6mm	055-42025;055-42030	個	衛部醫器製字第005059號	亞太醫療	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
329	FPS0104497S1	"信迪思"髁頭重建系統下顎固定螺釘	"SYNTHESE"CONDYLAR HEAD ADD-ON SYSTEM SET SCREW	04.497.000	SET	衛署醫器輸字第019753號	壯生	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
330	FPS0108415LE	"雷賓格爾"組合式顱顏頷骨植入系統:迷你骨釘	"LEIBINGER" KING COMBO CRANIOMAXILLOFACIAL IMPLANT SYSTEM:MINI SCREW	01-08415 (52-20114:5)	EA	衛署醫器輸字第009627號	史賽克	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
331	FSAE1GTBXX9M	"美安科技"氣管及支氣管支架	"M. I. Tech" HANAROSTENT Trachea/Bronchium Stent	NTS-10-030-050;NTS-10-080-050;NTS-12-030-050;NTS-12-080-050;NTS-14-030-050;NTS-14-080-050;NTS-16-030-050;NTS-16-080-050;NTS-10-030-090;NTS-10-080-090;NTS-12-030-090;NTS-12-080-090;NTS-14-030-090;NTS-14-080-090;NTS-16-030-090;NTS-16-080-090;NTS-18-030-050;NTS-18-050-050;(NTS-18;20;22-060;080-050;NTS-20;22-030:050-050)(自1070301生效);(NTS-18;20;22-030;040;050;060;070;080-090自1080501生效)	組	衛部醫器輸字第028661號	明達醫學	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
332	FSP62PT3H3QH	"豪爾亞"納德網塞補片	"Herniamesh" NeT Plug & Patch 6X11CM	PT3H3PS-P	組	衛部醫器輸字第028586號	沛宇	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
333	HEF01ARF40H9	"華億"體外循環管組:動脈過濾器	"HYM" HEART LUNG PACK:ARTERIAL FILTER	47-000092-00;46-000163-00;46-000246-01	個	衛署醫器製字第001297號	華億	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
334	HHM01SLVASG9	艾受芙抽吸導管	ISOLV Aspiration Catheter	5ISV14;6ISV14;7ISV14	組	衛部醫器輸字第030903號	連鎰	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
335	NAN1418275AG	"雅容"特殊針頭:導線導引針	"ARGON" SPECIALTY NEEDLE:AMC/4 ARTERIAL NEEDLE WITH FIXED WINGS	AG195352	EA	衛署醫器輸字第007022號	實密	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
336	NAN14GW118AG	"亞康恩"導引線導引針	"ARGON" GUIDEWIRE INTRODUCER NEEDLES	GW11802;GW11902;GW11802WW;GW11902W W;BGW11802;BGW11902	支	衛部醫器輸字第028238號	春菖	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
337	NBS070539E3N	"根本"顯影注射筒組套(200ML注射筒+60"螺旋管+填充管)	"NEMOTO" DISPOSABLE SYRINGE KIT	TM0539E	組	衛部醫器製字第004802號	太平洋	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
338	NBS07390033N	"根本"顯影注射筒	"NEMOTO" DISPOSABLE SYRINGE	TM0539003	支	衛部醫器製字第004308號	太平洋	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
339	NDN02L0CM1BA	"巴德"威力朗克高壓注射式注射套組	"Bard" PowerLoc Max Power-Injectable Infusion Set	(844460-01:03;05:07;09:11)(844460-13:15;17:19;21:23)	支	衛署醫器輸字第025144號	巴德	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
340	NDN041426SWV	"特福"無菌安全靜脈留置針	"Disposafe" LEADCARE Sterile I.V. Cannula with Safety Feature	14G;16G;17G;18G;20G;22G;24G;26G	支	衛部醫器輸字第030171號	勤達醫材	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
341	NES03ACN14AG	"亞康恩"愛士恩切片針	"ARGON" ACN BIOPSY NEEDLES	ACN1410MF;ACN1412MF;ACN1416MF;ACN1420MF;ACN1610MF;ACN1616MF;ACN1620MF;ACN1625MF;ACN1810MF;ACN1816MF;ACN1820MF;ACN1825MF;ACN1830MF;ACN2010MF;ACN2016MF;ACN2020MF	支	衛部醫器輸字第027638號	春菖	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
342	SCV010912LV7	"維達力克"鈦金屬血管夾(大)	"VITALITEC" NINE CLIP TITANIUM HEMOSTATIC CLIP SYSTEM	09120	EA	衛署醫器輸字第023272號	亞衛	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
343	SCV01FD360TX	"泰利芙斯"血管夾	"TELEFLEX MEDICAL" HEMOCLIP	523660	CLIP	衛署醫器輸字第008063號	泰利福	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
344	TKP0324612XM	"史達美克" 薇瓦射頻電極	"STARMED" VIVA RF ELECTRODE	15-(15;20;25;35)V05-30;15-(25;35)V15-40;17-(25;35)V15-40;17-35V05-30;18-15V05-30;18-15V15-40;15-(10;15;20;25;35)V05-30X;15-(10;15;20;25;35)V15-40X;17-(10;15;20;25;35)V05-30X;17-(15;20;25;35)V15-40X;18-(07;10;15)V05-30X;18-15V15-40X ; 15-(15;20;25;35)V05-30;15-(25;35)V15-40;17-(25;35)V15-40;17-35V05-30;18-15V05-30;18-15V15-40;15-(10;15;20;25;35)V05-30X;15-(10;15;20;25;35)V15-40X;17-(10;15;20;25;35)V05-30X;17-(15;20;25;35)V15-40X;18-(07;10;15)V05-30X;18-15V15-40X; 【15-(15;20)V15-40;17-(10;15;20;25)V05-30;17-(15;20)V15-40;15-(07;08;10;12;15;20;25;35)V05-30X_V2;15-(07;08;10;12;15;20;25;35)V15-40X_V2;16-(07;08;10;12;15;20;25;35)V05-30X_V2;16-(07;08;10;12;15;20;25;35)V15-40X_V2;17-(07;08;10;12;15;20;25;35)V05-30X_V2;17-(07;08;10;12;15;20;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;15;20;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;15;20;25;35)V15-40X_V2自1110501起生效】	組	衛署醫器輸字第024612號	利和醫療設備	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
345	TSS0100001LQ	"長庚" 血糖檢測系統: 血糖試紙	"CHANG GUNG" BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM: TEST STRIP	ODES3200	片	衛署醫器製字第003673號	長庚醫學科技	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
346	WBB0402050YX	"康力迪"彈性繃帶(未滅菌)-自粘型:5cm×450cm	"KANGLIDI" Elastic Bandage(Non-Sterile):5cm×450cm	EB-05450	卷	衛部醫器陸輸壹字第003253號	科云	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
347	WBB0404050YX	"康力迪"彈性繃帶(未滅菌)-自粘型:10cm×450cm	"KANGLIDI" Elastic Bandage(Non-Sterile):10cm×450cm	EB-10450	卷	衛部醫器陸輸壹字第003253號	科云	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
348	WBB0703035NJ	"必史恩"義肢及裝具用附件-石膏繃帶 3"×3YDS	"BSN" PROSTHETIC AND ORTHOTIC ACCESSORY-PLASTER BANDAGE	7373;7363	ROLL	衛署醫器輸壹字第003375號	旭昇	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
349	WBB0802040ZD	"杜京"石膏繃帶(未滅菌):玻璃纖維/2"×4Y	"DUK-IN" CAST PLASTER BANDAGE (Non-Sterile):FIBERGLASS CAST TAPE	TH-1302B	卷	衛署醫器輸壹字第002507號	銓順	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
350	WDD0800248SN	"史耐輝"柔膠愛力膚敷料(滅菌):泡棉敷料/10×10CM	"SMITH& NEPHEW" ALLEVYN GENTLE SOFT GEL ADHESIVE HYDROCELLULAR DRESSING:FOAM DRESSING 10CM×10CM	66800248	EA	衛署醫器輸壹字第009616號	史耐輝	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
351	WDD0800249SN	"史耐輝"柔膠愛力膚敷料(滅菌):泡棉敷料/10CM×20CM	"SMITH& NEPHEW" ALLEVYN GENTLE SOFT GEL ADHESIVE HYDROCELLULAR DRESSING:FOAM DRESSING 10CM×20CM	66800249	EA	衛署醫器輸壹字第009616號	史耐輝	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
352	WDD0800251SN	"史耐輝"柔膠愛力膚敷料(滅菌):泡棉敷料/20CM×20CM	"SMITH& NEPHEW" ALLEVYN GENTLE SOFT GEL ADHESIVE HYDROCELLULAR DRESSING:FOAM DRESSING 20CM×20CM	66800251	EA	衛署醫器輸壹字第009616號	史耐輝	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
353	WDD08020216L	珍舒敷 藻酸鈣手術傷口敷料(滅菌)	iDAHO Wound Dressing Alginate for Surgical Application (Sterile)2X2CM	i548580	片	衛部醫器製壹字第006951號	艾肯杜	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
354	WDD0803420CA	"康樂保"平而坦泡綿敷料(滅菌):親水性敷料/黏性12x12CM	"COLOPLAST" BIATAIN FOAM DRESSING(STERILE):HYDROCOLLOID DRESSING ADHESIVE 12x12CM	3420	EA	衛署醫器輸壹字第011937號	康樂保	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
355	WDD0803712F4	"康威"愛康膚-銀親水性纖維敷料:2x45CM	"ConvaTec" Aquacel Ag Dressing:2x45CM	403712	EA	衛署醫器輸字第020708號	康威特	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
356	WDD0803791F4	"康威"愛康膚銀燒傷親水性纖維敷料-含銀手套	"CONVATEC" AQUACEL AG BURN HYDROFIBER DRESSING	403791	個	衛部醫器輸字第027485號	康威特	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
357	WDD0803792F4	"康威"愛康膚銀燒傷親水性纖維敷料-含銀手套	"CONVATEC" AQUACEL AG BURN HYDROFIBER DRESSING	403792	個	衛部醫器輸字第027485號	康威特	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
358	WDD0803793F4	"康威"愛康膚銀燒傷親水性纖維敷料-含銀手套	"CONVATEC" AQUACEL AG BURN HYDROFIBER DRESSING	403793	個	衛部醫器輸字第027485號	康威特	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
359	WDD0803794F4	"康威"愛康膚銀燒傷親水性纖維敷料-含銀手套	"CONVATEC" AQUACEL AG BURN HYDROFIBER DRESSING	403794	個	衛部醫器輸字第027485號	康威特	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
360	WDD0803795F4	"康威"愛康膚銀燒傷親水性纖維敷料-含銀手套	"CONVATEC" AQUACEL AG BURN HYDROFIBER DRESSING	403795	個	衛部醫器輸字第027485號	康威特	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
361	WDD08050826L	珍舒敷 藻酸鈣手術傷口敷料(滅菌)	iDAHO Wound Dressing Alginate for Surgical Application (Sterile)5X8CM	i548581	片	衛部醫器製壹字第006951號	艾肯杜	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
362	WDD0810100YY	"康力得"藻酸鹽纖維傷口敷料(滅菌):10CMx10CM	"CORELEADER" ALGINATE FIBER WOUND DRESSING(STERILE):10CMx10CM	ADW101002	EA	衛署醫器製壹字第002776號	康力得	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
363	WDD08102046L	珍舒敷 藻酸鈣手術傷口敷料(滅菌)	iDAHO Wound Dressing Alginate for Surgical Application (Sterile)10X20CM	i548584	片	衛部醫器製壹字第006951號	艾肯杜	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01
364	WDD08110106Y	"H&H" 泡棉敷料(滅菌)	"H&H" Foam Dressing (Sterile) 10X10CM	FF1010	片	衛部醫器製壹字第007265號	中鎮	連續3年無醫令申報量,且有替代品項可供病人使用者,不列入健保給付。	112/04/01

項次	特材代碼	中文品名	英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	申請者簡稱	說明	健保刪除生效日期
365	WDD0815151YY	"康力得"親水性敷料(滅菌):15CM×15CM(薄)	"CORELEADER" HYDROCOLLOID DRESSING (STERILE):15CM×15CM (THIN)	HC150150	EA	衛署醫器製壹字第003139號	康力得	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
366	WDD0820674F4	"康威"愛康膚強化吸收親水性纖維敷料(滅菌):10×12cm	"CONVATEC" AQUACEL EXTRA HYDROFIBER DRESSING (STERILE):10×12CM	420674	EA	衛署醫器輸壹字第012602號	康威特	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
367	WDD08D0420SN	"史耐輝"愛爾膚纖維敷料(滅菌):親水性敷料/4CM×20CM	"SMITH & NEPHEW" DURAFIBER GELLING FIBER DRESSING:HYDROCOLLOID DRESSING 4CM×20CM	66800547	EA	衛署醫器輸壹字第009912號	史耐輝	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
368	WDD08PGX25BB	"柏朗"博坦舒傷口凝膠	"B. Braun" Prontosan Wound Gel X 250g	Prontosan Wound Gel X 250克/管	條	衛部醫器輸字第030833號	台灣柏朗	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
369	WDD08PGX50BB	"柏朗"博坦舒傷口凝膠	"B. Braun" Prontosan Wound Gel X 50g	Prontosan Wound Gel X 50克/管	條	衛部醫器輸字第030833號	台灣柏朗	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01
370	WDD08Y0463ZW	"舒膚貼"親水性纖維敷料(滅菌):2×45CM	"SAVDERM" AQUAFABRIC DRESSING (STERILE):HYDROCOLLOID DRESSING 2×45CM	WDY01004	EA	衛署醫器製壹字第004403號	亞東創新	連續3年無醫令申報量，且有替代品項可供病人使用者，不列入健保給付。	112/04/01

報告案 5

有關修訂健保給付特材「經導管置換肺動脈瓣膜套組」
給付規定(B102-9)案。

報告案第 5 案

案由：有關修訂健保給付特材「經導管置換肺動脈瓣膜套組」給付規定(B102-9)案。

說明：

- 一、健保自 110 年 12 月 1 日起收載「經導管置換肺動脈瓣膜套組」功能類別特材，訂有給付規定(B102-9)：
 - (一) 符合全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準診療項目 68057B「經導管肺動脈瓣膜置換術」(Transcatheter pulmonary valve implantation, TPVI)所訂之適應症、禁忌症、醫院條件及醫師資格等之相關規定。
 - (二) 須事前審查。
- 二、按 110 年 9 月份本會議之附帶決議，建議建置個案登錄系統。經函詢臺灣兒科醫學會、台灣兒童心臟學會、中華民國心臟學會、台灣胸腔及心臟血管外科學會及臨床專家有關個案登錄系統之意見，本署於 111 年 7 月建置完成(詳附件 1，頁次：報 5-2~報 5-3)。
- 三、查目前健保收載之「長效型心室輔助系統」(VAD)、「經導管置換瓣膜套組」(TAVI)、「無導線心律調節器」等高單價新醫療科技特材皆有建置個案登錄系統，且為蒐集 real world data 及監控本案特材給付後之臨床效益，以確保健保給付效益，維護病人安全，並使醫療院所落實完成追蹤資料登錄，爰循往例，增列「未如期登錄個案登錄系統，核刪本項申請之特材費用」，增修本案給付規定：
 - (一)修正第 2 點：完成個案登錄系統且須送事前審查核准。
 - (二)新增第 3 點：個案完成植入手術後需三十天內及第十二個月內於登錄系統登錄追蹤狀況，未如期登錄，核刪本項申請之特材費用。
- 四、爰此，本案依上述說明，修訂給付規定如後（詳附件 2，頁次：報 5-4），並依程序辦理暫予公告實施。

全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議

特材部分第53次（110年9月）會議紀錄

（時間：110年9月16日上午9時30分）

第1案：有關鑫德醫療器材科技股份有限公司及美敦力醫療產品股份有限公司建議將用於法洛氏症或右心雙出口之先天性或後天性肺動脈瓣狹窄之特材「經導管置換肺動脈瓣膜套組」等2項納入健保給付案。

一、說明：

（一）詳附錄會議資料討論案第1案之報告內容。

（二）本案給付規定係依全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準診療項目68057B「經導管肺動脈瓣膜置換術」(TPVI)所訂之適應症、禁忌症、醫院條件及醫師資格訂定，並需事前審查。

（三）與會專家及代表表示，診療項目68057B之禁忌症，建議增加嚴重三尖瓣閉鎖不全，惟針對「嚴重」之定義困難，另外診療項目68057B之醫師資格建議加入中華民國心臟學會參與認證資格，並比照心臟移植或是 TAVI，經過團隊會議，包括心臟外科醫師參與等。健保署說明，前述屬醫療服務給付項目及支付標準修正，本會議不進行討論。

二、決議：

（一）本案特材為診療項目68057B 經導管肺動脈瓣膜置換術(TPVI)必要使用之特材，對於肺動脈瓣膜不堪使用合併嚴重逆流時之治療具有臨床療效，且對於無法開刀的病人具臨床必要性，可取代傳統開刀手術，減少併發症及住院天數，對病患亦有較低的風險，建議以全額方式納入健保給付。

（二）功能類別：創新功能特材。

（三）支付點數：因國際價格中位數約901,531元/浮動點值(0.8823)之支付點數高於廠商建議價，爰採廠商建議價，以980,000點暫予支付。

（四）給付規定：如附件1。

（五）預估使用量：約30組。

三、附帶決議：

- (一) 針對全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準診療項目68057B「經導管肺動脈瓣膜置換術」(TPVI)之禁忌症及醫師資格等相關建議，屬醫療服務業務，依程序請健保署醫務管理組研處。
- (二) 建議建置個案登錄系統。

11009共擬會議紀錄

全民健康保險特殊材料給付規定修正對照表
給付規定分類碼：B102-9
(自 111 年 00 月 00 日生效)

修正給付規定	原給付規定	說明
<p>一、符合全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準診療項目 68057B「經導管肺動脈瓣膜置換術」(Transcatheter pulmonary valve implantation, TPVI)所訂之適應症、禁忌症、醫院條件及醫師資格等之相關規定。</p> <p>二、<u>完成個案登錄系統且須事前審查。</u></p> <p>三、<u>個案完成植入手術後需三十天內及第十二個月內於登錄系統登錄追蹤狀況，未如期登錄，核刪本項申請之特材費用。</u></p>	<p>一、符合全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準診療項目 68057B「經導管肺動脈瓣膜置換術」(Transcatheter pulmonary valve implantation, TPVI)所訂之適應症、禁忌症、醫院條件及醫師資格等之相關規定。</p> <p>二、須事前審查。</p>	<p>修正第二點及新增第三點。</p>

報告案 6

有關英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司建議將用於治療胸主動脈瘤之「“漫孚漢”多層血流調節主動脈支架系統」及治療周邊血管之「“漫孚漢”多層血流調節周邊支架系統」計 2 項納入健保給付案。

“漫孚漢”多層血流調節主動脈支架系統 “漫孚漢”多層血流調節周邊支架系統

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第60次(111年9月)會議
111年9月15日

提案摘要(1)

說明：有關英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司建議將用於治療胸主動脈瘤之「“漫孚漢”多層血流調節主動脈支架系統」及治療周邊血管之「“漫孚漢”多層血流調節周邊支架系統」計2項納入健保給付。

依據：按111年7月份特材專家諮詢會議結論辦理。

說明：

1. 本案特材為一款不透射線的自動擴張型管形植入物，主要係由鈷合金製成的多層織編線網組成。「“漫孚漢”多層血流調節主動脈支架系統」適用於主動脈瘤涉及至少一條血管分支、高手術風險及形態適合接受血管內修補的治療；「“漫孚漢”多層血流調節周邊支架系統」適用於周邊動脈瘤型態上適合接受血管內修補的治療。
2. 根據目前分析研究，使用MFM支架於短期和中期複雜主動脈病變雖有其療效，但缺乏長期追蹤結果，仍需要進一步研究其長期療效。

提案摘要(2)

3. 經111年7月份特殊材料專家諮詢會議討論，與會台灣血管外科學會、台灣胸腔及心臟血管外科學會代表及專家表示：
- 目前健保特材人工血管支架用於血管瘤處阻隔血流效果明確，但用於血管瘤侵犯分支血管處則會阻斷分支血管血流，必須合併使用其他技術以保存重要分支血管血流。
 - 本案特材用於血管瘤侵犯分支血管處雖較無阻斷分支血管血流之疑慮，但目前文獻報告病例數不多且追蹤時間短，臨床效益不明確。
 - 結論：與會專家一致建議，本案特材臨床效果不明確，且缺乏長期實證資料，不建議納入健保給付，依全民健保尚未納入給付特材管理作業要點辦理。

建議：建議暫不納入給付。

3

治療方式簡介

□ 血管內支架治療手術


- 📖 動脈瘤的成因是動脈血管肌肉層細胞退化造成管壁彈性疲乏，使得血管像氣球般向外鼓漲，病情嚴重時易導致血管撐破並造成患者腹內大出血。
- 📖 在局部或半身麻醉下，於患者兩側鼠蹊部劃開約三公分的小切口，藉由X光透視下，以經皮穿刺的方式將「血管支架」透過導管遞送系統植入血管內病灶位置，有效地將病變的血管瘤阻隔開來，達到治療的目的。

本案特材簡介(1)

□“漫孚漢”多層血流調節主動脈/周邊支架系統

📖 本案特材屬於一款不透射線的自動擴張型管形植入物。主要係由鈷合金製成的多層織編線網組成。此不透射線遞送系統主要係由一個引導導管(具備一個柔軟尖端的織編導管鞘)構成。透過一個Y型止血閥將管鞘連接至推進器上。旋緊時，可將管鞘固定於支架上。此固定裝置為預防多層血流調節器提早擴張的必要裝置。

📖 將本案特材預先裝載於其遞送系統內。可以經皮方式或裁短透過穿刺動脈(偏好透過股動脈)導入並在血管造影協助下從血管腔內往前推至想要的病灶位置處。

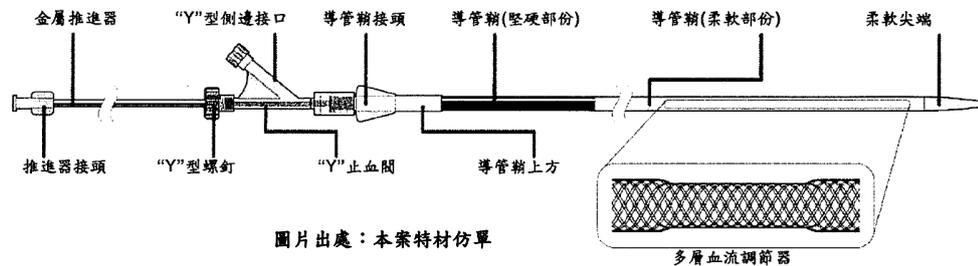

圖片出處：本案特材仿單

5

本案特材簡介(2)

□ 本案特材與健保已給付特材之比較

比較項目	本案特材		健保給付類似特材	
	“漫孚漢”多層血流調節主動脈支架系統	“漫孚漢”多層血流調節周邊支架系統	胸主動脈支架及輸送導引系統	周邊動脈血管支架及傳輸裝置(自膨式支架含人工血管，支架長25:149mm)
材質	不透射線的自動擴張型管形植入物，主要係由鈷合金製成的多層編織線網組成。		含有一個 ePTFE/FEP 移植物構成，外包鎳鈦諾合金絲支架支撐。	
建議價格/健保支付點數	650,000元	180,000元	302,073點	62,370點~76,050點
給付規定			A220-6 胸主動脈支架系統	A220-9 周邊血管支架(自膨式支架含人工血管)

廠商建議資料(1)

品項	廠商建議價格	廠商預估	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
“漫孚漢” 多層血流調節 主動脈支架系統	650,000元	新特材年度 使用人數	1人	3人	5人	10人	15人
		新特材年度 使用數量	1組	3組	5組	10組	15組
		新特材年度 費用預估	65萬元	195萬元	325萬元	650萬元	975萬元
“漫孚漢” 多層血流調節 周邊支架系統	180,000元	新特材年度 使用人數	5人	10人	15人	25人	50人
		新特材年度 使用數量	5組	10組	15組	25組	50組
		新特材年度 費用預估	90萬元	180萬元	270萬元	450萬元	900萬元

7

相關診療項目

診療項目代碼	中文項目名稱	英文項目名稱	支付點數
18027B	主動脈造影	Aortography(cineangiography)	4,830
68043B	A型急性主動脈剝離術	Surgery for A type aortic dissection	86,451
69024B	胸(腹)部動靜瘻管之切除移植及直接修補手術-升主動脈	Excision and graft bypass or direct repair A-V fistula of chest or abdomen	33,678
69026B	主動脈-肺動脈開窗之修補手術	Repair aorto-pulmonary window	28,201
69036B	胸(腹)部動靜瘻管之切除移植及直接修補手術-主動脈弓	Excision and graft bypass or direct repair A-V fistula of chest or abdomen	40,956
69037B	胸(腹)部動靜瘻管之切除移植及直接修補手術—降主動脈	Excision and graft bypass or direct repair A-V fistula of chest or abdomen	35,926

相關參考價格彙整

項次	品項	公立醫院及醫學中心採購價				自費醫材比價網				國際價格(換算台幣)		
		家數	中位數	平均數	最低價	家數	中位數	平均數	最低價	日本	韓國	澳洲
1	“漫孚漢”多層血流調節主動脈支架系統	0	--	--	--	0	--	--	--	--	346,933	--
2	“漫孚漢”多層血流調節周邊支架系統	0	--	--	--	0	--	--	--	--	--	--

9

特材基本資料(1)

特材名稱	“漫孚漢”多層血流調節主動脈支架系統 “MFM” Multilayer Flow Modulator Aortic Stent System		
許可證字號	衛署醫器輸字第034032號	發證日期	109/11/05
廠商名稱	英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司		
製造廠名稱	Cardiatis SA	製造國別	比利時
特材大類碼	管套類(C)	特材小類碼	氣球擴張導管(B)
使用科別	心臟外科。		
規格	支架直徑：25mm-45.5mm。		
材質	鈷合金。		
適應症	適用於主動脈瘤涉及至少一條血管分支、高手術風險、及形態適合接受血管內修補的患者治療，包括：(1)與使用遞送系統相容的適當髂/股動脈穿刺，(2)在動脈瘤近側與末端非動脈瘤之主動脈部分(頸)的血管腔直徑與仿單中定義的壓縮率相容。(3)非動脈瘤之主動脈部分(頸)近側與末端的定位區至少有20毫米。		
廠商建議價	650,000元。		

特材基本資料(2)

特材名稱	“漫孚漾”多層血流調節周邊支架系統 “MFM” Multilayer Flow Modulator Peripheral Stent System		
許可證字號	衛署醫器輸字第034038號	發證日期	110/02/22
廠商名稱	英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司		
製造廠名稱	Cardiatis SA	製造國別	比利時
特材大類碼	管套類(C)	特材小類碼	氣球擴張導管(B)
使用科別	心臟外科。		
規格	支架直徑：5mm-16mm。		
材質	鈷合金。		
適應症	適用於患者周邊動脈動脈瘤型態上適合接受血管內修補的血管內治療，包括：(1)與使用遞送系統相容的適當髂/股動脈穿刺，(2)與本產品直徑適當密合之健康動脈近側與末端部分(頸)與仿單中所定義的壓縮率相容。(3)非動脈瘤之動脈部分(頸)近側與末端的定位區至少有10毫米。		
廠商建議價	180,000元。		

11

111 年 7 月份特殊材料專家諮詢會議紀錄

(時間：111 年 7 月 28 日上午 9 時 30 分)

第 3 案：有關英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司建議將用於治療胸主動脈瘤之「“漫孚漢”多層血流調節主動脈支架系統」及治療周邊血管之「“漫孚漢”多層血流調節周邊支架系統」計 2 項納入健保給付案，提請討論。

說明：

(一) 本案特材用於治療主動脈瘤(涉及至少一條血管分支、高手術風險及型態適合接受血管內修補)，以及周邊動脈瘤(型態上適合接受血管內修補)。

(二) 目前健保已收載類似功能特材：

1. 「胸主動脈支架及輸送導引系統(使用 1 支)」：健保支付點數為 302,073 點。
2. 「周邊動脈血管支架及傳輸裝置(自膨式支架含人工血管，支架長 25：99mm 及 100：149mm)」：健保支付點數分別為 62,370 點及 76,050 點。

(三) 台灣血管外科學會、台灣胸腔及心臟血管外科學會與會代表及與會專家表示：

1. 目前健保特材人工血管支架用於血管瘤處阻隔血流效果明確，但用於血管瘤侵犯分支血管處則會阻斷分支血管血流，必須合併使用其他技術以保存重要分支血管血流。
2. 本案特材用於血管瘤侵犯分支血管處雖較無阻斷分支血管血流之疑慮，但目前文獻報告病例數不多且追蹤時間短，臨床效益不明確。

結論：與會專家一致建議，本案特材臨床效果不明確，且缺乏長期實證資料，不建議納入健保給付，依全民健保尚未納入給付特材管理作業要點辦理。