

全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第 34 次（107 年 9 月）會議議程

時間：107 年 9 月 20 日(星期四)上午 9 時 30 分

地點：衛生福利部中央健康保險署 18 樓禮堂

主席：林主席啟禎

壹、主席致詞

貳、請參閱並確認上次會議紀錄(藍本卷夾)

參、前次會議決定及結論辦理情形報告(無)

肆、報告事項：

第 1 案：全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告共 136 項:(1)新增既有功能類別特材品項 98 項/第 1-1~1-19 頁；項次 1~98。(2)新增既有功能類別特材自付差額品項 8 項/第 1-20~1-22；項次 99~106。(3)新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號 30 項/第 1-23~1-28 頁；項次 107~136。

第 2 案：全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之初核情形報告共 77 項:(1)醫療器材許可證註銷及刪除品項 68 項/第 2-1~2-10 頁；項次 1~68。(2)既有功能類別支付點數異動 9 項/第 2-11~2-14 頁；項次 69~77。

第 3 案：106 及 107 年起收載新功能類別特材申報情形報告案。

第 4 案：有關增修部分「長效型心室輔助系統」給付規定案。

第 5 案：有關增修部分「全民健康保險自付差額特材類別」之中文名稱案。

第 6 案：全民健保收載自付差額特材申報情形及其檢討。

伍、討論提案：

第 1 案：有關「台灣曲克股份有限公司」建議將用於急重症病童急救時之必要特材「"曲克"拋棄式骨內注射針」納入健保給付案，提請討論。

- 第 2 案：有關「巴德股份有限公司」建議將應用於股、髂及腎動脈之 PTA 治療特材「"巴德"康格斯特 40 經皮穿刺血管成形術導管」納入健保給付再提會案。
- 第 3 案：有關「中訊企業有限公司」建議將用於修復心臟二尖瓣閉鎖不全或狹窄之人工瓣膜環特材「"索倫"環狀成形術環」納入健保給付再提會案。
- 第 4 案：有關適用於頷、顱顏面外科重建手術之特材「客製化電腦輔助型顱顏骨固定系統 (TiMesh)」共 9 項自付差額品項納入全額給付。
- 第 5 案：有關元銘企業有限公司及嘉杏股份有限公司，再次提會將適用於心臟停止之低溫療法特材納入健保給付案。

報告案 1

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

共 136 項：(1)新增既有功能類別特材品項 98 項/第 1-1~1-19 頁；項次 1~98。(2)新增既有功能類別特材自付差額品項 8 項/第 1-20~1-22；項次 99~106。(3)新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號 30 項/第 1-23~1-28 頁；項次 107~136。

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共98項(項次1~項次98,詳頁次1-1~1-19)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商 簡稱	廠商建議 支付點數	初核 支付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
1	CBB03PCELLM4	"美敦力"派斯 飛克普拉斯周 邊血管治療導 管- L:120;150MM	"Medtronic" Pacif ic Plus PTA Catheter	PCE-(020;025;030;035;- 120;150-090;130;180);PCE- (040;050;060;070-120- 090;130;180)	支	衛部醫器輸字第 026927號	美敦力	10,660	10,660	依(下肢血管治療導管/導 管球囊長度12公分(含)以 上)同功能類別品項(如特 材代碼CBB03STSL1SB)之 支付點數暫予支付。	A220-5	月生效
2	CBB03PCESSM4	"美敦力"派斯 飛克普拉斯周 邊血管治療導 管-L:20;80MM	"Medtronic" Pacif ic Plus PTA Catheter	PCE-(020;025;030;035- 020;040;060;080- 090;130;180);(040;050;060; 070-020- 090);(040;050;060;070- 020;040;060;080-130;180)	支	衛部醫器輸字第 026927號	美敦力	8,103	8,103	依(下肢血管治療導管/導 管球囊長度12公分(不含) 以下)同功能類別品項(如 特材代碼CBB03STSL8SB) 之支付點數暫予支付。	A220-5	月生效
3	CBB03PCELLF2	"英泰克"派斯 飛克血管治療 導管(下肢血 管治療導 管)L:120MM;3 00MM	"INVATEC" PACIFIC XTREME PTA BALLOON CATHETER	PCF- 020;025;030;035;040;045;05 0-120;150-090;130;180;PCF- 040;050;060-200;250;300- 090;130;PCF- 055;060;065;070-120- 090;130;180;PCF-060-150- 090;130;PCF-070- 150;200;250-090;130	條	衛署醫器輸字第 019749號	美敦力	10,660	10,660	依(下肢血管治療導管/導 管球囊長度12公分(含)以 上)同功能類別品項(如特 材代碼CBB03STSL1SB)之 支付點數暫予支付。	A220-5	月生效
4	CBV02TFOXXBA	"巴德"楚英辦 膜成形術灌注 導管(主動脈 瓣氣球導管)	"Bard" True Flow Valvuloplasty Perfusion Catheter	TF0- 183511;203511;223512;24351 4;263516	條	衛部醫器輸字第 030817號	巴德	33,700	33,700	依(二尖瓣/及主動脈瓣雙 氣球擴張導管)同功能類 別品項(如特材代碼 CBV02PTVNXN5)之支付點 數暫予支付。	無	月生效
5	CDPN2A3601WU	"優樂"胸腔 引流瓶(滅 菌)	"EUROSETS" Chest drainage system (Sterile)	EU3601;EU3602	個	衛部醫器輸查字 第018751號	常鈺	2,002	2,002	依同功能類別品項(如特 材代碼CDPN2A6530U7)之 支付點數暫予支付。	A211-2	月生效
6	CEE01CL100U2	"愛西優"化 療藥和藥物準 備系統-化療 藥和接頭	"ICU" ChemoLock Drug Preparation System - BAG SPIKE ChemoLock CONNECTOR	011-CL-10	個	衛部醫器輸字第 029964號	佳事達	70	70	依(DRUG PREPARATION SYSTEM:IV BAG CONNECTOR化療藥物準備 系統組件-接頭(插入針)) 同功能類別品項(如特材 代碼CEE01CH100U2)之支 付點數暫予支付。	I302-1	月生效

一、新增既有功能類別特材品項共98項(項次1~項次98,詳頁次1-1-1-19)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核 支付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
7	CEE01CL303U2	“愛西優”化 療藥扣藥物準 備系統-輸液 管轉接頭注射 調節頭	“ICU” ChemoLock Drug Preparation System	011-CL3034	個	衛部醫器輸字第 029964號	佳事達	134	134	依(DRUG PREPARATION SYSTEM: BAG SPIKE ADAPTER W/TUBING化療 藥物準備系統組件-輸液 管)同功能類別品項(如特 材代碼CEE01CH334U2)之 支付點數暫予支付。	I302-1	月生效
8	CEE01CL318U2	“愛西優”化 療藥扣藥物準 備系統-輸液 管含無針密閉 接頭+輸液線 含SPIKE*1	“ICU” ChemoLock Drug Preparation System	011-CL3187	個	衛部醫器輸字第 029964號	佳事達	204	204	依(DRUG PREPARATION SYSTEM: W/1 SPIROS, BAG SPIKE, PLUG ADAPTER化療藥物準備系 統/1路輸液管含SPIROS接 頭*1+SPIKE+輸液線)同功 能類別品項(如特材代碼 CEE01CH318U2)之支付點 數暫予支付。	I302-1	月生效
9	CEE01CL325U2	“愛西優”化 療藥扣藥物準 備系統-4路輸 液管含無針密 閉接頭+輸液 線含SPIKE*1	“ICU” ChemoLock Drug Preparation System	011-CL3225	個	衛部醫器輸字第 029964號	佳事達	552	552	依(DRUG PREPARATION SYSTEM: W/4 SPIROS, BAG SPIKE, PLUG ADAPTER化療藥物準備系 統/4路輸液管含SPIROS接 頭*4+SPIKE+輸液線)同功 能類別品項(如特材代碼 CEE01CH225U2)之支付點 數暫予支付。	I302-1	月生效
10	CEE01CL326U2	“愛西優”化 療藥扣藥物準 備系統-3路輸 液管含無針密 閉接頭+輸液 線含SPIKE*1	“ICU” ChemoLock Drug Preparation System	011-CL3226	個	衛部醫器輸字第 029964號	佳事達	431	431	依(DRUG PREPARATION SYSTEM: W/3 SPIROS, BAG SPIKE, PLUG ADAPTER化療藥物準備系 統/3路輸液管含SPIROS接 頭*3+SPIKE+輸液線)同功 能類別品項(如特材代碼 CEE01CH226U2)之支付點 數暫予支付。	I302-1	月生效

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共98項(項次1~項次98,詳頁次1-1-1-19)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核 支付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
11	CEE01CL327U2	“愛西優”化療藥物準備系統-2路輸液管含無針密閉接頭+輸液線含SPIKE*1	“ICU” ChemoLock Drug Preparation System	011-CL3227	個	衛部醫器輸字第029964號	佳事達	311	311	依(DRUG PREPARATION SYSTEM:W/2 SPIROS, BAG SPIKE, PLUG ADAPTER化療藥物準備系統/2路輸液管含SPIROS接頭*2+SPIKE+輸液線)同功能類別品項(如特材代碼CEE01CH227U2)之支付點數暫予支付。	I302-1	月生效
12	CEE01CL620U2	“愛西優”化療藥物準備系統-化療藥物瓶轉接頭	“ICU” ChemoLock Drug Preparation System-ChemoLock Vial Spike, 13mm	011-CL-62	個	衛部醫器輸字第029964號	佳事達	70	70	依(DRUG PREPARATION SYSTEM:IV BAG CONNECTOR化療藥物準備系統組件-接頭(插入針))同功能類別品項(如特材代碼CEE01NVC23Q4)之支付點數暫予支付。	I302-1	月生效
13	CEE01NVC12Q4	“尼得立斯”藥物準備系統輸液接頭--一對一安全輸液管	“Needleless” Drug Preparation System and Needleless Injection Access Device- One Way Safety Infusion Set	IVC012	個	衛部醫器製字第005723號	尼得立斯	204	204	依(DRUG PREPARATION SYSTEM:W/1 SPIROS, BAG SPIKE, PLUG ADAPTER化療藥物準備系統/1路輸液管含SPIROS接頭*1+SPIKE+輸液線)同功能類別品項(如特材代碼CEE01CH187U2)之支付點數暫予支付。	I302-1	月生效
14	CEE01NVC13Q4	“尼得立斯”藥物準備系統輸液接頭--一對二安全輸液管	“Needleless” Drug Preparation System and Needleless Injection Access Device- Two Ways Safety Infusion Set	IVC013	個	衛部醫器製字第005723號	尼得立斯	311	311	依(DRUG PREPARATION SYSTEM:W/2 SPIROS, BAG SPIKE, PLUG ADAPTER化療藥物準備系統/2路輸液管含SPIROS接頭*2+SPIKE+輸液線)同功能類別品項(如特材代碼CEE01CH227U2)之支付點數暫予支付。	I302-1	月生效

一、新增既有功能類別特材品項共98項(項次1~項次98,詳頁次1-1-1-19)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核 支付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
15	CEE01NVC14Q4	“尼得立斯” 藥物準備系統 輸液接頭-一 對三安全輸液 管	“Needleless” Drug Preparation System and Needleless Injection Access Device- Three Ways Safety Infusion Set	IVC014	個	衛部醫器製字第 005723號	尼得立 斯	431	431	依(DRUG PREPARATION SYSTEM:W/3 SPIROS, BAG SPIKE, PLUG ADAPTER化療藥物準備系 統/3路輸液管含SPIROS接 頭*3+SPIKE+輸液線)同功 能類別品項(如特材代碼 CEE01CH226U2)之支付點 數暫予支付。	I302-1	月生效
16	CEE01NVC24Q4	“尼得立斯” 藥物準備系統 輸液接頭-取 藥針(氣孔)	“Needleless” Drug Preparation System and Needleless Injection Access Device-Vial Access Device (vent)	IVC206	個	衛部醫器製字第 005723號	尼得立 斯	70	70	依(DRUG PREPARATION SYSTEM:IV BAG ACCESS SPIKE CHECK VALVE化 療藥物準備系統組件-插 入針(藥瓶用)含檢査閥) 同功能類別品項(如特材 代碼CEE01NET20Q4)之支 付點數暫予支付。	I302-1	月生效
17	CEE01S2000BD	BD無針輸注閥 組及配件-無 針輸注閥	BD SmartSite Needle Free Valve Extension Sets and Components- needle free valve	2000E;2202E;2205E;20558E	個	衛署醫器輸字第 019326號	必帝	38	38	依(無針式接頭/不含 DEHP+與脂質相容)同功能 類別品項(如特材代碼 CEE01Q5100BD)之支付點 數暫予支付。	I301-3	月生效
18	CEE01S2019BD	BD無針輸注閥 組及配件-無 針輸注閥+多 路延長管	BD SmartSite Needle Free Valve Extension Sets and Components- needle free valve and multiple way extension sets	20019E;20038E;20061E;20062E	個	衛署醫器輸字第 019326號	必帝	82.3	82.3	依(無針式接頭(2-4路)+ 延長管/不含DEHP+與脂質 相容)同功能類別品項(如 特材代碼CEE01C3922U2) 之支付點數暫予支付。	I301-3	月生效

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共98項(項次1~項次98,詳頁次1-1-1-19)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核 支付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
19	CEE01S2028BD	BD無針輸注閥 組及配件-無 針輸注閥+延 長管(含DEHP)	BD SmartSite Needle Free Valve Extension Sets and Components- needle free valve and extension sets(with DEHP)	20028E;20519E;30202E	個	衛署醫器輸字第 019326號	必希	33.7	33.7	依(無針式接頭+延長管 /EA)同功能類別品項(如 特材代碼CEE01Q5102BD) 之支付點數暫予支付。	I301-3	月生效
20	CEE01S2039BD	BD無針輸注閥 組及配件-無 針輸注閥+T型 延長管	BD SmartSite Needle Free Valve Extension Sets and Components- needle free valve and extension sets	20039E;20035E;20041E;20043 E;20049E;20051E;20053E	個	衛署醫器輸字第 019326號	必希	38	38	依(無針式接頭+延長管 (含T型V型)/不含DEHP+與 脂質相容)同功能類別品 項(如特材代碼 CEE01Q5101BD)之支付點 數暫予支付。	I301-3	月生效
21	CHC01CP06A6R	恩多冠冠狀動 脈口灌注導管 (氣球狀)	OSTIAL PERFUSION CANNULA(Balloon Tip)	OC06A;OC07A	支	衛部醫器輸字 030808 號	連鑑	895	895	依同功能類別品項(特材 代碼CHC01CP212R5)之支 付點數暫予支付。	無	月生效
22	CHC01CP2226R	恩多冠冠狀動 脈口灌注導管 (籃狀)	OSTIAL PERFUSION CANNULA(BASKET TIP)	OC1045;OC1245;OC1445;OC109 0;OC1290;OC1490	EA	衛部醫器輸字 030808 號	連鑑	611	611	依同功能類別品項(特材 代碼CHC0130010DL)之支 付點數暫予支付	無	月生效
23	CHR01ARC016R	恩多冠主動脈 根部導管(不 附排氣線)	AndoCor Aortic Root Cannulae(w/o Vent Line)	ARC07, ARC04, ARC01, ARC07V, ARC04V, ARC01V, ARC14	支	衛部醫器輸字第 030819號	連鑑	410	410	依同功能類別品項(特材 代碼CHR01AR112R5)之支 付點數暫予支付	無	月生效
24	CHR01ARC026R	恩多冠主動脈 根部導管(附 排氣線)	AndoCor Aortic Root Cannulae(with Vent Line)	ARC08, ARC05, ARC02, ARC08V, ARC05V, ARC02V , ARC10	EA	衛部醫器輸字第 030819號	連鑑	616	616	01-依同功能類別品項(特 材代碼CHR01AR012ED)之 支付點數暫予支付	無	月生效
25	CHT05HSATC3Y	"米拉"血氧感 知器	"MERA" SATURATION CELL	HSAT-1C-1/2S;HSAT-1C- 3/8S;HSAT-1C-1/4S	個	衛部醫器輸字第 030882號	百利明	914	914	依同功能類別品項(特材 代碼CHT0569120TH)之支 付點數暫予支付	B201-1	月生效

一、新增既有功能類別特材品項共98項(項次1~項次98,詳頁次1-1-19)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核 支付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
26	CLS0514273HR	"赫士睿"浦朗 輸液套 (BURETTE/卡 棒式附無針式 接頭3個;含 Air trap)	"HOSPIRA" PLUM SET	14273	組	衛部醫器輸字第 030646號	艾希優	287	287	依同功能類別品項(特材 代碼CLS0511948HR)之支 付點數暫予支付	E301-4	月生效
27	CLS0514687HR	"赫士睿"浦朗 輸液套(卡棒 式附無針式接 頭2個;含AIR TRAP)	"HOSPIRA" PLUM SET	14687	組	衛部醫器輸字第 030646號	艾希優	238	238	依同功能類別品項(特材 代碼CLS0512030HR)之支 付點數暫予支付	E301-4	月生效
28	CMV0101639CM	柯特曼"安德 普"二代血管重 建裝置及傳導 系統	"Codman" ENTERPRISE 2 Vascular Reconstruction Device and Delivery System	ENC401612;ENC402312;ENC403 012;ENC403912;ENC401600;EN C402300;ENC403000;ENC40390 0	SET	衛部醫器輸字第 031060號	壯生	94,000	94,000	依同功能類別品項(特材 代碼CMV0101437CM)之支 付點數暫予支付	I203-7	月生效
29	CMV01FRED3MS	"麥新"孚瑞德 血液流向重定 腔內系統	"MicroVent" FRED, Flow Re- Direction Endoluminal System	(FRED- 3507;3511;3516;3524;3536)(FRED- 4007;4012;4017;4026;4038)(FRED- 4508;4513;4518;4528;4539)(FRED- 5009;5014;5019;5029)(FRED- 5514;5526)	組	衛部醫器輸字第 031043號	世新	363,553	363,553	依同功能類別品項(特材 代碼CMV01PED25V9)之支 付點數暫予支付	I203-15	月生效
30	CRT0254025VK	"旭邦"柔得 多幼兒型氣切 管-無氣囊	"Vitaltec" Rota-Trach Pediatric Tracheostomy Tube-Uncuff	5400250;5400300;5400350;54 00400;5400450;5400500;5400 550	個	衛部醫器輸字第 004535號	旭邦	325	325	依(氣切套管(單管,無氣 囊))同功能類別品項(如 特材代碼CRT01U0025ZG) 之支付點數暫予支付。	無	月生效
31	CVA01DXTRM4	"美敦力"德 克斯提診斷導 管	"Medtronic" DxTerity Diagnostic Catheter	請參考圖檔	個	衛部醫器輸字第 030815號	美敦力	543	543	依(房室,心臟血管及周邊 血管攝影導管/ ANGIOGRAPHIC CATHETER ANY CURVE)同功能類別品 項(如特材代碼 CVA016A00NM4)之支付點 數暫予支付。	無	月生效

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共98項(項次1~項次98,詳頁次1-1-1-19)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商 簡稱	廠商建議 支付點數	初核 支付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
32	CXE01REGU25D	"微創電生理" 診斷導管-2極	"MicroPort" EasyF inder Diagnostic Catheter	EPD- 5C;5J;6C;6J;5A;6A;5D;6D;5F ;6F-G010	條	衛部醫器陸輸字 第000900號	利和	5,905	5,905	依(電極導管/2極/彎度固 定或特殊管內徑設計)同 功能類別品項(如特材代 碼CXE0107150BA)之支付 點數暫予支付。	無	月生效
33	CXE01REGU45D	"微創電生理" 診斷導管(4:8 極)	"MicroPort" EasyF inder Diagnostic Catheter	詳圖檔	條	衛部醫器陸輸字 第000900號	利和	6,658	6,658	依(電極導管/4-5極極/彎 度固定)同功能類別品項 (如特材代碼 CXE0100624BA)之支付點 數暫予支付。	無	月生效
34	CXE01REGU95D	"微創電生理" 診斷導管-10 極	"MicroPort" EasyF inder Diagnostic Catheter	EPD-5;6-P-E;C-282;EPD-6D- E;C-282	條	衛部醫器陸輸字 第000900號	利和	9,006	9,006	依(電極導管/10極/彎度 固定或特殊管內徑設計) 同功能類別品項(如特材 代碼CXE01EPF10JV)之支 付點數暫予支付。	無	月生效
35	CXE02CSBD0WE	"百歐森偉伯 斯特"偉伯司 特自動辨識雙 向可彎式冠狀 靜脈竇電生理 導管-10極	"Biosense Webster" Webster CS Catheter with EZ Steer Technology and Auto ID Technology	BD710-DF;FJ-282CT	條	衛署醫器輸字第 023773號	壯生	13,339	13,339	依(可控式電極導管/10極 /彎度可轉向)同功能類別 品項(如特材代碼 CXE02D1000CV)之支付點 數暫予支付。	無	月生效
36	CXE02CURV45D	"微創電生理" 診斷導管-4極 (可調式)	"MicroPort" EasyF inder Diagnostic Catheter	EPD6DH-252;005;010	條	衛部醫器陸輸字 第000900號	利和	11,666	11,666	依(可控式電極導管/4極/ 彎度可轉向)同功能類別 品項(如特材代碼 CXE02QP854VB)之支付點 數暫予支付。	無	月生效
37	CXE02CURV95D	"微創電生理" 診斷導管-10 極(可調式)	"MicroPort" EasyF inder Diagnostic Catheter	EPD6DH282	條	衛部醫器陸輸字 第000900號	利和	13,339	13,339	依(可控式電極導管/10極 /彎度可轉向)同功能類別 品項(如特材代碼 CXE0210MCSJV)之支付點 數暫予支付。	無	月生效

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共98項(項次1~項次98,詳頁次1-1-1-19)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核 支付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
38	FBEF6TLHEXT	"歐式"楚拉海 思外固定裝置 系統-六角可 調式外固定器 組(基本組 件:Ring*2;St rut*6;Pin*2- 3;Wire*2)	"Orthofix" TL- HEX External Fixation System	【Ring:56-20- 320;200;000;020;040;060;99 -56-20-080;220;56-21- 320;200;400;420;440;460;99- 56-21-480;220;240;340;99- 56-22-000;020;040;060】; 【Strut:50-10- 100;200;300;400】; 【Wire:54-121-5;6;8013- 1;2】;【Pin:54-112- 30;40;50】	組	衛部醫器輸字第 029910號	昌偉	272,170	272,170	依(小兒肢體畸形外固定 架/組)同功能類別品項 (如特材代碼 FBEF624734SN)之支付點 數暫予支付。	D203-2	月生效
39	FBN05728STIP	愛派司亞洲脛 骨髓內釘系統 組:鈦合金鎖 定螺釘	APS Tibia Nail System:TITANIUM ALLOY LOCKING SCREW	(7700-9740- 18;20;22;24;26;28;30;32;34; 36;38;40;42;44;46;48;50;5 2;54;56;58;60;62;64;66;68; 70;72;74;76;78;80)(7700- 9750- 26;28;30;32;34;36;38;40;42 ;44;46;48;50;52;54;56;58;6 0;62;64;66;68;70;72;74;76; 78;80;85;90;95;100)(7700- 9650- 30;35;40;45;50;55;60;65;70 ;75;80;85;90)	支	衛部醫器製字第 005728號	愛派司	1,458	970	依(Titanium Interlocking Screw)同 功能類別品項(如特材代 碼FBN04403STY2)之支付 點數暫予支付。	D102-1	月生效
40	FBS09D22306Q	"歐尼克"創傷 骨釘骨板系 統-埋頭中空 加壓骨釘 (2.2/3.0MM)	"OSTEONIC"Quantu m Trauma Plate & Screw System	D1D. -221;222-0-9-0;D1- D. E. -22300;D1E. -222;223- 2;4;6;8-0;D1E. 22400;D2D. - 301;302-0-9-0;D2-D. E. - 303;304;305-00;D2-D. E. - 303-2;4;6;8-0;D2-D. E. - 30450;D2E. 301-6;9- 0;D2E. 302-0-9-0	支	衛部醫器輸字第 030888號	安騰	12,000	12,000	依(埋頭中空加壓骨釘- 4.5MM(含)以下)同功能類 別品項(如特材代碼 FBS0908280JP)之支付點 數暫予支付。	D103-1	月生效
41	FBSF1BAR12L2	"阿伐泰克"脊 椎連接系統: 二節 (SX4+RX2)	"Alphatec" ISOBAR TTL Vertebral Connection Systems	由以下特材代碼組 合:FBSF2BAR2SL2;FBSF4BAR4S L2	組	衛署醫器輸字第 020555號	科舉	23,358	23,358	依(TITANIUM SPINAL SYSTEM 二節 (SCREWx4+RODY2))同功能 類別品項(如特材代碼 FBSF1ASPL1AQ)之支付點 數暫予支付。	D112-1	月生效

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共98項(項次1~項次98,詳頁次1-1~1-19)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核 支付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
42	FBSF1BAR13L2	"阿伐泰克"脊椎連接系統: 三節 (SX6+RX2)	"Alphatec" ISOBAR TTL Vertebral Connection Systems	由以下特材代碼組 合:FBSF2BAR2SL2;FBSF4BAR4S L2	組	衛署醫器輸字第 020555號	科舉	34, 118	34, 118	依(TITANIUM SPINAL SYSTEM 三節 (SCREW+RODX2))同功能 類別品項(如特材代碼 FBSF1ASY02AQ)之支付點 數暫予支付。	D112-1	月生效
43	FBSF2BAR2LL2	"阿伐泰克"脊椎連接系統: 固定桿長節	"Alphatec" ISOBAR TTL Vertebral Connection Systems:ROD	12TC55-110;12TC55- 130;12TC55-230;12TC55-400	支	衛署醫器輸字第 020555號	科舉	2, 662	2, 662	依(TITANIUM SPINAL ROD(長節))同功能類別品 項(如特材代碼 FBSF2ASLR2AQ)之支付點 數暫予支付。	D112-1	月生效
44	FBSF2BAR2SL2	"阿伐泰克"脊椎連接系統: 固定桿(短節)	"Alphatec" ISOBAR TTL Vertebral Connection Systems:ROD45- 95MM	12TC55-045;12TC55- 055;12TC55-085;12TC55- 075;12TC55-085;12TC55-095	支	衛署醫器輸字第 020555號	科舉	919	919	依(TITANIUM SPINAL ROD OR PLATE(短節))同功能 類別品項(如特材代碼 FBSF2ASYRIAQ)之支付點 數暫予支付。	D112-1	月生效
45	FBSF4BAR4SL2	"阿伐泰克"脊椎連接系統: 固定螺釘	"Alphatec" ISOBAR TTL Vertebral Connection Systems:SCREW	12VTLP45-25;12VTLP45- 35;12VTLP55-30;12VTLP55- 50;12VTLP62-35;12VTLP62- 55;12VTLP70-35;12VTLP70-55	支	衛署醫器輸字第 020555號	科舉	5, 380	5, 380	依(TITANIUM SPINAL SCREW)同功能類別品項 (如特材代碼 FBSF4ASY10AQ)之支付點 數暫予支付。	D112-1	月生效
46	FBSFAFC595RK	"瑞寶德"柯美特 特壓椎椎間融合器(側開型 ，每節椎體置放1個)	ReBorn Essence Comet Lumbar Interbody Fusion Cage	(595-07;18- 268;288;308;328)	類	衛署醫器輸字第 005465號	實德生技	41, 355	41, 355	依(TLIF PEEK SYSTEM (旁椎側開型,每節椎體置 放一個))同功能類別品項 (如特材代碼 FBSFA0001NSI)之支付點 數暫予支付。	D112-4	月生效
47	FBSFAPCEVL2	"阿伐泰克"頸椎融合器-椎 體護架+頸椎 骨板一體成型 (含PEEK CAGE 1支+TITANIUM PLATE 1支 +SCREW 2支)	"Alphatec" PCB EVOLUTION CERVICAL PLATE CAGE	(11PCBH45;11PCBH55;11PCBH6 5;11PCBH75;11PCBH85)+(11VC 40-12;11VC40-20;11VC45- 12R;11VC45-14R;11VC45- 16R;11VC45-18R)	組	衛署醫器輸字第 020930號	科舉	40, 594	40, 594	依(頸椎椎間植入物-頸椎 護架+頸椎骨板一體成型 (由PEEK CAGE、PLATE或 SCREW組成))同功能類別 品項(如特材代碼 FBSFAFP421M4)之支付點 數暫予支付。	D112-9	月生效

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共98項(項次1~項次98,詳頁次1-1-1-19)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核 支付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
48	FBSFAPCBSHL2	"阿伐泰克"頸椎融合器(短型)-椎體護架+頸椎骨板一體成型(含PEEK CAGE 1支+TITANIUM PLATE 1支+SCREW 2支)	"Alphatec" PCB EVOLUTION CERVICAL PLATE CAGE	(11PCBH45C;11PCBH55C;11PCBH65C;11PCBH75C;11PCBH85C)+(11VC40-12;14;16;18;20;11VC45-12R;14R;16R;18R)	組	衛署醫器輸字第020930號+022995號	科舉	40, 594	40, 594	依(頸椎椎間植入物-頸椎護架+頸椎骨板一體成型(由PEEK CAGE、PLATE或SCREW組成))同功能類別品項(如特材代碼FBSFA21002XP)之支付點數暫予支付。	D112-9	月生效
49	FBSFASAMRVL2	"阿伐泰克"莎美莉前路頸椎融合器	"Alphatec" ANTERIOR CAGE SAMARVUS(PEEK)	11CC2A-15-5;10;45-S;11CC2AC17-5;6;45S;5S;6S;11CC2A17-5;10;11CC2A17-5;10;45-S;11CC2A20-5;10;11CC2A20-5;10;45-S;11CC2AC17-7;10-S	支	衛署醫器輸字第022419號	科舉	19, 670	19, 670	依(CERVICAL PEEK CAGE 頸椎間體護架)同功能類別品項(如特材代碼FFBSFA6742SS9)之支付點數暫予支付。	D112-4	月生效
50	FBSFCZEV02M4	"美敦力"傑芙前側頸椎骨板系統-(二節)	"Medtronic" ZEVO Anterior Cervical Plate System-(PX1+SX4)	(77-100-13;15;77-135;140;235;240-13;15;17)+(300-10-15;17;19;21;23;25;27;29;30-20-27;29;31;33;35;37;39;41;43;45;48;51;300-30-43;45;48;51;53;55;57;59;61;63;65;68;71;300-40-65;67;69;71;73;75;78;81;83;86;89;300-50-77;79;81;85;90;95;300-51-00;05;08)	組	衛部醫器輸字第030357號+030358號	美敦力	18, 623	18, 623	依(TITANIUM CERVICAL IMPLANT(二節)(SCREW+ROD×2或PLATE×1))同功能類別品項(如特材代碼FFBSFC2LEVEM4)之支付點數暫予支付。	D112-3	月生效

一、新增既有功能類別特材品項共98項(項次1~項次98,詳頁次1-1~1-19)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核 支付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
51	FBSFCZEVO3M4	"美敦力"傑美 前側頸椎骨板 系統(三節)	"Medtronic" ZEVO Anterior Cervical Plate System-(PX1+SX6)	(77-100-13;15;77- 135;140;235;240- 13;15;17)+(300-10- 15;17;19;21;23;25;27;29;30 0-20- 27;29;31;33;35;37;39;41;43 ;45;48;51;300-30- 43;45;48;51;53;55;57;59;61 ;63;65;68;71;300-40- 65;67;69;71;73;75;78;81;83 ;86;89;300-50- 77;79;81;85;90;95;300-51- 00;05;08)	組	衛部醫器輸字第 030357號+030358 號	美敦力	20,591	20,591	依(TITANIUM CERVICAL SYSTEM(三 節)(SCREW6+ROD2或 PLATEX1))同功能類別品 項(如特材代碼 FBSFC3LEVM4)之支付點 數暫予支付。	D112-3	月生效
52	FBSFCZEVO5M4	"美敦力"傑美 前側頸椎骨板 系統-骨釘	"Medtronic" ZEVO Anterior Cervical Plate System-screw	77-100;135;140;235;240- 13;15;77-135;140;235;240- 17	支	衛部醫器輸字第 030357號	美敦力	984	984	依(TITANIUM ANTERIOR CERVICAL SCREW)同功能 類別品項(如特材代碼 FBSFC312XXM4)之支付點 數暫予支付。	D112-3	月生效
53	FHP01EN6SRBK	"百多力"艾尼 傳六磁振造影 植入式心律調 節器-單腔	"BIOTRONIK" Enitr a 6 Implantabl Cardiac Pacemakers with a conditional intended use in a MRI environment(SR)	Enitra 6 SR	個	衛部醫器輸字第 030908號	百多力	81,477	81,477	依(單腔心律調節器 /SSIR(含VVIR,AAIR),有 Auto-capture及核磁共振 相容功能)同功能類別品 項(如特材代碼 FHP01ELUSRBK)之支付點 數暫予支付。	B101-1	月生效
54	FHP01EN6STBK	"百多力"艾尼 傳六磁振造影 植入式心律調 節器-單腔	"BIOTRONIK" Enitr a 6 Implantabl Cardiac Pacemakers with a conditional intended use in a MRI environment(SR- T)	Enitra 6 SR-T	個	衛部醫器輸字第 030908號	百多力	81,477	81,477	依(單腔心律調節器 /SSIR(含VVIR,AAIR),有 Auto-capture及核磁共振 相容功能)同功能類別品 項(如特材代碼 FHP01ENTSRBK)之支付點 數暫予支付。	B101-1	月生效

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共98項(項次1~項次98, 詳頁次1-1-1-19)

項次	特材代碼	特材中文名	特材英文名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核 支付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
55	FHPFM4798M4	"美敦力"艾坦史塔比利磁振造影電極導線-四極左心室導線(具MRI相容)	"Medtronic" Attain Stability MRI SureScan Lead	4798	條	衛部醫器輸字第030794號	美敦力	20,313	20,313	依(四極左心室導線配合心房同步雙心室節律器或具MRI相容功能使用)同功能類別品項(如特材代碼FHPFM4798M4)之支付點數暫予支付。	B103-2	月生效
56	FPP0109222WR	"拜而美"顱顏頷骨固定系統-2.0系統/厚1.0mm彎曲骨板4孔	"Biomet Microfixation" Midface Plating System-2.0 SYSTEM/T 1.0 mm 4 HOLE CURVED PLATE	01-922-2;4	個	衛部醫器輸字第030012號	德芮達	1,416	1,416	依(MINI ORBITAL(CURVED) PLATE 4:12HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP0105188LE)之支付點數暫予支付。	D201-1	月生效
57	FPP01S2284WR	"拜而美"顱顏頷面骨重建系統-直型骨板4孔/厚1.0mm	"Biomet Microfixation" TraumaOne Plating System-4 Hole Straight Plate/T1.0mm	SP-2-284;375;376	個	衛部醫器輸字第030316號	德芮達	910	910	依(MINI PLATE 2:5 HOLE STR)同功能類別品項(如特材代碼FPP011067NLE)之支付點數暫予支付。	D201-1	月生效
58	FPP01S2465WR	"拜而美"顱顏頷面骨重建系統-Y型骨板6孔/厚1.6mm	"Biomet Microfixation" TraumaOne Plating System-Y Plate 6 Hole/T 1.6mm	SP-2465	個	衛部醫器輸字第030316號	德芮達	1,720	1,720	依(MINI Y-PLATE 4:13HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP0142008Y2)之支付點數暫予支付。	D201-1	月生效
59	FPP0241012WR	"拜而美"顱顏頷面骨重建系統-2.0系統/厚2.0mm直型骨板12孔	"Biomet Microfixation" TraumaOne Plating System-2.0 SYSTEM/T 2.0mm 12 HOLE STRAIGHT PLATE	44-1012	個	衛部醫器輸字第030316號	德芮達	4,179	4,179	依(MRS RECONSTRUCTION、COMPRESSION PLATE 11:24HOLE STR)同功能類別品項(如特材代碼FPP027171NSI)之支付點數暫予支付。	D201-1	月生效

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共98項(項次1~項次98,詳頁次1-1-1-19)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核 支付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
60	FPP0309282WR	"拜而美"顏頰 領骨固定系 統-2.0系統/ 厚1.0mm直型 加壓骨板4孔	"Biomet Microfixation" Midface Plating System-2.0 SYSTEM /T 1.0 MM 4 HOLE COMPRESSION PLATE	01-928-2,4	個	衛部醫器輸字第 030012號	德芮達	2,562	2,562	依(MRS RECONSTRUCTION、 COMPRESSION PLATE 2:10HOLE STR)同功能類 別品項(如特材代碼 FPP031550NLE)之支付點 數暫予支付。	D201-1	月生效
61	FPP06S2630WR	"拜而美"顏頰 領面骨重建系 統-方型直板 2*7孔;厚 1.6mm	"Biomet Microfixation" TraumaOne Plating System- 2x7 Matrix Plate;Straight;T 1.6mm	SP-2630	個	衛部醫器輸字第 030316號	德芮達	10,075	10,075	依(MINI 3-D PLATE 6X2HOLE或以上)同功能類 別品項(如特材代碼 FPP0610503EJ)之支付點 數暫予支付。	D201-1	月生效
62	FPP0707032WR	"拜而美"顏頰 領面骨重建系 統-L型骨板 3x3孔/厚 0.6mm	"Biomet Microfixation" TraumaOne Plating System-L Plate 3x3 Hole/T 0.6mm	01-703-2,3	個	衛部醫器輸字第 030316號	德芮達	3,753	3,753	依(MICRO L-PLATE 2:10HOLE)同功能類別品 項(如特材代碼 FPP070626NLE)之支付點 數暫予支付。	D201-1	月生效
63	FPP0707038WR	"拜而美"顏頰 領面骨重建系 統-L型骨板 4x6孔;厚 0.6mm	"Biomet Microfixation" TraumaOne Plating System- 4x6 L Plate;T 0.6mm	(01-703-8;9):(01-868-0;1)	個	衛部醫器輸字第 030316號	德芮達	3,753	3,753	依(MICRO L-PLATE 2:10HOLE)同功能類別品 項(如特材代碼 FPP075039NSI)之支付點 數暫予支付。	D201-1	月生效
64	FPP0707066WR	"拜而美"顏頰 領骨固定系 統-標準直型 骨板16孔	"Biomet Microfixation" Midface Plating System-REGULAR STRAIGHT PLATE 16HOLE	01-7066	個	衛部醫器輸字第 030012號	德芮達	3,981	3,981	依(MICRO PLATE 11:24HOLE STR)同功能類 別品項(如特材代碼 FPP070622NLE)之支付點 數暫予支付。	D201-1	月生效
65	FPP0707096WR	"拜而美"顏頰 領骨固定系 統-T型骨板 7/7孔,厚 0.6mm	"Biomet Microfixation" Midface Plating System-T PLATE 7X7HOLE, T 0.6MM	01-7096	個	衛部醫器輸字第 030012號	德芮達	4,364	4,364	依(MICRO T-PLATE 2:12HOLE)同功能類別品 項(如特材代碼 FPP0755405Y2)之支付點 數暫予支付。	D201-1	月生效

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共98項(項次1~項次98,詳頁次1~1-19)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核 支付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
66	FPP0707100WR	"拜而美"顱顏 領面骨重建系 統-Y型骨板5 孔/厚0.6mm	"Biomet Microfixation" TraumaOne Plating System-Y Plate 5Hole/T 0.6mm	01-710-0;4	個	衛部醫器輸字第 030316號	德芮達	4,614	4,614	依(MICRO Y-PLATE 4:13HOLE)同功能類別品 項(如特材代碼 FPP0746020XU)之支付點 數暫予支付。	D201-1	月生效
67	FPP0707121WR	"拜而美"顱顏 領面骨重建系 統-1.5系統/ 厚0.5mm 眼 眶骨板4;6;18 孔	"Biomet Microfixation" TraumaOne Plating System- Plating System- 1.5 SYSTEM /T 0.5 MM ORBITAL PLATE4;6;18 HOLE	01-712-1;3	個	衛部醫器輸字第 030316號	德芮達	3,639	3,639	依(MICRO ORBITAL PLATE 4:12HOLE)同功能類別品 項(如特材代碼 FPP0720210SI)之支付點 數暫予支付。	D201-1	月生效
68	FPP0707131WR	"拜而美"顱顏 領骨固定系 統-方型骨板4 孔0.6MM	"Biomet Microfixation" Midface Plating System- 4 HOLE SQUARE PLATE 0.6MM	01-7-131;357	個	衛部醫器輸字第 030012號	德芮達	3,433	3,433	依(MICRO BOX PLATE 2X2 HOLES)同功能類別品 項(如特材代碼 FPP0755410Y2)之支付點 數暫予支付。	D201-1	月生效
69	FPP0707136WR	"拜而美"顱顏 領骨固定系 統-1.5系統方 型骨板2X3孔 0.6MM	"Biomet Microfixation" Midface Plating System-T1.5 SYSTEM 2X3 HOLE RECTANGLE PLATE 0.6MM	01-7136	個	衛部醫器輸字第 030012號	德芮達	4,826	4,826	依(MICRO BONE PLATE 3X2 HOLE)同功能類別品 項(如特材代碼 FPP0748121XU)之支付點 數暫予支付。	D201-1	月生效
70	FPP0707137WR	"拜而美"顱骨 固定系統-1.5 系統方形骨板 2x4孔0.6mm	"Biomet Microfixation" Neuro Plating System-1.5 MM SYSTEM 2x4 HOLE RECTANGLE PLATE	01-7137	個	衛部醫器輸字第 030863號	德芮達	6,558	6,558	依(MICRO BONE PLATE 4X2 HOLE)同功能類別品 項(如特材代碼 FPP0712046EJ)之支付點 數暫予支付。	D201-1	月生效
71	FPP0707308WR	"拜而美"顱顏 領骨固定系 統-圓頭鉗孔 骨板,厚0.5MM	"Biomet Microfixation" Midface Plating System- BURR HOLE PLATE, T 0.5MM	(01-730-8;9):(01-806-6;8)	個	衛部醫器輸字第 030012號	德芮達	5,823	5,823	依(MICRO BURR HOLE PLATE)同功能類別品 項(如特材代碼 FPP0749020XU)之支付點 數暫予支付。	D201-1	月生效

一、新增既有功能類別特材品項共98項(項次1~項次98,詳頁次1~1-1-19)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核 支付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
72	FPP0707310WR	"拜而美"顱骨 固定系統-1.5mm 系統/厚0.5mm 圓頭鉗孔骨板	"Biomet Microfixation" Neuro Plating System- 1.5SYSTEM/T0.5mm BURR HOLE	01-73-05;10	個	衛部醫器輸字第 030863號	德芮達	5,823	5,823	依(MICRO BURR HOLE PLATE)同功能類別品項 (如特材代碼 FPP0712006EJ)之支付點 數暫予支付。	D201-1	月生效
73	FPP0707340WR	"拜而美"顱骨 固定系統-鈦 網板 85x50x0.2mm	"Biomet Microfixation" Neuro Plating System-Titanium Sheet85x50x0.2mm	01-7340	個	衛部醫器輸字第 030863號	德芮達	10,663	10,663	依(MICRO MESH PLTAE)同 功能類別品項(如特材代 碼FPP0750321XU)之支付 點數暫予支付。	D201-5	月生效
74	FPP0708060WR	"拜而美"顱顏 領骨固定系 統-T型骨板 3/3孔0.6mm	"Biomet Microfixation" Midface Plating System-T-PLATE 3/3 HOLE 0.6mm	01-8060	個	衛部醫器輸字第 030012號	德芮達	4,364	4,364	依(MICRO T-PLATE 2:12HOLE)同功能類別品 項(如特材代碼 FPP0074402XU)之支付點 數暫予支付。	D201-1	月生效
75	FPP0708662WR	"拜而美"顱顏 領面骨重建系 統-1.5系統/ 厚0.6mm直型 骨板8孔	"Biomet Microfixation" TraumaOne Plating System- 1.5 SYSTEM /T 0.6 mm Straight Plate 8 Hole	01-8662	個	衛部醫器輸字第 030316號	德芮達	2,599	2,599	依(MICRO PLATE 6:10HOLE STR)同功能類 別品項(如特材代碼 FPP0755402Y2)之支付點 數暫予支付。	D201-1	月生效
76	FPP0708670WR	"拜而美"顱顏 領面骨重建系 統-1.5系統/ 厚0.6mm標準 直型骨板20孔	"Biomet Microfixation" TraumaOne Plating System- 1.5 SYSTEM/T0.6MM 20 HOLE STRAIGHT PLATE	01-8670	個	衛部醫器輸字第 030316號	德芮達	3,981	3,981	依(MICRO PLATE 11:24HOLE STR)同功能類 別品項(如特材代碼 FPP070622NLE)之支付點 數暫予支付。	D201-1	月生效
77	FPP0708689WR	"拜而美"顱顏 領面骨重建系 統-1.5系統/ 厚0.6mm彎 曲骨板14孔	"Biomet Microfixation" TraumaOne Plating System- 1.5 SYSTEM /T 0.6 mm 14HOLE CURVED PLATE	01-8689	個	衛部醫器輸字第 030316號	德芮達	3,639	3,639	依(MICRO ORBITAL PLATE 4:12HOLE)同功能類別品 項(如特材代碼 FPP0720210SI)之支付點 數暫予支付。	D201-1	月生效

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共98項(項次1~項次98,詳頁次1-1-19)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核 支付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
78	FPP0711015WR	"拜而美"薄型 顱骨固定系 統-正方型骨 板4孔	"Biomet Microfixation"Th inFlap Plating System-4 Hole Square Plate	19-1015	個	衛部醫器輸字第 030242號	德芮達	3,433	3,433	依(MICRO BOX PLATE 2X2 HOLES)同功能類別品項 (如特材代碼 FPP07813344B)之支付點 數暫予支付。	D201-1	月生效
79	FPP0711035WR	"拜而美"薄型 顱骨固定系 統-薄片直型 骨板16孔	"Biomet Microfixation"Th inFlap Plating System-16 Hole Straight Plate	19-1035	個	衛部醫器輸字第 030242號	德芮達	3,981	3,981	依(MICRO PLATE 11:24HOLE STR)同功能類 別品項(如特材代碼 FPP07FM965AE)之支付點 數暫予支付。	D201-1	月生效
80	FPP0711040WR	"拜而美"薄型 顱骨固定系 統-長直型骨 板6孔	"Biomet Microfixation"Th inFlap Plating System-6 Hole Straight Plate Long	19-1040	個	衛部醫器輸字第 030242號	德芮達	2,599	2,599	依(MICRO PLATE 6:10HOLE STR)同功能類 別品項(如特材代碼 FPP0706206LE)之支付點 數暫予支付。	D201-1	月生效
81	FPP0711060WR	"拜而美"薄型 顱骨固定系 統-雙Y型骨 板	"Biomet Microfixation"Th inFlap Plating System-DOUBLE Y PLATE	19-1060	個	衛部醫器輸字第 030242號	德芮達	5,546	5,546	依(MICRO X- PLATE(DOUBLE Y)4:10HOLE)同功能類別 品項(如特材代碼 FPP0720680SI)之支付點 數暫予支付。	D201-1	月生效
82	FPP0717310WR	"拜而美"顱骨 固定系統-圓 形銹孔骨板 X1+骨板2孔 X2+骨釘X10	"Biomet Microfixation" Neuro Plating System-Micro- Burr Hole*1+2 Hole Plate*2+Screw*10	【BURR HOLE PLATE:(01-73- 09;10);SP-2321】;【STR PLATE:01-7345】; 【SCREW:91-15-03:05;91-61- 03:05】	組	衛部醫器輸字第 030863號	德芮達	23,665	23,665	依(BURR HOLE *1+MICRO PLATE 2 HOLE STR*2+ SCREW*10)同功能類別品 項(如特材代碼 FPP074902XXU)之支付點 數暫予支付。	D201-1	月生效
83	FPP07S1865WR	"拜而美"顱顏 領面骨重建系 統-眼眶網板/ 厚0.2mm	"Biomet Microfixation" TraumaOne Plating System- Orbital Floor Mesh / T 0.2mm	SP-1865	個	衛部醫器輸字第 030316號	德芮達	10,437	10,437	依(MICRO ORBITAL FLOOR PLATE)同功能類別品項 (如特材代碼 FPP07503FNSI)之支付點 數暫予支付。	D201-1	月生效

一、新增既有功能類別特材品項共98項(項次1~項次98,詳頁次1-1-1-19)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核 支付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
84	FSP61015152C	“柯惠”舒法 定帕瑞挺人工 聚丙烯編網	“Covidien” Sofradim PARIETENE Polypropylene Meshes 15X15CM	PPL1515;PP1515	片	衛署醫器輸字第 018040號	美敦力	1,603	1,603	依(人工網膜/不可吸收性 /200-299平方公分)同功 能類別品項(如特材代碼 FSP6101515ZQ)之支付點 數暫予支付。	無	月生效
85	FSP61030302C	“柯惠”舒法 定帕瑞挺人工 聚丙烯編網	“Covidien” Sofradim PARIETENE Polypropylene Meshes 30X30CM	PPL3030;PP3030	片	衛署醫器輸字第 018040號	美敦力	2,848	2,848	依(人工網膜/不可吸收性 /900-1000平方公分)同功 能類別品項(如特材代碼 FSP6103030ZQ)之支付點 數暫予支付。	無	月生效
86	FSP61106112C	“柯惠”舒法 定帕瑞挺人工 聚丙烯編網	“Covidien” Sofradim PARIETENE Polypropylene Meshes 6X11CM	PPL0611X3;PP0611X3	片	衛署醫器輸字第 018040號	美敦力	922	922	依(人工網膜/不可吸收性 /≤99平方公分)同功能類 別品項(如特材代碼 FSP6110611ZQ)之支付點 數暫予支付。	無	月生效
87	FSP61115102C	“柯惠”舒法 定帕瑞挺人工 聚丙烯編網	“Covidien” Sofradim PARIETENE Polypropylene Meshes 15X10CM	PPL1510X3;PP1510X3	片	衛署醫器輸字第 018040號	美敦力	1,541	1,541	依(人工網膜/不可吸收性 /100-199平方公分)同功 能類別品項(如特材代碼 FSP6111510ZQ)之支付點 數暫予支付。	無	月生效
88	FSP62PT3H3QH	“豪爾亞”納 德網塞補片	“Herniamesh” Net Plug & Patch 6X11CM	PT3H3PS-P	組	衛署醫器輸字第 028586號	沛宇	3,800	3,800	依(人工網膜/不可吸收性 /3D(小至特大))同功能類 別品項(如特材代碼 FSP62SPMLM2C)之支付點 數暫予支付。	無	月生效
89	HHM0135250AG	“雅睿”可回 收血栓過濾網	“Argon” Retrievable Vena Cave Filter	352506070E;352506100E	組	衛署醫器輸字第 030760號	實密	32,929	32,929	依(腔靜脈血栓過濾網 /SET(Introducercathwit hfilter, Sheath/dilator))同功能類別品項(如特 材代碼HHM01466F2CD)之 支付點數暫予支付。	無	月生效
90	HHM01SLVASG9	艾愛美抽吸導 管	ISOLV Aspiration Catheter	51SV14;61SV14;71SV14	組	衛署醫器輸字第 030903號	連鑑	13,250	13,250	依(抽吸方式移除血栓系 統組)同功能類別品項(如 特材代碼HHM01ADVAM4) 之支付點數暫予支付。	B301-3	月生效

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共98項(項次1~項次98,詳頁次1-1~1-19)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商 簡稱	廠商建議 支付點數	初核 支付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
91	LEE01P0511INK	"日本光電"心臟除顫器用電擊貼片(成人)	"Nihon Kohden" Cardiolife Defibrillator Pads	P-511	PAIR	衛部醫器輸字第030413號	理工	652	652	依(非侵入性暫時心律調節之電極貼片(成人))同功能類別品項(如特材代碼LEE01P0510KT)之支付點數暫予支付。	無	月生效
92	NDN010192TE4	"美德萊"安全頭皮針	"Medline" Disposable Safety Scalp Vein Sets	19G-27G	支	衛部醫器輸字第000888號	恆暉	25	8.3	新增(SAFETY SCALP安全型頭皮針)核價類別,依類似功能類別(一般針具與安全針具)支付點數之價差倍數比值平均換算,平均倍數計算暫予支付。	無	月生效
93	NDN02A250VPW	"普惠"蝴蝶彎針-安全型	"PERFECT" WINGED NEEDLE SET-SAFETY	(A25;A26;A28;A29含Y型加藥延長管);(A27;A30含延長管)	支	衛署醫器輸字第014428號	普惠	90	90	依(安全型蝴蝶彎針(針+延長管)SAFETY PORT-A GRIPPER NEEDLE+EXTENSION TUBING))同功能類別品項(如特材代碼NDN020119YBA)之支付點數暫予支付。	A216-3	月生效
94	WBB0802040ZD	"杜京"石膏繃帶(未滅菌):玻璃纖維/2"x4Y	"DUK-IN" CAST PLASTER BANDAGE (Non-Sterile):FIBERGLASS CAST TAPE	TH-1302B	卷	衛署醫器輸字第002507號	銓順	105	105	依(樹脂石膏繃帶/玻璃纖維/2吋x4吋)同功能類別品項(如特材代碼WBB08020403M)之支付點數暫予支付。	E310-1	月生效
95	WBB0803040ZD	"杜京"石膏繃帶(未滅菌):玻璃纖維/3"x4Y	"DUK-IN" CAST PLASTER BANDAGE (Non-Sterile):FIBERGLASS CAST TAPE	TH-1303B	卷	衛署醫器輸字第002507號	銓順	105	105	依(樹脂石膏繃帶/玻璃纖維/3吋x4吋)同功能類別品項(如特材代碼WBB08030403M)之支付點數暫予支付。	E310-1	月生效
96	WBB0804040ZD	"杜京"石膏繃帶(未滅菌):玻璃纖維/4"x4Y	"DUK-IN" CAST PLASTER BANDAGE (Non-Sterile):FIBERGLASS CAST TAPE	TH-1304B	卷	衛署醫器輸字第002507號	銓順	123	123	依(樹脂石膏繃帶/玻璃纖維/4吋x4吋)同功能類別品項(如特材代碼WBB08040403M)之支付點數暫予支付。	E310-1	月生效

一、新增既有功能類別特材品項共98項(項次1~項次98,詳頁次1-1-1-19)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商 簡稱	廠商建議 支付點數	初核 支付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
97	WBB0805040ZD	"杜京"石膏繃帶(未滅菌): 玻璃纖維/5"x 4Y	"DUK-IN" CAST PLASTER BANDAGE (Non- Sterile):FIBERGL ASS CAST TAPE	TH-1305B	卷	衛署醫器輸壹字 第002507號	鈐順	137	137	依(樹脂石膏繃帶/玻璃纖維/5吋x4y)同功能類別品項(如特材代碼WBB08050403M)之支付點數暫予支付。	E310-1	月生效
98	WDD08110106Y	"H&H" 泡棉敷料(滅菌)	"H&H" Foam Dressing (Sterile) 10X10CM	FF1010	片	衛部醫器製壹字 第007265號	中鎮	116	116	依(人工生物化學覆蓋物/FOAM DRESSING,面積約51cm2-100cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD0820633F4)之支付點數暫予支付。	A217-1	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

二、新增既有功能類別特材自付差額品項共8項(項次99~項次106,詳頁次1-20~1-22)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商名稱	適用自付差額條件	健保給付上限	核價說明	給付規定	生效日期
99	CBP06FB2EL3X	"上海微创"法爾貝德冠狀動脈支架系統(自付差額)	"Shanghai MicroPort" Fire bird2 Rapamycin-Eluting Coronary CoCr Stent System	G-25;27;30;35;40-13;18;23;29;33	組	衛部醫器陸輸字第000912號	心健	改善血管直徑,減少病灶再次狹窄機率。	14,099	自付差額品項,依(塗藥或特殊塗層血管支架/自付差額)近似功能類別品項(如特材代碼CBP06ELUT1BK)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	A213-2N	月生效
100	FALSNVSTR04H	"漢寧達"妥視能非球面散光矯正人工水晶體(自付差額品項)	"Hanita" VisTor Aspheric Toric Intraocular Lens	VisTor	片	衛部醫器輸字第030899號	佳和美	提供具非球面功能型人工水晶體,能有效降低角膜的球面像差之療效及散光矯正功能。	2,744	依(特殊功能人工水晶體(散光非球面款式))同功能類別品項(如特材代碼FALSNTRC1B9)之支付點數暫予支付。	無	月生效
101	FBHPCCEA15D	"麥克波特"陶瓷全人工髖關節系統(陶瓷頭搭配組合式股骨柄)(自付差額)	"MICROPORT" CERA MIC TOTAL HIP SYSTEM	由以下特材代碼組合: FBHC1PRTYL5D;FBHL1PRTYL5D;FBHCCERAP5D;FBHS1PFRMR5D	組	衛部醫器輸字第027627號+衛署醫器輸字第019530號	裕強	1.增加耐久性。 2.陶瓷人工髖關節系統,可增加使用年限。	49,319	自付差額品項,依(特殊材質全人工髖關節組 CERAMIC TOTAL HIP SYSTEM(陶瓷HEAD部分給付)搭配傳統組合式 STEM+CUP+LINER)近似功能類別品項(如特材代碼FBHPCCEA6Z1)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	無	月生效
102	FBHPCCEA15D	"麥克波特"陶瓷全人工髖關節系統(自付差額)	"MICROPORT" CERA MIC TOTAL HIP SYSTEM	由以下特材代碼組合: FBHC1PRTYL5D;FBHL1PRTYL5D;FBHCCERAP5D;FBHS13708N5D	組	衛部醫器輸字第027627號+衛署醫器輸字第007731號	裕強	1.增加耐久性。 2.陶瓷人工髖關節系統,可增加使用年限。	39,396	自付差額品項,依(特殊材質全人工髖關節組 CERAMIC TOTAL HIP SYSTEM(陶瓷HEAD部分給付)搭配傳統 STEM+CUP+LINER)近似功能類別品項(如特材代碼FBHPCCEA6Z1)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	無	月生效

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

報告案第1案

二、新增既有功能類別特材自付差額品項共8項(項次99~項次106,詳頁次1-20~1-22)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	適用自付差額條件	健保給付上限	核價說明	給付規定	生效日期
103	FBNG1052719R	愛派司亞洲解剖型髓內釘系統組-長釘組(自付差額)	AA Nailing System-Long Nail Set	(7500-09;14-12;22-20;24)(7500-09;14-10;11;20;21-26;28;30;32;34;36;38;40;42)(7500-95;96-10-75;80;85;90;95;100;105;110;115;120)(7500-9849-26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58;60;64;68;72;76;80;85;90;95;100)(7500-9910-00;05;10;15)	組	衛部醫器製字第005271號	愛派司	本案特材長度較長,可減少病人採傳統方式治療之手術時間,符合自付差額特材條件之「增加病人使用方便性」	19,036	自付差額品項,依(鈦合金)加長型伽瑪髓內釘組(長度180mm以上)近似功能類別品項(如特材代碼FBNG120311S9)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	D101-2	月生效
104	FHP02ENGDRBK	"百多力"艾尼傳六磁振造影植入式心律調節器-雙腔	"BIOTRONIK"Enitra 6 Implantable Cardiac Pacemakers with a conditional intended use in a MRI environment(DR-ODDR-MRI)	Enitra 6 DR	個	衛部醫器輸字第030908號	百多力	改善心房心室緩脈,具速率調整和磁振共振相容功能。	93,833	自付差額品項,依近似功能類別品項(如特材代碼FHP02ELUDBK)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	B101-1	月生效
105	FHP02ENGDTBK	"百多力"艾尼傳六磁振造影植入式心律調節器-雙腔	"BIOTRONIK"Enitra 6 Implantable Cardiac Pacemakers with a conditional intended use in a MRI environment(DR-T)(DDDR-MRI)	Enitra 6 DR-T	個	衛部醫器輸字第030908號	百多力	改善心房心室緩脈,具速率調整和磁振共振相容功能。	93,833	自付差額品項,依近似功能類別品項(如特材代碼FHP02ENTDRBK)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	B101-1	月生效

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

二、新增既有功能類別特材自付差額品項共8項(項次99~項次106,詳頁次1-20~1-22)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	適用自付差額條件	健保給付上限	核價說明	給付規定	生效日期
106	FBNG118785S1	"信迪恩"長股骨髓內釘系統(自付差額)	"Synthes" PFNA II Implant	(472.- 110S:117S);(473.- 015S:038S);(473.- 040S:045S);(473.- 050S:055S);(473.- 060S:065S);(473.- 070S:075S);(473.- 800S:807S);(473.- 170S:173S);(04.027.- 050S:059S);(459.- 260:280;300;320;340; 360;380;400;420;440; 460;480;500;520;540; 560;580;600;640;680; 720;760;800;850;900; 950;960)	組	衛署醫器輸字第018785號	壯生	本案特材長度較長,可減少病人採傳統方式治療之手術時間,符合自付差額特材條件之「增加病人使用方便性」	19,036	自付差額品項,依(缺合金加長型伽瑪髓內釘組(長度180mm以上)/自付差額)近似功能類別品項(如特材代碼FBNG107866S1)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	D101-2	月生效

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共30項(項次107-項次136,詳頁次1-23-1-28)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核支付 點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
107	CBB01PCECAM4	"美敦力"派斯飛 克普拉斯周邊血 管治療導管	"Medtronic" Pacif ic Plus PTA Catheter	(型號重疊:PCE-040;050;060;070-040;060;080- 090自1071101生效)(PCE-020;035- 020;040;060;080;120;150-090;130;180)(PCE- 040;070-020;040;060;080;120- 090;130;180)(刪除PCE-020;025;030;035- 020;040;060;080;120;150- 090;130;180);(040;050;060;070-020;120- 90);(040;050;060;070-040;060;080;120- 130;180)自1071101生效))	條	衛署醫器輸字 第026927號	美敦 力	5,130	5,130	型號重疊PCE- 040;050;060;070- 040;060;080-090;刪 除產品型號PCE- (020;025;030;035- 020;040;060;080;12 0;150- 090;130;180);(040; 050;060;070- 020;120- 90);(040;050;060;0 70- 040;060;080;120- 130;180)	無	月生效
108	CBB01PCF18F2	"英泰克"派斯飛 克血管治療導管	"INVATEC" PACIFIC XTREME PTA BALLOON CATHETER	PCF020020090;PCF070120090;PCF020020130;PCF 070120130;PCF020020180;PCF070120180(自 1050701型號重疊為PCF-(020;050- 020;030;040;060;080;120;150- 090;130;180);(040;050-200;250;300- 090;130);(055;070-020;030;040;060;080;120- 090;130;180);(060-150;200;250;300- 090;130);(070-150;200;250-090;130))(刪除 PCF-020;025;030;035;040;045;050-120;150- 090;130;180;PCF-040;050;060-200;250;300- 090;130;PCF-055;060;065;070-120- 090;130;180;PCF-060-150-090;130;PCF-070- 150;200;250-090;130自1071101生效)	條	衛署醫器輸字 第019749號	美敦 力	5,130	5,130	刪除產品型號PCF- 020;025;030;035;04 0;045;050-120;150- 090;130;180;PCF- 040;050;060- 200;250;300- 090;130;PCF- 055;060;065;070- 120- 090;130;180;PCF- 060-150- 090;130;PCF-070- 150;200;250- 090;130	無	月生效
109	CBB03AMD21F2	"英泰克"安非尤 血管治療導管 (下肢血管)	"INVATEC" AMPHIRI ON DEEP PTA BALLOON CATHETER	AMD-020;040-120;150-002;152;RX2;AMD- 225;253;335;354-210-002;152;RX2(刪除AMD- 020;040-120;150-RX2;AMD-225;253;335;354- 210-RX2自1071101生效)	支	衛署醫器輸字 第019728號	美敦 力	10,660	10,660	刪除產品型號AMD- 020;040-120;150- RX2;AMD- 225;253;335;354- 210-RX2	A220-5	月生效
110	CBB03AMD80F2	"英泰克"安非尤 血管治療導管 (下肢血管)	"INVATEC" AMPHIRI ON DEEP PTA BALLOON CATHETER	AMD-015-020-001;002;151;152;AMD-020;040- 040;080-002;152;RX2(刪除AMD-020;040- 040;080-RX2自1071101生效)	條	衛署醫器輸字 第019728號	美敦 力	8,103	8,103	刪除產品型號AMD- 020;040-040;080- RX2	A220-5	月生效
111	CBC04SUP12AB	"亞培"達彼諾周 邊血管支架系 統-淺股動脈血 管支架	"Abbott" Supera Peripheral Stent System L:20- 120MM	SE-04;05;06-020;120-80;120-6F;SE-07- 020;100-80;120-6F(420-45;55;65- 020;030;040;060;080;100;120-80;120;420-75- 020;030;040;060;080;100-80;120自1071101生 效)	組	衛署醫器輸字 第027315號	亞培	28,773	28,773	擴增產品型號420- 45;55;65- 020;030;040;060;08 0;100;120- 80;120;420-75- 020;030;040;060;08 0;100-80;120	A220-4	月生效

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共30項(項次107-項次136,詳頁次1-23~1-28)

項次	特材代碼	特材中文名	特材英文名	產品型號	單位	許可證字號	廠商名稱	廠商建議 支付點數	初核支 付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
112	CBC04SUP15AB	"亞培"達彼諾周 邊血管支架系 統-淺股動脈血 管支架	"Abbott" Supera Peripheral Stent System L:150- 200MM	SE-04-150-80;120-6F;SE-05-06-150;180;200- 80;120-6F(420-45-150-120;42-055;065- 150;180;200-080;120自1071101生效)	組	衛部醫器輸字 第027315號	亞培	44,293	44,293	擴增產品型號420- 45-150-120;42- 055;065- 150;180;200- 080;120	A220-4	月生效
113	CBC05ZTA01CK	"曲克"藍尼思阿 發胸主動脈內移 植物(1支)	"Cook" Zenith Alpha Thoracic Endovascular Graft	ZTA-P-18;24-105;127;ZTA-P-28-105;149;ZTA- P-28-32-109;132;155;201;ZTA-P-34;36- 113;137;161;209;ZTA-P-38;40- 117;142;167;217;ZTA-P-42- 121;147;173;225;ZTA-P-44;46- 125;152;179;233;ZTA-PT-32-28-178;201;ZTA- PT-34;36-30;32-161;209;ZTA-PT-38;40-34;36- 167;217;ZTA-PT-42-38-173;225;ZTA-PT-44;46- 40;42-179;233;ZTA-D-28-32-160;229;ZTA-D- 34;36-142;190;ZTA-D-38;40-147;197;ZTA-D- 42-152;204;ZTA-D-44;46-157;211;ZTA-DE- 18-26-104;148;ZTA-DE-28-32-108;154;ZTA-DE- 34;36-112;160;ZTA-DE-38;40-91;141;ZTA-DE- 42-94;146;ZTA-DE-44;46-97;151;(刪除型號 ZTA-P-18;20;22-105;127;ZTA-DE-18;20;22- 104;148自1070301生效)(擴增ZTA-PT-30-26-108 自1071101生效)	組	衛部醫器輸字 第027988號	曲克	305,007	305,007	擴增產品型號ZTA-PT- 30-26-108。	A220-6	月生效
114	CBC05ZTA02CK	"曲克"藍尼思阿 發胸主動脈內移 植物(2支)	"Cook" Zenith Alpha Thoracic Endovascular Graft	ZTA-P-18;24-105;127;ZTA-P-26-105;149;ZTA- P-28-32-109;132;155;201;ZTA-P-34;36- 113;137;161;209;ZTA-P-38;40- 117;142;167;217;ZTA-P-42- 121;147;173;225;ZTA-P-44;46- 125;152;179;233;ZTA-PT-32-28-178;201;ZTA- PT-34;36-30;32-161;209;ZTA-PT-38;40-34;36- 167;217;ZTA-PT-42-38-173;225;ZTA-PT-44;46- 40;42-179;233;ZTA-D-28-32-160;229;ZTA-D- 34;36-142;190;ZTA-D-38;40-147;197;ZTA-D- 42-152;204;ZTA-D-44;46-157;211;ZTA-DE- 18-26-104;148;ZTA-DE-28-32-108;154;ZTA-DE- 34;36-112;160;ZTA-DE-38;40-91;141;ZTA-DE- 42-94;146;ZTA-DE-44;46-97;151(刪除產品型號 ZTA-P-18;20;22-105;127;ZTA-DE-18;20;22- 104;148自1070301生效)(擴增ZTA-PT-30-26-108 自1071101生效)	組	衛部醫器輸字 第027988號	曲克	468,000	468,000	擴增產品型號ZTA-PT- 30-26-108。	A220-6	月生效

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共30項(項次107~項次136,詳頁次1-23~1-28)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商名稱	廠商建議 支付點數	初核支 付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
115	CBC05ZTA03CK	"曲克"藍尼恩阿 發胸主動脈內移 植物(3支)	"Cook"Zenith Alpha Thoracic Endovascular Graft	ZTA-P-18;24-105;127;ZTA-P-26-105;149;ZTA- P-28;32-109;132;155;201;ZTA-P-34;36- 113;137;161;209;ZTA-P-38;40- 117;142;167;217;ZTA-P-42- 121;147;173;225;ZTA-P-44;46- 125;152;179;233;ZTA-PT-32-28-178;201;ZTA- PT-34;36-30;32-161;209;ZTA-PT-38;40-34;36- 167;217;ZTA-PT-42-38-173;225;ZTA-PT-44;46- 40;42-179;233;ZTA-D-28;32-160;229;ZTA-D- 34;36-142;190;ZTA-D-38;40-147;197;ZTA-D- 42-152;204;ZTA-D-44;46-157;211;ZTA-DE- 18;26-104;148;ZTA-DE-28;32-108;154;ZTA-DE- 34;36-112;160;ZTA-DE-38;40-91;141;ZTA-DE- 42-94;146;ZTA-DE-44;46-97;151(刪除產品型號 ZTA-P-18;20;22-105;127;ZTA-DE-18;20;22- 104;148自1070301生效)(擴增ZTA-PT-30-26-108 自1071101生效)	組	衛署醫器輸字 第027988號	曲克	468,000	468,000	擴增產品型號ZTA-PT- 30-26-108。	A220-6	月生效
116	CBC05ZTA04CK	"曲克"藍尼恩阿 發胸主動脈內移 植物(4支(含)以 上)	"Cook"Zenith Alpha Thoracic Endovascular Graft	ZTA-P-18;24-105;127;ZTA-P-26-105;149;ZTA- P-28;32-109;132;155;201;ZTA-P-34;36- 113;137;161;209;ZTA-P-38;40- 117;142;167;217;ZTA-P-42- 121;147;173;225;ZTA-P-44;46- 125;152;179;233;ZTA-PT-32-28-178;201;ZTA- PT-34;36-30;32-161;209;ZTA-PT-38;40-34;36- 167;217;ZTA-PT-42-38-173;225;ZTA-PT-44;46- 40;42-179;233;ZTA-D-28;32-160;229;ZTA-D- 34;36-142;190;ZTA-D-38;40-147;197;ZTA-D- 42-152;204;ZTA-D-44;46-157;211;ZTA-DE- 18;26-104;148;ZTA-DE-28;32-108;154;ZTA-DE- 34;36-112;160;ZTA-DE-38;40-91;141;ZTA-DE- 42-94;146;ZTA-DE-44;46-97;151(刪除產品型號 ZTA-P-18;20;22-105;127;ZTA-DE-18;20;22- 104;148自1070301生效)(擴增ZTA-PT-30-26-108 自1071101生效)	組	衛署醫器輸字 第027988號	曲克	468,000	468,000	擴增產品型號ZTA-PT- 30-26-108。	A220-6	月生效
117	CBC01FLC10F2	"英泰克"冠狀動 脈氣球導管	"INVATEC" FALCON CTO PTCA BALLOON CATHETER	FLC010010- C11;C12;C31;C32;C21;C22;FLC010014- C11;C12;C31;C32;C22;C21;FLC010020- C11;C31;C32;C21;C22;C12(刪除FLC010020- C11;C12自1071101生效)	支	衛署醫器輸字 第019570號	美敦 力	6,217	6,217	刪除產品型號 FLC010020-C11;C12	無	月生效
118	CBS01RASHK4	"美敦力"球囊中 隔切除術導管 (輔助電燒導管)	"MEDTRONIC" RASHKI ND BALLOON SEPTOSTOMY CATHETER	007158;007160;007161;008764(刪除008764自 1071101生效)	支	衛署醫器輸字 第023200號	美敦 力	9,000	9,000	刪除產品型號008764。	無	月生效

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共30項(項次107-項次136,詳頁次1-23-1-28)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商名稱	廠商建議 支付點數	初核支付 點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
119	CBS02HRSTEY4	"先健科技公司" 輸送鞘	"LIFETECH SCIENTIFIC" STEERE ASE INTRODUCER	SFA-5F:14F(SFA-5F:14F-f自1071101生效)	組	衛部醫器陸輸 字第000716號	銳盛	12,000	12,000	擴增產品型號SFA- 5F:14F-f。	A213-4	月生效
120	CBS03HRSTEY4	"先健科技公司" 輸送鞘	"LIFETECH SCIENTIFIC" STEERE ASE INTRODUCER	SFP-5F:14F(SFP-5F:14F-f自1071101生效)	組	衛部醫器陸輸 字第000716號	銳盛	12,000	12,000	擴增產品型號SFP- 5F:14F-f。	A213-5	月生效
121	CDVP346024PM	"美敦力"腦脊髓 液引流組	"MEDTRONIC" CSF- UNITIZED SHUNT KIT	46012:26(產品型號重疊 46012:46014;46016:46022;46024自1071101生 效)	組	衛部醫器輸字 第011656號	美敦 力	7,127	7,127	產品型號重疊 46012:46014;46016:46 022:46024	無	月生效
122	CE01B060NPW	"普惠"輸液套-Y 管免針安全型	"PERFECT" DISPOSABLE INFUSION SET- SAFETY	B06;(C06自1040701生效);(B08:C08自1041101生 效)(A15:A18:A21:A24自1071101生效)	組	衛部醫器輸字 第014313號	普惠	33.7	33.7	擴增產品型號 A15:A18:A21:A24。	1301-3	月生效
123	CFE03EXFDWH	"泰悟"食道支架	"Taewoong" Niti-S Esophageal Covered Stent	(ES-16;18;20-06;08;10;12;15-FD);(EA- 16;18;20-06;08;10;12;15-FD);(EK- 18;20;22;24;26;28-10;12;14;15;16;18;20- FNT2)【(ES-16;18;20-06;08;10;12;15-F);(ES- 22;24;28-18;23-F);(ES-16;18;20- 06;08;10;12;15-B)自1071101生效】	組	衛部醫器輸字 第030101號	禾新 醫療	45,000	45,000	擴增產品型號(ES- 16;18;20- 06;08;10;12;15- F);(ES-22;24;28- 18;23-F);(ES- 16;18;20- 06;08;10;12;15-B)。	A224-2	月生效
124	CGPG1SC014Y7	"伊維三"崔爾巴 特支持導管	"EV3" TRAILBLAZER SUPPORT CATHETER	SC-014-135;150;SC-018-090;135;150;SC-035- 065;090;135;150(ASC-014- 090;135;150);(ASC-018-090;135;150);(ASC- 035-065;090;135;150)自1071101生效)	EA	衛部醫器輸字 第023310號	美敦 力	8,604	8,604	擴增產品型號(ASC- 014- 090;135;150);(ASC- 018- 090;135;150);(ASC- 035- 065;090;135;150)。	無	月生效
125	CLS04F020VPW	"普惠"精密輸 液套	"PERFECT" Disposable Infusion Sets(Burette Sets)	F02;F04(擴增產品型號F21;F22;F23;F24自 1071101日生效)	組	衛部醫器輸字 第029713號	普惠	41	41	本署同意擴增產品型號 F21;F22;F23;F24。	無	月生效
126	CLS04F060VPW	"普惠"精密輸 液套-免針安全 型	"PERFECT" Disposable Infusion Sets(Burette Sets)-Safety Needle Free	F06;F07(擴增產品型號F10;F11;F14;F15自 1071101日生效)	組	衛部醫器輸字 第029713號	普惠	63.4	63.4	本署同意擴增產品型號 F10;F11;F14;F15。	E301-4	月生效
127	CVA014A00NM4	"美敦力"賽西亞 心臟血管攝影導 管	"MEDTRONIC" SITESEER CARDIOVASCULAR ANGIOGRAPHIC CATHETER	4A0001:4A0066(4A0064:4A0066自1071101刪除)	EA	衛部醫器輸字 第009568號	美敦 力	543	543	刪除產品型號 4A0064:4A0066。	無	月生效
128	FALSMWZ30BA1	"愛爾康"視而卡 人工水晶體	"ALCON" CLCO INTRAOCULAR LENSES (PMMA)	ANYSIZE;(1011001更正 MTA3U0;MTA4U0;MTA5U0;MZ60BD);(MTA3U0;MTA4U0;MT A5U0自1071101起刪除);(MTA3U0;MTA4U0;MTA5U0自 1071101起生效)	片	衛部醫器輸字 第006650號	愛爾 康	1,532	1,532	刪除產品型號 MTA3U0;MTA4U0;MTA5U0 ，擴增產品型號 MTA3U0;MTA4U0;MTA5U0 。	無	月生效

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共30項(項次107~項次136,詳頁次1-23~1-28)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核支 付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
129	FBHBA1100NDP	"希富"可瑞雙極式人工髖關節組	"DEPUY" CORAIL BIPOLAR HIP SYSTEM	按產品型號組合:(1000401)整理 FBHBA1103XNDP;FBHBA11840NDP;FBHBA1101XNDP;FBHBA11925XNDP;FBHBA1135XNDP; (FBHBA11840NDP;FBHBA1135XNDP自1071101刪除);(FBHBA110820DP;FBHBA11ARTHDDP自1071101生效)	組	衛署醫器輸字第009313號 +009471號 +024193號 +009211號+街署醫器陸輸字第000297號	壯生	35,195	35,195	刪除產品型號 FBHBA11840NDP;FBHBA1135XNDP擴增產品型號 FBHBA110820DP;FBHBA11ARTHDDP TIHDDP	無	月生效
130	FBHBA1100NDP	"希富"可瑞全人工髖關節組	"DEPUY" CORAIL TOTAL HIP SYSTEM	按產品型號組合;自1071101起型號重新整理,由以下特材代碼組合: FBHBA11925XNDP;FBHBA110820DP;FBHBA115570DP;FBHBA11ARTHDDP;FBHBA11PNNPDP;FBHBA11P1NPLDP;FBHBA11P1NNADP	組	衛署醫器輸字第009313號 +024193號 +014292號 +022363號+街署醫器陸輸字第000297號	壯生	39,396	39,396	型號重新整理,由以下特材代碼組合: FBHBA11925XNDP;FBHBA110820DP;FBHBA115570DP;FBHBA11ARTHDDP;FBHBA11PNNPDP;FBHBA11P1NPLDP;FBHBA11P1NNADP	無	月生效
131	FBSF1R200NS9	"史萊克"喜爾復位植體:二節	"STRYKER" XIA REDUCTION IMPLANTS:TWO LEVEL	03828425:760+03829425:760;+03805025:060;03802070:2100;+48218030:90;48219050:80(FBSF2X204NS9自107年11月1日生效)	組	衛署醫器輸字第019634號 +020147號	史萊克	23,358	23,358	擴增產品組件特材代碼 FBSF2X204NS9。	D112-1	月生效
132	FBSF1R300NS9	"史萊克"喜爾復位植體:三節	"STRYKER" XIA REDUCTION IMPLANTS:THREE LEVEL	03828425:760+03829425:760;+03805025:060;03802070:2100;+48218030:90;48219050:80(FBSF2X204NS9自107年11月1日生效)	組	衛署醫器輸字第019634號 +020147號	史萊克	34,118	34,118	擴增產品組件特材代碼 FBSF2X204NS9。	D112-1	月生效
133	FBSF2X204NS9	"史萊克"喜爾脊椎系統:固定桿(短節)	"STRYKER" XIA SPINAL SYSTEM:ROD	0380-2040:2100;(980101起變更 為:03802070:03802100);(48218030:48218035:48218040:48218045:48218050:48218060:48218070:48218080:48218090:48219050:48219060:48219070:48219080自107年11月1日生效)	支	衛署醫器輸字第009422號 +020147號	史萊克	919	919	擴增產品型號 48218030:48218035:48218040:48218045:48218050:48218060:48218070:48218080:48218090:48219050:48219060:48219070:48219080。	D112-1	月生效
134	FBSF4BA012RK	瑞寶德膠椎內固定系統:中空定向螺釘	"REBORN ESSENCE" LUMBAR FIXATION SYSTEM:CANNULATED POLY AXIAL SCREW	(281-45:50:55:60:65-30:35:40:45:50)(281-62-40:45:50);(281-65-55:60)(281-70:75:80-30:35:40:45:50:55:60);(281-65:60:65;70:75-30:35-F;G)(281-55:60:62:65;70:75-40:45:50-F;G)(281-65:70:75-55:60-F;G自107年11月1日生效)	支	衛署醫器輸字第002799號	寶德生技	11,812	11,812	擴增產品型號(281-55:60:65;70:75-30:35-F;G)(281-55:60:62:65;70:75-40:45:50-F;G)(281-65:70:75-55:60-F;G)。 月本會議決 議,本項之 健保給付於 108年1月1 日變更為支 付點數 5,380點。 給付規定代 碼為D112-1。)	D112-5	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共30項(項次107~項次136,詳頁次1-23~1-28)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核支 付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
135	FBSFAPG01WG	"威創"高分子複 合/鈦合金材料 椎間融合系統: 聚醚醚酮(側開 型)腰推推籠,每 節椎體限置放1 個)	"WILTRON" INTERBOD Y FUSION SYSTEM-TLIF PEEK CAGE	004-08:14-24:26:30-00:04:08;(004- 083:093;103;113;123;133;143-200;204;208自 1011001生效);(004-08:14-28-00:04:08自1071101生 效)	個	衛署醫器製字 第003280號	台灣 微創	41,355	41,355	擴增產品型號004- 08:14-28-00:04:08。	D112-4	月生效
136	HIM01G1462M4	"美敦力"保護導 線加上暫時阻斷 吸除系統	"MEDTRONIC" GUARDWIRE PLUS TEMPORARY OCCLUSION AND ASPIRATION SYSTEM(EXPORT 7F ASPIRATION CATHETER)	G146200USB;GEZ6200US7B(G146200USB自1071101刪 除)	EA	衛署醫器輸字 第010292號	美敦 力	13,250	13,250	刪除產品型號 G146200USB。	B301-3	月生效

特材代碼： CVA01DXTTRM4
 中文品名： “美敦力”德克斯提診斷導管
 英文品名： “Medtronic” DxTerity Diagnostic Catheter
 許可證字號： 衛部醫器輸字第030815號

型號			
DXT5JL35	DXT53DRC	DXT6MPAA	U6TRAP45SH
DXT5JL40	DXT5RCB	DXT6MPASH	U6TRAP45SHA
DXT5JL40X	DXT5LCB	DXT6MPASHA	U5TRAN35
DXT5JL45	DXT5IMA	DXT6MPB	U5TRAN35SH
DXT5JL45X	DXT5PIGSTA	DXT6MPBA	U5TRAN35SHA
DXT5JL50	DXT5PIGSTX	DXT6MPBSH	U6TRAN35
DXT5JL50X	DXT5PIG45A	DXT6MPBSHA	U6TRAN35SH
DXT5JL60	DXT5PIG55A	DXT6NOTO	U6TRAN35SHA
DXT5JR35	DXT6JL35	DXT63DRC	U5TRAN40
DXT5JR35X	DXT6JL40	DXT6RCB	U5TRAN40SH
DXT5JR40	DXT6JL40X	DXT6LCB	U5TRAN40SHA
DXT5JR40X	DXT6JL45	DXT6IMA	U6TRAN40
DXT5JR4ST	DXT6JL45X	DXT6PIGSTA	U6TRAN40SH
DXT5JR4M	DXT6JL50	DXT6PIGSTX	U6TRAN40SHA
DXT5JR50	DXT6JL50X	DXT6PIG45A	U5TRAN45
DXT5JR50X	DXT6JL60	DXT6PIG55A	U5TRAN45SH
DXT5JR60	DXT6JR35	U5TRAP35	U5TRAN45SHA
DXT5AL10	DXT6JR35X	U5TRAP35SH	U6TRAN45
DXT5AL20	DXT6JR40	U5TRAP35SHA	U6TRAN45SH
DXT5AL30	DXT6JR40X	U6TRAP35	U6TRAN45SHA
DXT5AR10	DXT6JR4ST	U6TRAP35SH	U5TRACK
DXT5AR20	DXT6JR4M	U6TRAP35SHA	U5TRACKSH
DXT5ARM	DXT6JR50	U5TRAP40	U5TRACKSHA
DXT5MPA	DXT6JR50X	U5TRAP40SH	U6TRACK
DXT5MPAA	DXT6JR60	U5TRAP40SHA	U6TRACKSH
DXT5MPASH	DXT6AL10	U6TRAP40	U6TRACKSHA
DXT5MPASHA	DXT6AL20	U6TRAP40SH	U5TRACT
DXT5MPB	DXT6AL30	U6TRAP40SHA	U5TRACTSH
DXT5MPBA	DXT6AR10	U5TRAP45	U5TRACTSHA
DXT5MPBSH	DXT6AR20	U5TRAP45SH	U6TRACT
DXT5MPBSHA	DXT6ARM	U5TRAP45SHA	U6TRACTSH
DXT5NOTO	DXT6MPA	U6TRAP45	U6TRACTSHA

品項代碼：CXE01REGU45D

中文品名："微創電生理"診斷導管(4:8極)

英文品名："MicroPort"EasyFinder Diagnostic Catheter

許可證字號：衛部醫器陸輸字第 000900 號

■ 型號及規格

✱ • Fixed Curve Diagnostic Catheter 固定式診斷導管

Specification	Curve/ color	Electrode Num. & Electrode spacing (mm)	Tip electrode	Length of shaft (cm)	Diameter of shaft (mm)	Recommend using site	
EPD6AD252	A/Yellow	4 & 2-5-2	None	115	2.0	Right Atrial (RA)	
EPD6AD005		4 & 5-5-5					
EPD6AD010		4 & 10-10-10					
EPD6DD252	D/Blue	4 & 2-5-2				Right Ventricle (RV)	
EPD6DD005		4 & 5-5-5					
EPD6DD010		4 & 10-10-10					
EPD6FD252	F/Black	4 & 2-5-2				His Bundle (HIS)	
EPD6FD005		4 & 5-5-5					
EPD6FD010		4 & 10-10-10					
EPD5PE282	P/Grey	10 & 2-8 in sequence		60	1.65	Coronary Sinus (CS)	
EPD6PE282				92			
EPD6DE282	D/Blue						
EPD6AB252	A/Yellow	4 & 2-5-2	One	115	2	Right Atrial (RA)	
EPD6AB005		4 & 5-5-5					
EPD6AB010		4 & 10-10-10					
EPD6DB252	D/Blue	4 & 2-5-2				Right Ventricle (RV)	
EPD6DB005		4 & 5-5-5					
EPD6DB010		4 & 10-10-10					
EPD6FB252	F/Black	4 & 2-5-2				His Bundle (HIS)	
EPD6FB005		4 & 5-5-5					

EPD6FB010		4 & 10-10-10				
EPD5PC282	P/Grey	10 & 2-8 in sequence		60	1.65	Coronary Sinus (CS)
EPD6PC282	P/Grey	10 & 2-8 in sequence		60	2	
EPD6DC282	D/Blue	10 & 2-8 in sequence		.92		
EPD5CG010	C/Green	2&10	None	115	1.65	Right Atrial (RA)
EPD5JG010	J/Orange	2&10			2	
EPD6CG010	C/Green	2&10				
EPD6JG010	J/Orange	2&10				
EPD5AG010	A/Yellow	2&10	None	115	1.65	Right Ventricle (RV)
EPD6AG010	A/Yellow	2&10	None	115	2	
EPD5DG010	D/Blue	2&10	None	115	1.65	
EPD6DG010	D/Blue	2&10	None	115	2	
EPD5FG010	F/Black	2&10	None	115	1.65	Right Atrial (RA)
EPD6FG010	F/Black	2&10	None	115	2	
EPD5AJ005	A/Yellow	5&5-5-5-A	None	115	1.65	
EPD5AJ010	A/Yellow	5&10-10-10-B	None	115	1.65	
EPD6AJ005	A/Yellow	5&5-5-5-A	None	115	2	Right Ventricle (RV)
EPD6AJ010	A/Yellow	5&10-10-10-B	None	115	2	
EPD5CJ005	C/Green	5&5-5-5-A	None	115	1.65	
EPD5CJ010	C/Green	5&10-10-10-B	None	115	1.65	
EPD6CJ005	C/Green	5&5-5-5-A	None	115	2	His Bundle (HIS)
EPD6CJ010	C/Green	5&10-10-10-B	None	115	2	
EPD5DJ005	D/Blue	5&5-5-5-A	None	115	1.65	
EPD5DJ010	D/Blue	5&10-10-10-B	None	115	1.65	
EPD6DJ005	D/Blue	5&5-5-5-A	None	115	2	Right Atrial (RA)
EPD6DJ010	D/Blue	5&10-10-10-B	None	115	2	
EPD5FJ005	F/Black	5&5-5-5-A	None	115	1.65	
EPD5FJ010	F/Black	5&10-10-10-B	None	115	1.65	
EPD5FJ252	F/Black	5&2-5-2-C	None	115	1.65	Right Ventricle (RV)
EPD6FJ005	F/Black	5&5-5-5-A	None	115	2	
EPD6FJ010	F/Black	5&10-10-10-B	None	115	2	
EPD6FJ252	F/Black	5&2-5-2-C	None	115	2	
EPD5AI005	A/Yellow	5&5-5-5-A	One	115	1.65	Right Atrial (RA)
EPD5AI010	A/Yellow	5&10-10-10-B	One	115	1.65	
EPD6AI005	A/Yellow	5&5-5-5-A	One	115	2	
EPD6AI010	A/Yellow	5&10-10-10-B	One	115	2	
EPD5CI005	C/Green	5&5-5-5-A	One	115	1.65	

EPD5CI010	C/Green	5&10-10-10-B	One	115	1.65	
EPD6CI005	C/Green	5&5-5-5-A	One	115	2	
EPD6CI010	C/Green	5&10-10-10-B	One	115	2	
EPD5DI005	D/Blue	5&5-5-5-A	One	115	1.65	Right Ventricle (RV)
EPD5DI010	D/Blue	5&10-10-10-B	One	115	1.65	
EPD6DI005	D/Blue	5&5-5-5-A	One	115	2	
EPD6DI010	D/Blue	5&10-10-10-B	One	115	2	
EPD5FI005	F/Black	5&5-5-5-A	One	115	1.65	His Bundle (HIS)
EPD5FI010	F/Black	5&10-10-10-B	One	115	1.65	
EPD5FI252	F/Black	5&2-5-2-C	One	115	1.65	
EPD6FI005	F/Black	5&5-5-5-A	One	115	2	
EPD6FI010	F/Black	5&10-10-10-B	One	115	2	
EPD6FI252	F/Black	5&2-5-2-C	One	115	2	
EPD5DL0A5	D/Blue	6&5-A1-5	None	92	1.65	Right Ventricle-His Bundle (RV)-(HIS)
EPD5DL5A5	D/Blue	6&5-A1-5	None	115	1.65	
EPD6DL0A5	D/Blue	6&5-A1-5	None	92	2	
EPD6DL5A5	D/Blue	6&5-A1-5	None	115	2	
EPD5DL0B5	D/Blue	6&5-B1-5	None	92	1.65	Right Ventricle-Right Atrial (RV)-(RA)
EPD5DL5B5	D/Blue	6&5-B1-5	None	115	1.65	
EPD6DL0B5	D/Blue	6&5-B1-5	None	92	2	
EPD6DL5B5	D/Blue	6&5-B1-5	None	115	2	
EPD5DK0A5	D/Blue	6&5-A1-5	One	92	1.65	Right Ventricle-His Bundle (RV)-(HIS)
EPD5DK5A5	D/Blue	6&5-A1-5	One	115	1.65	
EPD6DK0A5	D/Blue	6&5-A1-5	One	92	2	
EPD6DK5A5	D/Blue	6&5-A1-5	One	115	2	
EPD5DK0B5	D/Blue	6&5-B1-5	One	92	1.65	Right Ventricle-Right Atrial (RV)-(RA)
EPD5DK5B5	D/Blue	6&5-B1-5	One	115	1.65	
EPD6DK0B5	D/Blue	6&5-B1-5	One	92	2	
EPD6DK5B5	D/Blue	6&5-B1-5	One	115	2	
EPD5DN0A5	D/Blue	8&5-A2-5	None	92	1.65	Right Ventricle-His Bundle (RV)-(HIS)
EPD5DN5A5	D/Blue	8&5-A2-5	None	115	1.65	
EPD6DN0A5	D/Blue	8&5-A2-5	None	92	2	
EPD6DN5A5	D/Blue	8&5-A2-5	None	115	2	
EPD5DN0B5	D/Blue	8&5-B2-5	None	92	1.65	Right Ventricle-Right Atrial (RV)-(RA)
EPD5DN5B5	D/Blue	8&5-B2-5	None	115	1.65	
EPD6DN0B5	D/Blue	8&5-B2-5	None	92	2	
EPD6DN5B5	D/Blue	8&5-B2-5	None	115	2	

EPD5DN0C5	D/Blue	8&5-C1-5	None	92	1.65	Right Ventricle-His Bundle-Right Atrial (RV)-(HIS)-(RA)
EPD5DN5C5	D/Blue	8&5-C1-5	None	115	1.65	
EPD6DN0C5	D/Blue	8&5-C1-5	None	92	2	
EPD6DN5C5	D/Blue	8&5-C1-5	None	115	2	
EPD5DN0D5	D/Blue	8&5-D-5	None	92	1.65	Coronary Sinus-Right Atrial (CS)-(RA)
EPD6DN0D5	D/Blue	8&5-D-5	None	92	2	
EPD5DN5D5	D/Blue	8&5-D1-5	None	115	1.65	Coronary Sinus-His Bundle (CS)-(HIS)
EPD6DN5D5	D/Blue	8&5-D1-5	None	115	2	
EPD5DM0A5	D/Blue	8&5-A2-5	One	92	1.65	Right Ventricle-His Bundle (RV)-(HIS)
EPD5DM5A5	D/Blue	8&5-A2-5	One	115	1.65	
EPD6DM0A5	D/Blue	8&5-A2-5	One	92	2	
EPD6DM5A5	D/Blue	8&5-A2-5	One	115	2	
EPD5DM0B5	D/Blue	8&5-B2-5	One	92	1.65	Right Ventricle-Right Atrial (RV)-(RA)
EPD5DM5B5	D/Blue	8&5-B2-5	One	115	1.65	
EPD6DM0B5	D/Blue	8&5-B2-5	One	92	2	
EPD6DM5B5	D/Blue	8&5-B2-5	One	115	2	
EPD5DM0C5	D/Blue	8&5-C1-5	One	92	1.65	Right Ventricle-His Bundle-Right Atrial (RV)-(HIS)-(RA)
EPD5DM5C5	D/Blue	8&5-C1-5	One	115	1.65	
EPD6DM0C5	D/Blue	8&5-C1-5	One	92	2	
EPD6DM5C5	D/Blue	8&5-C1-5	One	115	2	
EPD5DM0D5	D/Blue	8&5-D-5	One	92	1.65	Coronary Sinus-Right Atrial (CS)-(RA)
EPD6DM0D5	D/Blue	8&5-D-5	One	92	2	
EPD5DM5D5	D/Blue	8&5-D1-5	One	115	1.65	Coronary Sinus-His Bundle (CS)-(HIS)
EPD6DM5D5	D/Blue	8&5-D1-5	One	115	2	

← Steerable Curve Diagnostic Catheter 可撘式診斷導管

Specification	Curve/ color	Electrode Num. & Electrode spacing (mm)	Tip electrode	Length of shaft (cm)	Diameter of shaft (mm)	Recommend using site
EPD6DH252	D/Blue	4 & 2-5-2	None	115	2.0	RA/RV/HIS
EPD6DH005		4 & 5-5-5				
EPD6DH010		4 & 10-10-10				
EPD6DH282		10 & 2-8 in sequence				

報告案 2

全民健康保險已給付特材支付標準 異動之初核情形報告

共 77 項：(1)醫療器材許可證註銷及刪除品項 68 項/
第 2-1~2-10 頁；項次 1~68。(2)既有功能類別支付
點數異動 9 項/第 2-11~2-14 頁；項次 69~77。

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共68項(項次1~項次68,詳頁次2-1~2-10)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
1	CFE03ESXXXWH	"泰悟"食道支架 (基本型)	"Taewoong" Niti-S Esophageal Covered Stent(Basic)	(ES-16;18;20-06;08;10;12;15-F);(ES-22;24;28-18;23-F);(ES-16;18;20-06;08;10;12;15-B)	組	衛署醫器輸字第030101號	禾新醫療	產品型號已併至另一特材代碼CFE03EXXFDWH,故刪除原特材代碼。	月生效
2	FSP6100611ZQ	"舒法定"帕瑞挺 人工聚丙烯編網	"SOFRADIM" PARIETENE POLYPROPYLENE MESHES 06X11CM	PP0611X3	片	衛署醫器輸字第018040號	美敦力	產品型號已併至另一特材代碼FSP61106112C,故刪除原特材代碼。	月生效
3	FSP6101510ZQ	"舒法定"帕瑞挺 人工聚丙烯編網	"SOFRADIM" PARIETENE POLYPROPYLENE MESHES 15X10CM	PP1510X3	片	衛署醫器輸字第018040號	美敦力	產品型號已併至另一特材代碼FSP61106112C,故刪除原特材代碼。	月生效
4	FSP6101515ZQ	"舒法定"帕瑞挺 人工聚丙烯編網	"SOFRADIM" PARIETENE POLYPROPYLENE MESHES 15X15CM	PPL1515;(型號PP1515自981001起生效)	片	衛署醫器輸字第018040號	美敦力	廠牌及名稱變更,變更特材代碼,故取消原特材代碼。	108/04/01
5	FSP6103030ZQ	"舒法定"帕瑞挺 人工聚丙烯編網	"SOFRADIM" PARIETENE POLYPROPYLENE MESHES 30X30CM	PPL3030;(型號PP3030自981001起生效)	片	衛署醫器輸字第018040號	美敦力	廠牌及名稱變更,變更特材代碼,故取消原特材代碼。	108/04/01
6	FSP6110611ZQ	"舒法定"帕瑞挺 人工聚丙烯編網	"SOFRADIM" PARIETENE POLYPROPYLENE MESHES 6X11CM	PPL0611X3	片	衛署醫器輸字第018040號	美敦力	廠牌及名稱變更,變更特材代碼,故取消原特材代碼。	108/04/01
7	FSP6111510ZQ	"舒法定"帕瑞挺 人工聚丙烯編網	"SOFRADIM" PARIETENE POLYPROPYLENE MESHES 15X10CM	PPL1510X3	片	衛署醫器輸字第018040號	美敦力	廠牌及名稱變更,變更特材代碼,故取消原特材代碼。	108/04/01
8	FSP62TECRTZQ	"柯惠"舒法定帕瑞得人工編網:立體錐形塞編網	"COVIDIEN" SOFRADIM PARIETEX MESHES:PLUGS	TECRT8;TECRT6	組	衛署醫器輸字第017436號	美敦力	本特材代碼所含產品型號(TECRT8;TECRT6)均已註銷,故取消原特材代碼。	月生效

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共68項(項次1~項次68,詳頁次2-1~2-10)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
9	HHM01G146SM4	"美敦力"保護導線加上暫時阻斷吸除系統	"MEDTRONIC" GUARDWIRE PLUS TEMPORARY OCCLUSION AND ASPIRATION SYSTEM	G146-200;300-US;G145-200;300-US;GEZ5-200;300-US;GEZ6-200;300-US	EA	衛署醫器輸字第010292號	美敦力	產品停止販售,故取消給付。	月生效
10	CEE012000EJ6	"卡爾費森"無針輸注閥組及配件-無針輸注閥※適應症請見給付規定	"CAREFUSION" SMARTSITE NEEDLE FREE VALVE EXTENSION SETS AND COMPONENTS	2000E	個	衛署醫器輸字第019326號	必希	廠牌代碼變更,變更特材代碼,故取消原特材代碼。	108/04/01
11	CEE0120039J6	"卡爾費森"無針輸注閥組及配件-無針輸注閥延長管※適應症請見給付規定	"CAREFUSION" SMARTSITE NEEDLE FREE VALVE EXTENSION SETS AND COMPONENTS	20039E	個	衛署醫器輸字第019326號	必希	廠牌代碼變更,變更特材代碼,故取消原特材代碼。	108/04/01
12	CEE01S2000J6	"卡爾費森"無針輸注閥組及配件-無針輸注閥※適應症請見備註欄	"CAREFUSION" SMARTSITE NEEDLE FREE VALVE EXTENSION SETS AND COMPONENTS-NEEDLE FREE VALVE	2202E;2205E;20558E	個	衛署醫器輸字第019326號	必希	廠牌代碼變更,變更特材代碼,故取消原特材代碼。	108/04/01
13	CEE01S2019J6	"卡爾費森"無針輸注閥組及配件-無針輸注閥+多路延長管※適應症請見備註欄	"CAREFUSION" SMARTSITE NEEDLE FREE VALVE EXTENSION SETS AND COMPONENTS-NEEDLE FREE VALVE AND MULTIPLE WAY EXTENSION SETS	20019E;20038E;20061E;20062E	組	衛署醫器輸字第019326號	必希	廠牌代碼變更,變更特材代碼,故取消原特材代碼。	108/04/01

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共68項(項次1~項次68,詳頁次2-1~2-10)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
14	CEE01S2028J6	"卡爾費森"無針輸注閥組及配件-無針輸注閥+延長管(含DEHP)※適應症請見備註欄	"CAREFUSION" SMARTSITE NEEDLE FREE VALVE EXTENSION SETS AND COMPONENTS-NEEDLE FREE VALVE AND EXTENSION SETS(with DEHP)	20028E; 20519E; 30202E	個	衛署醫器輸字第019326號	必帝	廠牌代碼變更,變更特材代碼,故取消原特材代碼。	108/04/01
15	CEE01S2039J6	"卡爾費森"無針輸注閥組及配件-無針輸注閥+T型延長管※適應症請見備註欄	"CAREFUSION" SMARTSITE NEEDLE FREE VALVE EXTENSION SETS AND COMPONENTS- NEEDLE FREE VALVE AND EXTENSION SETS	20035E; 20041E; 20043E; 20049E; 20051E; 20053E	個	衛署醫器輸字第019326號	必帝	廠牌代碼變更,變更特材代碼,故取消原特材代碼。	108/04/01
16	FBSF1BAR121S	"賽恩司"脊椎連接系統:二節	"SCIEN" X" ISOBAR TTL VERTEBRAL CONNECTION SYSTEM	由以下特材代碼組合; FBSF2BAR2S1S; FBSF4BAR4S1S	SET	衛署醫器輸字第020555號	科舉	廠牌代碼變更,變更特材代碼,故取消原特材代碼。	108/04/01
17	FBSF1BAR131S	"賽恩司"脊椎連接系統:三節	"SCIEN" X" ISOBAR TTL VERTEBRAL CONNECTION SYSTEM	由以下特材代碼組合; FBSF2BAR2S1S; FBSF4BAR4S1S	SET	衛署醫器輸字第020555號	科舉	廠牌代碼變更,變更特材代碼,故取消原特材代碼。	108/04/01
18	FBSF2BAR2L1S	"賽恩司"脊椎連接系統:固定桿(長節)	"SCIEN" X" ISOBAR TTL VERTEBRAL CONNECTION SYSTEM: ROD	12TG55-110; 12TG55-130; 12TG55-230; 12TG55-400	EA	衛署醫器輸字第020555號	科舉	廠牌代碼變更,變更特材代碼,故取消原特材代碼。	108/04/01
19	FBSF2BAR2S1S	"賽恩司"脊椎連接系統:固定桿(短節)	"SCIEN" X" ISOBAR TTL VERTEBRAL CONNECTION SYSTEM: ROD	12TG55-045; 12TG55-055; 12TG55-065; 12TG55-075; 12TG55-085; 12TG55-095	EA	衛署醫器輸字第020555號	科舉	廠牌代碼變更,變更特材代碼,故取消原特材代碼。	108/04/01
20	FBSF4BAR4S1S	"賽恩司"脊椎連接系統:固定螺釘	"SCIEN" X" ISOBAR TTL VERTEBRAL CONNECTION SYSTEM: SCREW	12VTLP45-25; 12VTLP45-35; 12VTLP55-30; 12VTLP55-50; 12VTLP62-35; 12VTLP62-55; 12VTLP70-35; 12VTLP70-55	EA	衛署醫器輸字第020555號	科舉	廠牌代碼變更,變更特材代碼,故取消原特材代碼。	108/04/01

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共68項(項次1~項次68,詳頁次2-1~2-10)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
21	FBSFAPCBEV1S	"賽恩司"頸椎融合器-椎體鐵架+頸椎骨板一體成型(含PEEK CAGE 1支+TITANIUM PLATE 1支+SCREW 2支)	"SCIENT" X"PCB EVOLUTION CERVICAL PLATE CAGE	(11PCBH45;11PCBH55;11PCBH65;11PCBH75;11PCBH85)+(11VC40-12;11VC40-20;11VC45-12R;11VC45-14R;11VC45-16R;11VC45-18R)	組	衛署醫器輸字第020930號	科舉	廠牌代碼變更,變更特材代碼,故取消原特材代碼。	108/04/01
22	FBSFAPCBESH1S	"賽恩司"頸椎融合器(短型)-椎體鐵架+頸椎骨板一體成型(含PEEK CAGE 1支+TITANIUM PLATE 1支+SCREW 2支)	"SCIENT" X"SHORT HYBRID PCB PLATE-CAGE	(11PCBH45C;11PCBH55C;11PCBH65C;11PCBH75C;11PCBH85C)+(11VC40-12;11VC40-20;11VC40-21;11VC40-22;11VC45-12R;11VC45-14R;11VC45-16R;11VC45-18R)(11VC40-21;11VC40-22自105.11.01刪除)	組	衛署醫器輸字第022995號+020930號	科舉	廠牌代碼變更,變更特材代碼,故取消原特材代碼。	108/04/01
23	FBSFASAMRY1S	"賽恩司"莎美莉前路頸椎融合器	"SCIENT" X"ANTERIOR CAGE SAMARYS(PEEK)	11CC2A-17-5:10;-20-5:9;-C17-5:6(11CC2A-15-5S:10S;45S-C17-5S;6S;45S-17-5S:10S;45S-20-10;-20-5S:10S;45S自1001001生效)(11CC2AC17-7S:10S自105.11.01生效)	支	衛署醫器輸字第022419號	科舉	廠牌代碼變更,變更特材代碼,故取消原特材代碼。	108/04/01
24	SAU0282534TY	"優施西"生化可吸收性腸吻合環	"USS" VALTRAC DEVICES	8886808200:8886809200	組	衛署醫器輸字第010424號	美敦力	廠商因原產停產建議取消給付,故同意取消給付。	月生效
25	CDLP244513PM	"美敦力"腦脊髓液腰椎腹膜分流系統	"MEDTRONIC" LUMBOPERIT ONEAL SHUNT SYSTEM	44513:15	組	衛署醫器輸字第011362號	美敦力	本特材代碼所含產品型號(44513:15)均已註銷,故取消原特材代碼。	月生效

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共68項(項次1~項次68,詳頁次2-1~2-10)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
26	CDF0242104PM	"美敦力"腦脊髓液引流套組及附件:腦室腹腔分流術導管組附流速壓力控制閥	"MEDTRONIC" CSF FLOW CONTROL SHUNTS AND ACCESSORIES: C.S.F. FLOW CONTROL VALVE STANDARD	42102:6	組	衛署醫器輸字第009959號	美敦力	本特材代碼所含產品型號(42102:6)均已註銷,故取消原特材代碼。	月生效
27	CMV02KCFW4CK	"曲克"福雷色引導導管	"COOK" FLEXOR GUIDING CATHETERS	KCFW-4. 0:10/12. 0-18/35/38-;40/45/55/80/90/110-(RB選配)-(ANL0;ANL1;HFANL1;SHTL;RAABE;選配)-(HC選配)(自105年5月1日型號整併為KCFW-4. 0/5. 0/6. 0/7. 0/8. 0/9. 0/10. 0/12. 0-18/35/38-40/45/55/80/90/110-(RB選配)-(ANL0;ANL1;HFANL1;SHTL;RAABE選配)-(HC選配)	SET	衛署醫器輸字第018476號	曲克	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
28	CVA020TL0KTM	"泰爾茂"歐路克血管造影導管	"TERUMO" OUTLOOK ANGIOGRAPHIC CATHETER	RQ+4AL;5AL-1000;2000M;RQ+4JL;4JR;5JL;5JR3500;5000M;RQ+4TR;5TR3510;4010M;RQ+4SP;5SP-0081;0088M;RQ+4TIG;5TIG110M;RQ+4AR;4MG;5AP;5AR;5MG;1000;4581M	EA	衛署醫器輸字第024887號	泰爾茂	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
29	TSS01000011R	"羅氏"優勝血糖機組:羅氏優勝血糖試紙	ACCU-CHEK PERFORMA KIT: ACCU-CHEK PERFORMA TEST STRIPS	PERFORMA;(100片/盒100. 1. 1新增);(100片/盒100. 7. 1刪除)	片	衛署醫器輸字第019035號	羅氏	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
30	CLPA1501112A	"迪特適"內植輸液導管座及其附件	"DISTRICATH" IMPLANTABLE CATHETER PORTS AND ACCESSORIES	D-101;202;111;212-2800;D-101;111-2200;D-102;112-2000;D-201;211-3100;D-401;402;411-1700;D4122700	SET	衛署醫器輸字第025011號	永健	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
31	CLPA1501122A	"迪特適"內植輸液導管座及其附件	"DISTRICATH" IMPLANTABLE CATHETER PORTS AND ACCESSORIES	D-501;602;511;612-2800;D-501;511;121;503-2200;D-502;512;122-2000;D-601;611;604-3100;D-701;702;711;712;421;422-1700	SET	衛署醫器輸字第025011號	永健	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共68項(項次1~項次68,詳頁次2-1~2-10)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
32	CLPA1501132A	"迪特適"內植輸液導管座及其附件	"DISTRICATH" IMPLANTABLE CATHETER PORTS AND ACCESSORIES	KS-101;202;111;212-2800;KS-101;111-2200;KS-102;112-2000;KS-201;211-3100;KS-401;402;411;412-1700	SET	衛署醫器輸字第025011號	永健	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
33	CLPA1501142A	"迪特適"內植輸液導管座及其附件	"DISTRICATH" IMPLANTABLE CATHETER PORTS AND ACCESSORIES	KS-501;602;511;612-2800;KS-501;511;121-2200;KS-502;512;122-2000;KS-601;611-3100;KS-701;702;711;712;421;422;-1700	SET	衛署醫器輸字第025011號	永健	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
34	CLPA1501152A	"迪特適"內植輸液導管座及其附件	"DISTRICATH" IMPLANTABLE CATHETER PORTS AND ACCESSORIES	KP-101;202;111;212-2800;KP-101;111-2200;KP-102;112-2000;KP-201;211-3100;KP-401;402;411;412-1700	SET	衛署醫器輸字第025011號	永健	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
35	CLPA1501162A	"迪特適"內植輸液導管座及其附件	"DISTRICATH" IMPLANTABLE CATHETER PORTS AND ACCESSORIES	KP-501;602;511;612-2800;KP-501;511;121-2200;KP-502;512;122-2000;KP-601;611-3100;KP-701;702;711;712;421;422-1700;D5141000;D5130450	SET	衛署醫器輸字第025011號	永健	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
36	WBB08020402B	"瑪迪安納"樹脂石膏繃帶(未滅菌):聚酯纖維/2"×4Y	"MEDIANA" CASTING TAPE (NON-STERILE):POLYESTER CAST TAPE/2"×4Y	MC0021	EA	衛署醫器輸字第013052號	宇盛	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
37	WBB08030402B	"瑪迪安納"樹脂石膏繃帶(未滅菌):聚酯纖維/3"×4Y	"MEDIANA" CASTING TAPE (NON-STERILE):POLYESTER CAST TAPE/3"×4Y	MC0031	EA	衛署醫器輸字第013052號	宇盛	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
38	WBB08040402B	"瑪迪安納"樹脂石膏繃帶(未滅菌):聚酯纖維/4"×4Y	"MEDIANA" CASTING TAPE (NON-STERILE):POLYESTER CAST TAPE/4"×4Y	MC0041	EA	衛署醫器輸字第013052號	宇盛	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共68項(項次1~項次68,詳頁次2-1~2-10)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
39	WBB08050402B	"瑪迪安納"樹脂石膏繃帶(未滅菌):聚酯纖維/5"x4Y	"MEDIANA" CASTING TAPE (NON-STERILE):POLYESTER CAST TAPE/5"x4Y	MC0051	EA	衛署醫器輸壹字第013052號	宇盛	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
40	WBB08204002B	"瑪迪安納"樹脂石膏繃帶(未滅菌):玻璃纖維	"MEDIANA" Casting Tape (Non-Sterile):FIBERGLASS CAST TAPE	MC0021	卷	衛署醫器輸壹字第013052號	宇盛	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
41	WBB08304002B	"瑪迪安納"樹脂石膏繃帶(未滅菌):玻璃纖維	"MEDIANA" Casting Tape (Non-Sterile):FIBERGLASS CAST TAPE	MC0031	卷	衛署醫器輸壹字第013052號	宇盛	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
42	WBB08404002B	"瑪迪安納"樹脂石膏繃帶(未滅菌):玻璃纖維	"MEDIANA" Casting Tape (Non-Sterile):FIBERGLASS CAST TAPE	MC0041	卷	衛署醫器輸壹字第013052號	宇盛	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
43	WBB08504002B	"瑪迪安納"樹脂石膏繃帶(未滅菌):玻璃纖維	"MEDIANA" Casting Tape (Non-Sterile):FIBERGLASS CAST TAPE	MC0051	卷	衛署醫器輸壹字第013052號	宇盛	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
44	CBS04D1400WE	"百歐森偉伯司特"摩比卡斯心房中隔穿刺針(輔助電燒導管)	"BIOSENSE WEBSTER" MOBICATH TRANSSEPTAL NEEDLE	D140001:D140003;D140005:D140006	SET	衛署醫器輸壹字第024896號	壯生	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
45	CEE01NFA012U	"佳承"輸液點滴套-無針式接頭	"CHIA CHERNE" I. V. ADMINISTRATION SET/ NEEDLELESS FEMALE ADAPTOR	MD02-03	個	衛署醫器製字第004080號	佳承	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
46	CLS04MS1002U	"佳承"輸液點滴套(免針型)	"CHIA CHERNE" I. V. Administration Set	MD02-10	SET	衛署醫器製字第004080號	佳承	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共68項(項次1~項次68,詳頁次2-1~2-10)

項次	特材代碼	特材中文名	特材英文名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
47	CLS04MS1202U	"佳承"輸液點滴套(免針型)	"CHIA CHERNE" I. V. Administration Set	MD02-12	SET	衛署醫器製字第004080號	佳承	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
48	CLS04MS1502U	"佳承"輸液點滴套	"CHIA CHERNE" I. V. Administration Set	MD02-02	SET	衛署醫器製字第004080號	佳承	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
49	CLS04MV1002U	"佳承"輸液點滴套(一般型)	"CHIA CHERNE" I. V. Administration Set	MD02-09	個	衛署醫器製字第004080號	佳承	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
50	CLS04MV1202U	"佳承"輸液點滴套(一般型)	"CHIA CHERNE" I. V. Administration Set	MD02-11	個	衛署醫器製字第004080號	佳承	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
51	CLS04MV1502U	"佳承"輸液點滴套	"CHIA CHERNE" I. V. Administration Set	MD02-01	SET	衛署醫器製字第004080號	佳承	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
52	CB01VTRI4AB	"亞培"懷維克周邊血管擴張導管	"ABBOTT" VIATRAC 14 PLUS PERIPHERAL DILATATION CATHETER	1008189;1008202	EA	衛署醫器輸字第024976號	亞培	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
53	BBP0411210LK	"福立克"可樂適造口術用袋及其附件(未滅菌):單片式便袋(含人工皮+不織布)	"FLEXICARE" COLOSET OSTOMY BAG AND ACCESSORIES (NON-STERILE) :1 PCS CLOSED BAG, NON WOVEN BACKING	00-911-210U;00-912-210U;00-931-210U;00-932-210U	EA	衛署醫器輸字第012993號	彩順	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
54	TKP04B20032N	"捷太"巴隆乳房定位針	"GTA" BALON BREAST LOCALIZATION NEEDLE(NEEDLE+WIRED)	(B0;B0S;BOX;BAL;BALS;BALX-2003;2005;2007;2010;2015;2103;2105;2107;2110;2115	EA	衛署醫器輸字第013007號	捷太	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
55	CRT01U0025ZG	"富齡"氣切管	"ALLY" TRACHEOSTOMY TUBE	TC25;TC30;TC35;TC40;TC45;TC50;TC55	EA	衛署醫器製字第002469號	富齡	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
56	CRT02C0060ZG	"富齡"氣切管	"ALLY" TRACHEOSTOMY TUBE	TC60C;TC65C;TC70C;TC75C;TC80C;TC85C;TC90C	EA	衛署醫器製字第002469號	富齡	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
57	HHM01Q5070VS	"法斯樂舒順"快速血栓清除導	"VASCULAR SOLUTIONS" QXT EXTRACTION CATHETER	5070	EA	衛署醫器輸字第018844號	揚通	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共68項(項次1~項次68,詳頁次2-1~2-10)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商名稱	核價說明	生效日期
58	CLS0560103J6	"卡爾費森"輸液套(含量筒附無針式接頭二個)	"CAREFUSION" ALARIS GP INFUSION SETS(WITH BURETTE, 2*NEEDLE-FREE VALVE PORT)	60103E	SET	衛署醫器輸字第025032號	必帝	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
59	CLS0563200J6	"卡爾費森"輸液套	"CAREFUSION" ALARIS GP INFUSION SETS	63110V;63200NY	SET	衛署醫器輸字第025032號	必帝	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
60	CLS0563401J6	"卡爾費森"輸液套(含無針式接頭一個)	"CAREFUSION" ALARIS GP INFUSION SETS(WITH 1*NEEDLE-FREE VALVE PORT)	63401E	SET	衛署醫器輸字第025032號	必帝	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
61	CLS0563420J6	"卡爾費森"輸液套(含無針式接頭二個)	"CAREFUSION" ALARIS GP INFUSION SETS(WITH 2*NEEDLE-FREE VALVE PORT)	63420E	SET	衛署醫器輸字第025032號	必帝	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
62	CLS0863477J6	"卡爾費森"輸液套(輸血套組,附無針式接頭I個)	"CAREFUSION" ALARIS GP INFUSION SETS(BLOOD SET, LSS VLV)	63477E	SET	衛署醫器輸字第025032號	必帝	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
63	FALSNAVE2HY	"豪雅"植入器預載單片式非球面黃色人工水晶體:非球面軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"HOYA" ISERT PRELOADED IOL	MODEL 251	EA	衛署醫器輸字第025019號	瑞宏	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
64	TSS01STP1AJY	歐姆龍血糖試片二代	OMRON BLOOD GLUCOSE TEST STRIP	HGM-STP1A-10;HGM-STP1A-25;HGM-STP1A-50;HGM-STP1A	片	衛署醫器製字第004039號	達爾生技	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共68項(項次1~項次68,詳頁次2-1~2-10)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
65	CEP0111507BB	"柏朗"高壓連接管(雙層):1200PSI	"B. BRAUN" ANGIODYN HIGH PRESSURE TUBINGS	05011507;515;523;531	EA	衛署醫器輸字第008716號	柏朗	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
66	FPP0701526M4	"美敦力"顱骨固定系統:顯微梅花型骨板系統(骨板x1+骨釘x6)	"MEDTRONIC"TIMESH CRANIAL FIXATION SYSTEM:MICRO BURR HOLE PLATE SYSTEM(PLATEx1+SCREWx6)	015-260.14;18;015040;9001640	EA	衛署醫器輸字第017963號+023042號	美敦力	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
67	CBC02MP628F2	"英泰克"瑪瑞斯自膨式週邊血管支架系統(腸骨血管支架)	"INVATEC"MARIS PERIPHERAL SELF-EXPANDING STENT SYSTEM	IMP060020080;IMP120080080;IMP060020120;IMP070120120;IMP-08:10-0040120;0060120;0080120	SET	衛署醫器輸字第018905號	美敦力	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01
68	CBC04MAR1SF2	"英泰克"瑪瑞斯自膨式週邊血管支架系統(淺股動脈血管支架)	"INVATEC"MARIS PERIPHERAL SELF-EXPANDING STENT SYSTEM	IMP060020080;IMP120080080;IMP060020120;IMP070120120;IMP-080:100-040120;080120	SET	衛署醫器輸字第018905號	美敦力	許可證逾期,故取消給付。	107/10/01

二、核價類別變更及價格調整品項共9項(項次69~項次77,詳頁次2-11~2-14)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商 簡稱	原核價類別	初核變更之核 價類別	核價說明	給付 規定	生效 日期
69	CEE01NET11Q4	"尼得立斯"延長 管(免針一代單 路、T型、Y型)	"Needleless" Extension Tube	NET101;102;109;110;111	組	衛部醫器製字 第005482號	尼得立 斯	無針式接頭+ 延長管/EA	無針式接頭+ 延長管(含T型 Y型)/不含 DEHP+與脂質 相容	依醫療器材許可證變更功能類別,自 (無針式接頭+延長管/EA)變更為 (無針式接頭+延長管(含T型Y型)/不 含DEHP+與脂質相容),並依同功能 類別(如CEE0110656LL)調整支付點 數及訂定給付規定(1301-3)。	1301-3	108/04/01
70	CEE01NVN10Q4	"尼得立斯"延長 管(免針一代輸液 接頭)	"Needleless" Extension Tube	IVN101;IVN102	個	衛部醫器製字 第005482號	尼得立 斯	無針式接頭 /EA	無針式接頭/ 不含DEHP+與 脂質相容	依醫療器材許可證變更功能類別,自 (無針式接頭/EA)變更為(無針式接 頭/不含DEHP+與脂質相容),並依同 功能類別(如ACA01NF0055LL)調整支 付點數及訂定給付規定(1301-3)。	1301-3	108/04/01
71	CEE01NVS11Q4	"尼得立斯"計量 點滴輸液套-免針 一代Y型	"Needleless" Administration Set	IVS101;102;201;202	組	衛部醫器製字 第005721號	尼得立 斯	無針式接頭+ 延長管/EA	無針式接頭+ 延長管(含T型 Y型)/不含 DEHP+與脂質 相容	依醫療器材許可證變更功能類別,自 (無針式接頭+延長管/EA)變更為 (無針式接頭+延長管(含T型Y型)/不 含DEHP+與脂質相容),並依同功能 類別(如CEE01NFEYSLL)調整支付點 數及訂定給付規定(1301-3)。	1301-3	108/04/01

報告案第2案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

二、核價類別變更及價格調整品項共9項(項次69~項次77,詳頁次2-11~2-14)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	原核價類別	初核變更之核價類別	核價說明	給付規定	生效日期
72	FBSFIDMP2NXA	"全合"星光脊椎固定系統/二節(免事前審查)	"axter" Star Spinal System/(R*2+S*4)	DR-55040:DR-55100:DMP;DMPL-3510:3550:DMP;DMPL-4010:4050:DMP;DMPL-4515:4555:DMP;DMPL-5015:5055:DMP;DMPL-5520:5560:DMP;DMPL-6020:6060:DMP;DMPL-6525:6565:DMP;DMPL-7025:7065:DMP;DMPL-7530:7570:DMP;DMPL-8030:8070(DPP;DPPL-3510:3550:DPP;DPPL-4010:4050:DPP;DPPL-4515:4555:DPP;DPPL-5015:5055:DPP;DPPL-5520:5560:DPP;DPPL-6020:6060:DPP;DPPL-6525:6565:DPP;DPPL-7025:7065:DPP;DPPL-7530:7570:DPP;DPPL-8030:8070自1061101生效)(FBSF4DMP1NXA+FBSF2DMPR1XA自1071101生效)	組	衛部醫器製字第005383號	全合生醫	TITANIUM SPINAL SYSTEM 二節 (SCREW4+ROD X2)	TITANIUM SPINAL PLATE SYSTEM二節 (免事前審查)	依醫療器材許可證變更功能類別,自(TITANIUM SPINAL SYSTEM 二節 (SCREW4+ROD X2))變更為(TITANIUM SPINAL PLATE SYSTEM二節(免事前審查)),並依同功能類別(如FBSF11004LXP)調整支付點數。	無	107/11/01

報告案第2案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

二、核價類別變更及價格調整品項共9項(項次69~項次77,詳頁次2-11~2-14)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商名稱	原核價類別	初核變更之核價類別	核價說明	給付規定	生效日期
73	FBSF1DMP3NXA	"全合"星光脊椎固定系統/三節(免事前審查)	"Aaxter" Spinal System(R*2+S*6)	DR-55040:DR-55100;DMP;DMPL-3510;3550;DMP;DMPL-4010;4050;DMP;DMPL-4515;4555;DMP;DMPL-5015;5055;DMP;DMPL-5520;5560;DMP;DMPL-6020;6060;DMP;DMPL-6525;6565;DMP;DMPL-7025;7065;DMP;DMPL-7530;7570;DMP;DMPL-8030;8070(DPP;DPPL-3510;3550;DPP;DPPL-4010;4050;DPP;DPPL-4515;4555;DPP;DPPL-5015;5055;DPP;DPPL-5520;5560;DPP;DPPL-6020;6060;DPP;DPPL-6525;6565;DPP;DPPL-7025;7065;DPP;DPPL-7530;7570;DPP;DPPL-8030;8070自1061101生效)(FBSF4DMP1NXA+FBSF2DMP1XA自1071101生效)	組	衛部醫器製字第005383號	全合生醫	TITANIUM SPINAL SYSTEM 三節 (SCREWx6+ROD X2)	TITANIUM SPINAL PLATE SYSTEM三節 (免事前審查)	依醫療器材許可證變更功能類別,自(TITANIUM SPINAL SYSTEM 三節 (SCREWx6+RODx2))變更為(TITANIUM SPINAL PLATE SYSTEM三節 (免事前審查)),並依同功能類別(如FBSF11005LXP)調整支付點數。	無	107/11/01
74	FBSF2DMP1XA	"全合"星光脊椎固定系統:連接桿(短節)(免事前審查)	"AAXTER" STAR SPINAL SYSTEM; ROD 40-105MM	DR-55040:DR-55100(DR-55040:DR-55105自1071101生效)	支	衛部醫器製字第005383號	全合生醫	TITANIUM SPINAL ROD OR PLATE(短節)	TITANIUM SPINAL ROD(短節 <110MM)(免事前審查)	依醫療器材許可證變更功能類別,自(TITANIUM SPINAL ROD OR PLATE(短節))變更為(TITANIUM SPINAL ROD(短節 <110MM)(免事前審查)),並依同功能類別(如FBSF216001XP)調整支付點數。	無	107/11/01
75	FBSF2DMPR2XA	"全合"星光脊椎固定系統:連接桿(長節)(免事前審查)	"AAXTER" STAR SPINAL SYSTEM; LONG ROD 110-600MM	DR-55105:DR-55600(DR-55110:DR-55600自1071101生效)	支	衛部醫器製字第005383號	全合生醫	TITANIUM SPINAL ROD(長節)	TITANIUM SPINAL ROD(長節 110MM (含)以上)(免事前審查)	依醫療器材許可證變更功能類別,自(TITANIUM SPINAL ROD(長節))變更為(TITANIUM SPINAL ROD(長節 110MM (含)以上)(免事前審查)),並依同功能類別(如FBSF216002XP)調整支付點數。	無	107/11/01

報告案第2案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

二、核價類別變更及價格調整品項共9項(項次69~項次77,詳頁次2-11~2-14)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	原核價類別	初核變更之核價類別	核價說明	給付規定	生效日期
76	FBSF4DMPINXA	"全合"星光脊椎固定系統/椎弓螺釘(免事前審查)	"Aaxter" Star Spinal System/Pedicle Screw	DMP; DMPL-3510; 3550; DMP; DMPL-4010; 4050; DMP; DMPL-4515; 4555; DMP; DMPL-5015; 5055; DMP; DMPL-5520; 5560; DMP; DMPL-6020; 6060; DMP; DMPL-6525; 6565; DMP; DMPL-7025; 7065; DMP; DMPL-7530; 7570; DMP; DMPL-8030; 8070(DPP; DPPL-3510; 3550; DPP; DPPL-4010; 4050; DPP; DPPL-4515; 4555; DPP; DPPL-5015; 5055; DPP; DPPL-5520; 5560; DPP; DPPL-6020; 6060; DPP; DPPL-6525; 6565; DPP; DPPL-7025; 7065; DPP; DPPL-7530; 7570; DPP; DPPL-8030; 8070自1061101生效)	支	衛部醫器製字第005383號	全合生醫	TITANIUM SPINAL SCREW	TITANIUM SPINAL SCREW(免事前審查)	依醫療器材許可證變更功能類別,自(TITANIUM SPINAL SCREW)變更為(TITANIUM SPINAL SCREW(免事前審查)),並依同功能類別(如FBSF411061XP)調整支付點數。	無	107/11/01
77	FBSF5DMPCNXA	"全合"星光脊椎固定系統:橫向連接鉤組(免事前審查)	"AAXTER" STAR SPINAL SYSTEM: CROSS LINK HOOK	UHC1115; USI0804; URC-0305; 0312; NDC; NAC-5555; 5560; 6060; NLC-5520; 5525; 5530; 6020; 6025; 6030	組	衛部醫器製字第005383號	全合生醫	TITANIUM SPINAL CROSSLINK	TITANIUM SPINAL CROSSLINK(免事前審查)	依醫療器材許可證變更功能類別,自(TITANIUM SPINAL CROSSLINK)變更為(TITANIUM SPINAL CROSSLINK(免事前審查)),並依同功能類別(如FBSF517021XP)調整支付點數。	無	107/11/01

報告案 3

106 及 107 年起收載新功能類別特材申報情形報告案。

報告案第3案 106年起收載新功能特材申報情形報告案

項次	生效日期	新功能特材中文品名	單位	新機能特材支付點數A	被替代品項核價類別中文	年替代率B	新功能特材財務推估				新機能特材生效日起106年申報數(截至10707)	新機能特材生效日起107年申報數(截至10707)	新機能特材生效日起106年實際申報數(截至10707)	新機能特材生效日起107年實際申報數(截至10707)				
							被替代品項前1年使用量C	預估新功能特材年使用量E=B*C	被替代品項支付點數Re	推估增加財務支出F=(A-Re)*E(千點)					申報使用量G(千點)	申報使用量I(千點)	F=(A-Re)*G(千點)	F=(A-Re)*I(千點)
1	106/1/1	"東麗"安適龍導管	條	24,000	無		600	14,400	253	6,376	112	2,819	6,072	2,688				
2		"美敦力"康豪特心臟再同步節律器(具監測早期肺積水)	個	207,262	心房同步雙心室節律器ATRIAL SYNCHRONOUS BIVENTRICULAR PACING DEVICE		200	180,228	5,407									
3	106/2/1	"彼娜波"彼娜波系統(再灌流導管5MAXACE)	條	92,222	顱內血管支架取栓裝置	100%	200	300	468	200	436	92,222	331	30,572	449	41,417	12,081	30,618
4		"彼娜波"彼娜波系統(再灌流導管3MAX或4MAX)	條	40,100	顱內血管支架取栓裝置	100%			40,100			155	6,232	215	8,624			3,930
5		"彼娜波"彼娜波系統(抽吸管+腔液導套組)	組	4,010	顱內血管支架取栓裝置	100%			4,010			88	371	110	463			
【說明】 1. 顱內血管支架取栓裝置(支付點數136,332點)之預估使用量，係依專家建議200組計算。 2. 前開特材自105年2月1日實施，統計2-12月申報量為300組，106年全年為468組。 【計算說明】 1. 項式3-5(組件)之功能與顱內血管支架取栓裝置(整組)類似，僅設計不同，均用於腦中風病人，爰使用量已含於顱內血管支架取栓裝置200組內。 2. 惟組件項式3之106年2-12月實際申報數，已超過原預估量200組，爰項式3之申報量改以106年全年預估申報量及成長率5.97% (102-106年健保特材申報量之年均成長率)複利計算之110年預估申報量436組計算。 【計算說明】 組件項式3之106年申報數已超過原預估量200組，爰推估增加財務支出改以A*(E-200)計算。 【計算說明】 組件項式3及4之106年申報數已超過107年申報數已超過原預估量200組，爰實際申報數改以A*(I-200/12*7)計算。																		

報告案第3案 106年起收載新功能特材申報情形報告案

報告表第5案 100年心收戰劑力胎付付 報用心帳目示																		
項次	生效日期	新功能特材中文品名	單位	新功能特材支付點數A	新功能特材財務預估				新功能特材106年申報數				新功能特材107年實際申報數(截至10707)					
					被替代品項核價額列中文	年替代率B	被替代品項前1年使用量C	被替代品項預估新功能特材年使用量E=B*C	被替代品項支付點數Re	預估增加財務支出F=(A-Re)*E(千點)	申報使用量G	申報點數H(千點)	申報使用量I	申報點數J(千點)				
6	106/3/1	"美德思"管路組(ECMO長效型人工心肺套合OXYGENATOR+PUMP HEAD+TUBING SET+CUVETTE+TRANSDUCER *3+1V SET)	組	57,071	長效型人工心肺W/PUMP HEAD+TUBING SET(ECMO)+TRANSDUCER+CUVETTE	10%	2,100	210	51,883	1,089	16	913	36	2,043	83			F=(A-Re)*I(千點)
7	106/4/1	"柏朗"培養箱網片	組	4,940	人工網膜/不可吸收性/3D(小至特大)	100%	3,680	3,680	3,800	4,195	3	16	19	99	3			
8		"巴德"珀非斯經質型網塞	組	4,940	人工網膜/不可吸收性/3D(小至特大)				3,800		444	2,303	330	1,713	506			
9		"愛惜康"優全補網塞	組	4,940	人工網膜/不可吸收性/3D(小至特大)				3,800		53	275	76	394	60			
10	106/5/1	"美敦力"必易人工聽小骨	組	7,829	人工耳骨活塞	100%	50	191	2,031	1,397	84	690	74	608	487			
11		"葛雷斯"經骨置換物	組	7,829	人工耳骨活塞						16	132	12	99	93			
【計算說明】 考量專家建議之50組，低於106年5-12月實際申報數，爰改以106年全年預估申報量及成長率5.97% (102-106年健康保特材申報量之年均成長率) 獲利計算之110年預估申報量191組計算。 【計算說明】 預估申報數191組中，50組為替代使用，141組惟新增使用，爰推估增加財務支出改以(A-F)*C+H*(E-C)計算。																		
12		"葛雷斯"全人工聽小骨置換物	組	6,263	人工耳骨活塞	100%	60	240	2,599	220	34	224	28	184	125			
13		"美敦力"耳用人工聽骨	組	6,710	人工耳骨活塞			240	3,500	770	10	70	11	78	32			
14		"葛雷斯"部分人工聽小骨置換物	組	6,710	人工耳骨活塞				3,500		109	768	88	620	350			
15		"美敦力"通用型耳用網補物	組	6,710	人工耳骨活塞				3,500		-	-	-	-	-			

報告案第3案 106年起收載新功能特材申報情形報告案

項次	生效日期	新功能特材 中文品名	單價	新功能特材 支付點數 A	新功能特材 財務推估	被替代品項 核價類別中文	年替代 率 B	被替代品項 前1年使用 量 C	被替代品項 預估新功能特材年使 用量 E=B*C	被替代品項支 付點數 Re	推估增加財務 支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使 用量 G	申報點 數 H (千點)	申報使 用量 I	申報點 數 J (千點)	新功能特材 生效日起 107年申報數 (截至10707)	新功能特材 生效日起 106年實際申報數 (截至10707)	新功能特材 生效日起 107年實際申報數 (截至10707)	F=(A-Re)*I (千點)
【計算說明】																			
專家建議全部及部分 聽小青年使用量約300 組																			

報告案第3案 106年起收載新功能特材申報情形報告案

項次	生效日期	新功能特材中文品名	單位	新功能特材支付點數A	新功能特材財務推估				新功能特材106年申報數				新功能特材107年申報數(截至10707)				新功能特材106年實際申報數		新功能特材107年實際申報數(截至10707)	
					被替代品項核價類別中文	年替代率B	被替代品項前1年使用量C	預估新功能特材年使用量E=B*C	被替代品項支付點數Re	推估增加財務支出F=(A-Re)*E(千點)	申報使用量G	申報點數H(千點)	申報使用量I	申報點數J(千點)	F=(A-Re)*G(千點)	F=(A-Re)*J(千點)				
16	106/6/1	"柯惠"亞羅胸腔引流瓶(滅菌)	個	3,010	可攜式抽吸器具(全密閉式抽取引流袋)	50%	2,190	657	1,316	1,113	116	367	92	291	197	156				
【計算說明】 專家表示可攜式之抽吸器具(滅菌)(全密閉式引流袋/全密閉式引流管)約50%會改用項次16及項次53，而兩者使用比率為6:4。 【計算說明】 以全密閉式抽吸器具(滅菌)點數1,820點及全密閉式引流袋支付點數812點之平均點數1,316計算。																				
17	106/7/1	"可立耳"人工耳蝸植入物	組	334,409	無		277		92,631		8	2,675	25	8,360	2,675	8,360				
18		"可立耳"人工耳蝸植入物	組	334,409	無						76	25,415	115	38,457	25,415	38,457				
19		"艾德尼斯"人工電子耳	組	334,409	無						-	-	-	-	-	-				
20		"艾德尼斯"人工電子耳	組	334,409	無						18	6,019	49	16,386	6,019	16,386				
21		"美樂迪"人工電子耳	組	334,409	無						-	-	-	-	-	-				
22		"美樂迪"人工電子耳	組	334,409	無						7	2,341	29	9,698	2,341	9,698				
【計算說明】 考量專家建議之153組，低於106年全年預估申報量，爰改以106年全年申報量及成長率5.97%複利計算之110年預估申報量277組計算。																				

報告案第3案 106年起收載新功特材申報情形報告案

項次	生效日期	新功特材中文品名	新功特材單位	新功特材支付點數A	新功特材財務推估					新功特材106年申報數		新功特材107年申報數(截至10707)		新功特材生效日起106年實際申報數	新功特材生效日起107年實際申報數(截至10707)
					被替代品項核價類別中文	年替代率B	被替代品項前1年使用量C	預估新功特材年使用量D=B*C	被替代品項支付點數Rc	推估增加財務支出F=(A-Re)*E(千點)	申報使用量G	申報點數H(千點)	申報使用量I		
23	106/7/1	"艾德尼斯"尼普頓聲音處理器	組	265,664	無			274		72,792	1	266	1	266	266
24		"艾德尼斯"聲音處理器	組	265,664	無						16	4,251	48	12,752	4,251
25		"可立耳"人工耳蝸植入系統-語言處理器	組	265,664	無						84	22,316	141	37,459	22,316
26		美樂迪聲音處理器	組	265,664	無						-	-	-	-	-
27		美樂迪聲音處理器	組	265,664	無						7	1,860	29	7,704	1,860
28		"美樂迪"語言處理器	組	265,664	無						-	-	-	-	-

【計算說明】
考量專家建議之153組，低於106年全年預估申報量，爰改以106年全年申報量及成長率5.97%複利計算之110年預估申報量274組計算。

報告案第3案 106年起收載新功能特材申報情形報告案

項次	生效日期	新功能特材 中文品名	新功能特材 單位	新功能特材 支付點數 A	新功能特材 財務報告				新功能特材 申報情形				新功能特材 生效日期 106年實際申報數	新功能特材 生效日期 107年實際申報數 (截至10707)
					被替代品項 核價類別中文	年替代 率 B	被替代品項 前1年使用 量 C	預估新功能特材年使 用量 E=B×C	被替代品項支 付點數 Re	推估增加財務 支出 F=(A-Re)×E (千點)	申報使 用量 G	申報點 數 H (千點)	申報使 用量 I	申報點 數 J (千點)
29	106/7/1	壹萊司亞洲金屬鎖定骨釘 骨板系統鎖-硬質骨全螺 紋式螺釘/埋頭中空加壓 骨釘(2.8-4.1mm)	支	12,000	無		934	731	8,772	16	202	57	716	684
30		"瑞德"達非小骨釘-埋頭 中空加壓骨釘	支	12,000	無					23	290	62	778	744
31		"瑞德"達凡小骨釘-埋頭 中空加壓骨釘	支	12,000	無					15	189	12	151	144
32		"史麥克雷實格爾"中空加 壓骨釘系統(埋頭骨釘)	支	12,000	無					5	63	4	50	48
【計算說明】 考量原預估申報量467 支(以同時申報修換項 目64035C及類似功能 特材估算),低於106 年全年預估申報量, 爰改以106年全年申報 量及成長率5.97%獲利 計算之110年預估申報 量731組計算。														
33	106/8/1	"信迪思"中空加壓骨釘系 統-埋頭骨釘(1.5-4.5mm)	支	12,000	無					179	2,252	236	2,970	2,832
34		"瑞德"夏勒足踝骨釘骨板 系統-埋頭中空加壓骨釘 (3.0-4.3mm)	支	12,000	無					38	479	33	414	396
35		"歐特美"中空加壓骨螺釘 系統-埋頭骨釘(2.0- 4.0mm)	支	12,000	無					-	-	-	-	-
36		"瑞德"夏羅特足踝固定系 統-埋頭中空加壓骨釘 (3.0-4.3mm)	支	12,000	無					13	164	17	208	204
37		"瑞德"達扣鎖式骨板系 統-埋頭中空加壓骨釘 (3.2-4.3mm)	支	12,000	無					-	-	-	-	-

報告案第3案 106年起收載新功能特材申報情形報告案

項次	生效日期	新功能特材中文品名	單位	新功能特材支付點數A	新功能特材財務推估					新功能特材106年申報數				新功能特材107年申報數(截至10707)				新功能特材106年實際申報數				新功能特材107年實際申報數(截至10707)																
					被替代品項核價額別中文	年替代率B	被替代品項前1年使用量C	預估新功能特材年使用量E=B*C	推估增加財務支出F=(A-Re)*E(千點)	申報使用量G(千點)	申報點數H(千點)	申報使用量I(千點)	申報點數J(千點)	申報使用量G(千點)	申報點數H(千點)	申報使用量I(千點)	申報點數J(千點)	申報使用量G(千點)	申報點數H(千點)	申報使用量I(千點)	申報點數J(千點)																	
																				104年申報量	105年申報量	106年申報量																
38	106/8/1	"鉸鎖鎖"安普拉茲托非遞送導管系統含推進導管(尿管)	條	12,000	(ASD)SEPTAL OCCLUDER-DELIVERY SYSTEM	100%	695	639	697	【計算說明】另列核價額別，不影響財務支出。	12,000	639	-																									
39		"鉸鎖鎖"安普拉茲尿管心室閉器(尿管)	個	121,679	心室中隔缺損閉器(尿管)Occluder	100%	8	1	7	121,679	44	5,354	76	9,254	4,380	8,639					【計算說明】考量項次40之107年申報數，高於替代品項近3年最高使用量(8條)，爰實際申報數改以A*(1-8/12*7)計算。																	
40		"先健科技公司"赫特爾心室閉器(尿管)	個	121,679	心室中隔缺損閉器(尿管)Occluder	100%																																
41		愛派司金屬固定骨釘骨板系統組-股骨爪型骨板(髖線夾縮器)	個	5,207	STAINLESS CABLE GRIP(夾縮器)	100%	90	90	90	4,528	61	5	-																									
42		愛派司金屬固定骨釘骨板系統組-髖線(钛合金)	條	1,414	STAINLESS CABLE GRIP(夾縮器)	100%	1,765	1,765	1,765	1,230	325	27	40	33	5	6																						

報告案第3案 106年起收載新功能特材申報情形報告案

項次	生效日期	新功能特材中文品名	單位	新機能特材支付點數A	新功能特材財務報告				新功能特材106年申報數		新功能特材107年申報數		新功能特材106年實際申報數		新功能特材107年實際申報數	
					被替代品項核價類別中文	年替代率B	被替代品項前1年使用量C	預估新功能特材年使用量E=B×C	被替代品項支付點數Re	推估增加財務支出F=(A-Re)×E(千點)	申報使用量G(千點)	申報點數H(千點)	申報使用量I(千點)	申報點數J(千點)	F=(A-Re)×G(千點)	F=(A-Re)×I(千點)
43	106/8/1	"拜普雷"預成形固定系統-顱骨網片*1+骨釘*8(自付差額)	組	26,239	MICRO MESH PLTAE;MICRO SCREW(ANY SIZE)			【計算說明】 項次43-51屬自付差額品項，原則上不會增加醫療支出。	26,239			-	3	83		
44		"拜普雷"預成形固定系統-顱骨網片*1+骨釘*8(自付差額)	組	26,239	MICRO MESH PLTAE;MICRO SCREW(ANY SIZE)							-	1	28		
45		"拜普雷"預成形固定系統-顱骨網片*1+骨釘*8(自付差額)	組	26,239	MICRO MESH PLTAE;MICRO SCREW(ANY SIZE)				26,239		2	55	-			
46		"拜普雷"預成形固定系統-顱骨網片*1+骨釘*12(自付差額)	組	26,239	MICRO MESH PLTAE;MICRO SCREW(ANY SIZE)				26,239		34	928	45	1,237		
47		"拜普雷"預成形固定系統-顱骨網片*1+骨釘*16(自付差額)	組	26,239	MICRO MESH PLTAE;MICRO SCREW(ANY SIZE)				26,239		-	-	2	55		
48		"美敦力"致密斯顱骨固定系統-顱骨網片*1+骨釘*12(電腦輔助型)(自付差額)	組	26,239	MICRO MESH PLTAE;MICRO SCREW(ANY SIZE)				26,239		71	1,923	92	2,531		
49		"亞太醫療"網膜骨板骨釘-網膜骨板*1+骨釘*10(電腦輔助型)(自付差額)	組	26,239	MICRO MESH PLTAE;MICRO SCREW(ANY SIZE)				26,239		1	28	4	110		
50		"合碩"顱骨固定系統-骨網(預成形，等厚)*1+骨釘*12(自付差額)	組	26,239	MICRO MESH PLTAE;MICRO SCREW(ANY SIZE)				26,239		1	28	-			
51		"合碩"顱骨固定系統-骨網(預成形，不等厚)*1+骨釘*12(自付差額)	組	26,239	MICRO MESH PLTAE;MICRO SCREW(ANY SIZE)				26,239		2	55	6	165		

報告案第3案 106年起收載新功特材申報情形報告案

項次	生效日期	新功特材 中文品名	單位	新功特材 支付點數 A	新功特材 財務推估				新功特材 106年申報數				新功特材 107年申報數 (截至10707)				新功特材 106年實際申報數	新功特材 生效日起 107年實際申報數 (截至10707)
					被替代品項 核價類別中文	年替代 率 B	被替代品項 前1年使用 量 C	預估新功特材年使用 量 E=B*C	被替代品項支 付點數 Rc	推估增加財務 支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使 用量 G	申報點 數 H (千點)	申報使 用量 I	申報點 數 J (千點)				
52	106/9/1	"保梅斯"真空動力式體液 吸收器具(滅菌)	個	2,002	胸腔引流管組 (含穿刺針+擴張 器*3+導線+胸管 插入器+胸管)	50%	2,190	438	1,316	300	8	17	256	538	5	176		
53		"普威"胸腔引流瓶(滅 菌)	個	2,002	胸腔引流管組 (含穿刺針+擴張 器*3+導線+胸管 插入器+胸管)				1,316		-		5	11		3		
54		"柯惠"亞羅爾帶導管-PU 導管(2.5-5.0 Fr)	條	588	點			2,856	170	1,194	97	60	648	400	41	271		
【計算說明】 專家表示可攜帶式之 以全密閉式吸 抽吸器具(滅菌)(全密 閉式引流袋支付 點數1,820點及 全密閉式引流 袋支付點數812 點之平均值 為6:4。 1,316計算																		

【計算說明】
專家表示可攜帶式之抽吸器具(滅菌)(全密閉式引流袋支付點數1,820點及全密閉式引流袋支付點數812點之平均價值為6:4。

報告案第3案 106年起收載新功能特材申報情形報告案

項次	生效日期	新功能特材中文品名	單位	新功能特材單支附點數A	新功能特材財務推估				新功能特材生效日起106年申報數	新功能特材生效日起107年申報數(截至10707)	新功能特材生效日起108年實際申報數	新功能特材生效日起107年實際申報數(截至10707)	
					被替代品項核價類別中文	年替代率B	被替代品項前1年使用量C	預估新功能特材年使用量D=B*C					被替代品項使用量Re
55	106/10/1	"泰爾茂"傑術人工血管- VALSALVA	條	57,029	無		15	855				114	
56		"邁柯唯"英特佳主動脈根部人工血管	條	57,029	無								
57		"百多力"伊翠非亞接磁共振植入式心臟去顫器(包括附件)-具3.0T(雙腔)	個	507,886	雙腔型植入式去顫器-同時具ATP(Anti-Tachycardiapacing)及心房自動電擊功能及減少不恰當電擊辨識功能	100%	10	242	483,701		7	3,555	
58		"百多力"伊翠非亞接磁共振植入式心臟去顫器(包括附件)-具3.0T(單腔)	個	359,451	第二代單腔型植入式去顫器-具ATP(Anti-Tachycardiapacing)及Capture management及減少不恰當電擊辨識功能	100%	19	325	342,335	1	359	17	291
59		"百多力"伊翠非亞接磁共振植入式心臟去顫器(包括附件)-具3.0T(單腔)	個	359,451	第二代單腔型植入式去顫器-具ATP(Anti-Tachycardiapacing)及Capture management及減少不恰當電擊辨識功能				342,335				

報告案第3案 106年起收載新功能特材申報情形報告案

項次	生效日期	新功能特材 中文品名	單位	新功能特材 單 位 支付點數 A	新功能特材 財務推估					新功能特材 生效日起 106年申報數 (截至10707)	新功能特材 生效日起 107年申報數 (截至10707)	新功能特材 生效日起 106年實際申報數 (截至10707)		
					被替代品項 核價類別中文	年替代 率 B	被替代品項 前1年使用 量 C	預估新功能特材年使 用量 E=B×C	被替代品項支 付點數 Re				推估增加財務 支出 F=(A-Re)×E (千點)	申報使 用量 G
60	106/11/1	"曲克"結石移除器(滅菌)-Atlas/Captura不鏽鋼取石器	組	6,221	無		6,114	38,035		3	20	-	19	
61		"曲克"金屬取石器(滅菌)-Atlas/Captura不鏽鋼取石器	組	6,221	無					-	-	-		
62		"曲克"結石移除器(滅菌)-NCompass鏽鈦合金取石器	組	6,221	無					-	-	-		
63		"曲克"金屬取石器(滅菌)-NCompass鏽鈦合金取石器	組	6,221	無					-	-	-		
64		"波士頓科技"依斯頓取石器(滅菌)	組	6,221	無					5	33	142	31	883
65		"曲克"結石移除器(滅菌)-NCage鏽鈦合金取石器	組	6,221	無					3	20	16	19	100
66		"曲克"金屬取石器(滅菌)-NCage鏽鈦合金取石器	組	6,221	無					-	-	-		
67		"曲克"結石移除器(滅菌)-Neircle無尖端式取石器	組	6,221	無					104	679	300	647	1,866
68		"曲克"金屬取石器(滅菌)-Neircle無尖端式取石器	組	6,221	無					1	7	-	6	
69		"波士頓科技"聖古拉取石器(滅菌)	組	6,221	無					381	2,482	1,801	2,370	11,204
70		"安吉美爾"取石器(滅菌)	組	6,221	無					57	372	149	355	927
71		"曲克"結石移除器(滅菌)-NTrap鏽鈦合金取石器	組	6,221	無					2	13	2	12	12
72		"曲克"金屬取石器(滅菌)-NTrap鏽鈦合金取石器	組	6,221	無					-	-	-		
73		"波士頓科技"新若瑟取石器(滅菌)	組	6,221	無					297	1,940	1,436	1,848	8,933

報告案第3案 106年起收載新功能特材申報情形報告案

項次	生效日期	新功能特材中文品名	單位	新功能特材支付點數A	新功能特材財務報告		年替代率B	被替代品項前1年使用量C	預估新功能特材年使用量E=B×C	被替代品項支付點數Re	預估增加財務支出F=(A-Re)×E(千點)	申報使用量G	申報使用量I	申報點數J(千點)	新功能特材生效日起106年實際申報數	新功能特材生效日起107年實際申報數(截至10707)	新功能特材生效日起107年申報數(截至10707)
					被替代品項核價類別中文	申報使用量											
74	106/11/1	"美敦力"北極導線階心磁場導管(自付差額)	條	70,200	立體定位(3D)導注冷卻式診斷電燒配定位裝置	100%	846	846	70,200	4,839	46	3,229	196	13,759			
75		"聖歐達"弗雷瑟感應式電燒導管-具導航功能	條	75,920	立體定位(3D)導注冷卻式診斷電燒配定位裝置				70,200		-	-	6	456			34
76		"百歐森偉伯司特"攝氏磁場遙控導注冷卻式溫控尖端可調彎式診斷/電燒導管-具導航功能	條	75,920	立體定位(3D)導注冷卻式診斷電燒配定位裝置				70,200		-	-	-				
77		"聖歐達"庫爾柏斯社開心臟電燒導管-具導航功能	條	75,920	立體定位(3D)導注冷卻式診斷電燒配定位裝置				70,200		2	152	3	228		11	17
78		"聖歐達"庫爾柏斯社開心臟電燒導管-具導航功能	條	75,920	立體定位(3D)導注冷卻式診斷電燒配定位裝置				70,200		-	-	-				
79		"聖歐達"陸爾普社開心臟電燒導管-具導航功能	條	75,920	立體定位(3D)導注冷卻式診斷電燒配定位裝置				70,200		-	-	-				
80		"聖歐達"陸爾普社開心臟電燒導管-具導航功能	條	75,920	立體定位(3D)導注冷卻式診斷電燒配定位裝置				70,200		-	-	-				
81		"百歐森偉伯司特"藍星磁場遙控導注冷卻式溫控尖端可調彎式診斷/電燒導管-具導航功能	條	75,920	立體定位(3D)導注冷卻式診斷電燒配定位裝置				70,200		1	76	6	456		6	34

報告案第3案 106年起收載新功特材申報情形報告案

項次	生效日期	新功特材 中文品名	單 位	新功特材 支付點數 A	新功特材 財務推估					新功特材 106年申報數				新功特材 107年申報數 (截至10707)				新功特材 106年實際申報數 (截至10707)		新功特材 107年實際申報數 (截至10707)	
					被替代品項 核價類別中文	年替代 率 B	被替代品項 前1年使用 量 C	預估新功特材年使 用量 D=B*C	被替代品項支 付點數 Re	推估增加財務 支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使 用量 G	申報點 數 H (千點)	申報使 用量 I	申報點 數 J (千點)	F=(A-Re)*G (千點)	F=(A-Re)*J (千點)					
82	106/12/1	"曲克"血栓過濾網回收組	組	19,000	無			200	3,800			13	259	84	1,676	247		1,596			
83		"賀爾斯"巴德圈套器取回套組	組	19,000	無							4	80	54	1,077	76		1,026			
84		艾極管灌經食管袋組合套-多功能鼻腸管	組	4,780	經鼻腔空腸經食管NASAL JEJUNAL FEEDING TUBE(含導管、經食管接頭)(其片狀凸出TIGER)	100%	516	516	4,157	321		-	-	-	-	-	-	-	-		
總計											274,850	136,300	262,814			98,795		211,419			

註1：資料來源：三代倉儲：特材主權、門診、交付、住院明細及醫令權(107.8.1擷取)

註2：申報資料範圍：總額內案件，不含未審代辦項目(如預防保健、勞保局職災案件)。

報告案第3案 107年起收載新功能特材申報情形報告案

項次	生效日期	新功能特材中文品名	單位	新功能特材 支付點數 A	新功能特材 財務推估					新功能特材 生效日起 申報數 (截至10707)		新功能特材 實際申報數 (截至10707)	
					被替代品項 核價類別中文	年替 代率 B	被替代品項 前1年使用 量 C	預估新功能特材年使 用量 E=B*C*成長率(註3)	被替代品 項支付點 數 Re	推估增加財務 支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使 用量 G		申報點 數 H (千點)
1	107/1/1	"曲克"拜爾迪賽 橫隔膜疝氣支撐 物	個	17,016	無			50	851		14	248	248
【計算說明】專家 建議以橫膈膜疝氣修 補術(88008B)申報量 及成長率計算													
2	107/2/1	"戈爾"威爾棒周 邊血管支架-含生 物表面肝素塗層 (L:2.5;5.0cm)	組	71,725	周邊動脈血管支 架及傳輸裝置(自 膨式支架含人工血 管, 支架長 25:99mm)	30%	1,904	1,253	62,370	11,722	127	9,117	1,188
3		"戈爾"威爾棒周 邊血管支架-含生 物表面肝素塗層 (L:10cm)		79,852	周邊動脈血管支 架及傳輸裝置(自 膨式支架含人工血 管, 支架長 100:149mm)	30%	1,249	822	76,050	3,125	100	7,981	380
4		"戈爾"威爾棒周 邊血管支架-含生 物表面肝素塗層 (L:15cm)		100,980	周邊動脈血管支 架及傳輸裝置(自 膨式支架含人工血 管, 支架長150mm 以上)	30%	631	414	91,800	3,801	67	6,766	615

報告案第3案 107年起收載新功能特材申報情形報告案

項次	生效日期	新功能特材中文品名	單位	新功能特材 支付點數 A	新功能特材 財務推估				新功能特材 生效日起 申報數 (截至10707)		新功能特材 實際申報數 (截至10707)
					被替代品項 核價類別中文	年替 代率 B	被替代品 前1年使用 量 C	預估新功能特材年使 用量 E=B*C*成長率(註3)	被替代品 項支付點 數 Re	推估增加財務 支出 F=(A-Re)*E (千點)	
5		愛治喘吸藥輔助器	個	700	無			4,621		3,235	346
【計算說明】專家建議以震動式高頻呼吸器治療(57029C)、人工呼吸器噴霧吸入治療一天(57024B)之申報量及成長率計算											
6	107/3/1	"瑛美蒂"可吞式腸胃道膠囊攝影系統※適用於18歲以上	個	31,526	無			304		9,584	1,781
7		"奧林柏斯"膠囊內視鏡系統及其附件-膠囊內視鏡※適用於22-84歲									1,198
8		紀凡可吞式膠囊型腸胃道內視鏡攝影系統-內視鏡膠囊※可供10歲以上兒童使用									1,639
【計算說明】逕以膠囊內視鏡術(33142B)使用量及成長率計算											

報告案第3案 107年起收載新功能特材申報情形報告案

項次	生效日期	新功能特材中文品名	單位	新功能特材 支付點數 A	新功能特材 財務推估				新功能特材 生效日起 申報數 (截至10707)		新功能特材 實際申報數 (截至10707)
					被替代品項 核價類別中文	年替 代率 B	被替代品項 前1年使用 量 C	預估新功能特材年使 用量 D=B*C*成長率(註3) E=(A-Re)*E (千點)	申報使 用量 G	申報點 數 H (千點)	
9	107/4/1	史耐輝泰勒外國 定架(基本組 件:WIRE*2;RING* 2;STRUTYX*6;PIN* 2-3)	組	272,170	無		15	4,083	2	544	544
【計算說明】依小 兒骨科醫學會推估使 用量計算											
10	107/6/1	"史賽克"伽瑪三 股骨固定系統-長 釘組(自付差額)	組	19,036	TITANIUM Gamma 3 Locking Nail System(NAILX1+SC REWX3)	50%	934	455	114	0.1	0.1
11		"信迪思"髓內釘 植入物/近端長股 骨髓內釘/長釘組 (自付差額)	組	19,036	TITANIUM Gamma 3 Locking Nail System(NAILX1+SC REWX3)						
12		"尼奧麥迪克" 雷泌克司男性尿 道懸吊帶系統(含 變調器+外部操縱 器+分離器+懸吊 帶+牽引線+底盤+ 螺絲起子)	組	161,601	無		83	13,413			
【計算說明】依台 灣尿失禁防治協會之 建議年使用量83人											

報告案第3案 107年起收載新功能特材申報情形報告案

項次	生效日期	新功能特材中文品名	單位	新功能特材 支付款數 A	新功能特材 財務推估						新功能特材 生效日起 申報數 (截至10707)		新功能特材 實際申報數 (截至10707)
					被替代品項 核價類別 中文	年替 代率 B	被替代品項 前1年使用 量 C	預估新功能特材年使 用量 E=B*C*成長率(註3)	被替代品 項支付款 數 Re	推估增加財務 支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使 用量 G	申報點 數 H (千點)	
13		"奧林柏斯"止血夾固定裝置組-結紮環(φ 30mm)	個	340	無			17,395		5,914	22	8	8
14		"奧林柏斯"止血夾固定裝置組-結紮環(φ 20mm)	個		無						19	7	7
【計算說明】依消化系內視鏡醫學會及大腸直腸外科醫學會建議，以47074C、49014C及47077B申報量及成長率估算													
15	107/6/1	"卓邇"溫度調節系統及其附件-啟動組件	組	24,948	無			121		3,019	13	0.01	0.01
16		"美德凡司"北極日溫控傳遞墊	組	30,000	無			3		94	11	339	339
17		"卓邇"溫度調節系統及其附件-愛導管組	組	39,464	無			121		4,776	14	552	552
18		"美德凡司"北極日溫控傳遞墊	組	50,000	無			533		26,675	49	2,450	2,450

報告案第3案 107年起收載新功能特材申報情形報告案

項次	生效日期	新功能特材中文品名	單位	新功能特材支付點數A	新功能特材財務推估				新功能特材生效日起申報數(截至10707)	新功能特材實際申報數(截至10707)		
					被替代品項核價類別中文	年替代率B	被替代品項前1年使用量C	預估新功能特材年使用量E=B*C*成長率(註3)			被替代品項支付點數Re	推估增加財務支出F=(A-Re)*E(千點)
【計算說明】以診療項目 47094B~47096B申報量及成長率乘上各廠牌占率，估算使用量												
19	107/7/1	"聯合"股小球-再置換型	個	15,000	無			【說明】依臨床專家意見，難以預估有多少股骨柄是屬於無法取得同廠牌、同系列可相應之股骨球頭的孤兒產品，而仍固定良好無需更換的情形，故無法預估使用量	不影響財務	8	0.01	0.01
20	107/8/1	"聖猶達"電極貼片組	組	26,623	無			2,395	63,760			
21		"聖猷達"電極貼片組	組	26,623	無							
22		"聖猷達"電極貼片組	組	26,623	無							

報告案第3案 107年起收載新功能特材申報情形報告案

項次	生效日期	新功能特材 中文品名	單位	新功能特材 支付點數 A	新功能特材 財務推估						新功能特材 生效日起 申報數 (截至10707)	新功能特材 實際申報數 (截至10707)
					被替代品項 核價類別 中文	年替 代率 B	被替代品項 前1年使用 量 C	預估新功能特材年使 用量 E=B*C*成長率(註3)	被替代品 項支付點 數 Re	推估增加財務 支出 F=(A-Re)*E (千點)		
23		“百歐森偉伯斯 特”瑞笑星心臟 電生理導引貼片	組	26,623	無							f=(A-Re)*G (千點)
24		"百歐森偉伯司 特"卡多系統體外 參考貼片	組	26,623	無							
25		"波士頓科技"定 位參考貼片組	組	26,623	無			【計算說明】依健 保已給付「立體定位 (3D)灌注冷卻式診斷 電燒導管」之使用量 及成長率計算	3,673	39,610		
26		“司諾維思”微 血管吻合系統-套 環	組	10,785	無			【計算說明】依診 療項目「頭頸部腫 瘤」並執行「顯微血 管游離瓣手術」之申 報醫令數量及成長率 計算				
總計										202,322	32,976	11,296

註1：資料來源：三代倉儲：特材主檔、門診、交付、住院明細及醫令檔(107.8.1擷取)

註2：申報資料範圍：總額內案件，不含本署代辦項目(如預防保健、勞保局職災案件)。

註3：預估新功能特材年使用量，暫以該品項提案推估納入健保給付後第3年使用量*成長率計算。

報告案 4

有關增修部分「長效型心室輔助系統」給付規定案。

報告事項

第 4 案

案由：有關增修部分「長效型心室輔助系統」給付規定案。

說明：

- 一、依 107 年 8 月 9 日心臟外科專家研商「長效型心室輔助器(VAD)登錄系統」溝通會議重點摘要及 107 年 8 月 21 日「長效型心室輔助器」集中式審查作業討論會議紀錄辦理。(詳附件 1)。
- 二、本案特材經 107 年 7 月本會議決議納入健保給付，並自 107 年 10 月 1 日生效，惟期間廠商及專家對部分給付規定有疑義，故建議增修文字，以使內容更具完善：
 - (一)植入本案特材時，並未有血型限制，故刪除禁忌症之第 8 點「A B O 血型與捐贈者不相容者。」
 - (二)對於心臟移植之醫院，醫師資格認定疑義，經洽衛生福部醫事司確認，廠商所提供廢止多項移植手術資格函，業已整併移入「施行器官摘取移植手術核定及管理辦法」規範，故仍維持支付規範(3)：醫院及醫師必須經衛福部核定具心臟移植資格者。
- 三、另考量本案特材價格昂貴，參考現行「深層腦部刺激器(DBS)」特殊專案審查方式，將「需事前審查」專簽為「特殊專案審查」，並制定「長效型心室輔助系統」特殊專案審查作業原則。
- 四、原給付規定第五點文字：「需事前審查且完成個案登錄系統」，從字義上無法確認，必須先完成登錄資料後才進入特殊專案審查程序，故修正為「完成個案登錄系統且須送特殊專案審查核准」。
- 五、爰此，本案依上述說明，修正給付規定版本如後，並已併至上開公告實施。

長效型心室輔助系統修正後給付規定

B206-8長效型心室輔助系統

一、適應症：

1. 病患已登錄於器官移植中心系統。
2. 須能耐受抗凝血治療。
3. 符合下列心臟移植條件且無法脫離強心劑注射 (dopamine + dobutamine $>5\mu\text{g}/\text{min}/\text{kg}$) 大於14天或一年內2次住院接受強心劑注射每次大於7天。
 - (1) 心臟衰竭且 Maximal $\text{VO}_2 < 10\text{ml}/\text{kg}/\text{min}$ 者。
 - (2) 心臟衰竭達紐約心臟功能第四度，且 Maximal $\text{VO}_2 < 14\text{ml}/\text{kg}/\text{min}$ 者。
 - (3) 心臟衰竭核醫檢查 $\text{LVEF} < 20\%$ ，經六個月以上藥物(包括 ACE inhibitors, Digoxin、Diuretics 等)治療仍無法改善者；如有重度二尖瓣閉鎖不全，經核醫檢查 $\text{LVEF} < 25\%$ 者。
 - (4) 嚴重心肌缺血，核醫檢查 $\text{LVEF} < 20\%$ ，經核醫心肌灌注掃描及心導管等檢查，證實無法以冠狀動脈繞道手術及冠狀動脈介入治療者。
 - (5) 紐約心臟功能第四度，持續使用 Dopamine 或 Dobutamine $>5\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ 7天以上，經核醫檢查 $\text{LVEF} < 25\%$ 或心臟指數 $\text{Cardiac index} < 2.0\text{L}/\text{min}/\text{m}^2$ 者。
 - (6) 復發有症狀的心室心律不整，無法以公認有效的方法治療者。

二、禁忌症：

1. 超過65歲以上。
2. 有明顯感染者。
3. 愛滋病帶原者，應符合財團法人器官捐贈移植登錄中心訂定之「捐贈者基準及待移植者之絕對與相對禁忌症、適應症與各器官疾病嚴重度分級表」規定。
4. 肺結核經證實者。
5. 惡性腫瘤患者。
6. 心智不正常或無法長期配合藥物治療者。
7. 少年型或胰導素依賴型糖尿病患者。
8. 嚴重肺高血壓，經治療仍大於6 Wood Unit 者，不得做正位心臟移植(異位心臟移植者不得大於12 Wood Unit)。
9. 肝硬化或 GPT 在正常兩倍以上，且有凝血異常者。

長效型心室輔助系統修正後給付規定

10. 中度以上腎功能不全者(Creatinine >3.0mg/dl 或 Ccr<20ml/min)。
11. 嚴重的慢性阻塞性肺病患者(FEVI<50% of predicted 或 FEVI/FVC<40% of predicted)。
12. 活動性消化性潰瘍患者。
13. 嚴重的腦血管或周邊血管病變，使日常生活無法自理，且無法接受重建手術者。
14. 免疫系統不全或其他全身性疾病，雖經治療仍預後不良者。
15. 藥癮患者。
16. INTERMACS 1及 INTERMACS 2 之患者。
17. 再次開心手術。

三、支付規範：

1. 醫院條件：

- (1)須為「中華民國心臟醫學會」及「台灣胸腔及心臟血管外科學會」所認定之專科醫師訓練醫院。
- (2)應有專任具臨床藥理、病理、移植免疫、感染症及血液學專長之醫師。

2. 醫師條件：

- (1)手術主持醫師須有主持開心手術五百例以上之經驗。
- (2)執行本項手術之醫院及醫師條件應向保險人申請核備。

3. 醫院及醫師必須經衛福部核定具心臟移植資格者。

四、每人終身給付1組。

五、完成個案登錄系統且須送事前特殊專案審查核准。

六、個案完成植入手術後，須定期登入系統追蹤狀況，直到病人完成心臟移植手術出院或死亡。

全民健康保險特殊材料給付規定對照表

給付規定分類碼：B206-8

(自107年□月□日生效)

原建議之給付規定	修正後給付規定
B206-8長效型心室輔助系統 一、適應症： - 病患已登錄於器官移植中心系統。 - 須能耐受抗凝血治療。 - 符合下列心臟移植條件且無法脫離強心劑注射 (dopamine + dobutamine $>5\mu\text{g}/\text{min}/\text{kg}$) 大於14天或一年內2次住院接受強心劑注射每次大於7天。 - 心臟衰竭且 Maximal $\text{VO}_2 < 10\text{ml}/\text{kg}/\text{min}$ 者。 - 心臟衰竭達紐約心臟功能第四度，且 Maximal $\text{VO}_2 < 14\text{ml}/\text{kg}/\text{min}$ 者。 - 心臟衰竭核醫檢查 LVEF$<20\%$，經六個月以上藥物(包括 ACE inhibitors, Digoxin、Diuretics 等)治療仍無法改善者；如有重度二尖瓣閉鎖不全，經核醫檢查 LVEF$<25\%$者。 - 嚴重心肌缺血，核醫檢查 LVEF$<20\%$，經核醫心肌灌注掃描及心導管等檢查，證實無法以冠狀動脈繞道手術及冠狀動脈介入治療者。 - 紐約心臟功能第四度，持續使用 Dopamine 或 Dobutamine$>5\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ 7天以上，經核醫檢查 LVEF$<25\%$或心臟指數 Cardiac index$<2.0\text{L}/\text{min}/\text{m}^2$者。 - 復發有症狀的心室心律不整，無法以公認有效的方法治療者。 二、禁忌症： - 超過65歲以上。 - 有明顯感染者。 - 愛滋病帶原者，應符合財團法人器官捐贈移植登錄中心訂定之「捐贈者基準及待移植者之絕對與相對禁忌症、適應症與各器官疾病嚴重度分級表」規定。 - 肺結核經證實者。	詳本次會議報告案第4案

原建議之給付規定	修正後給付規定
5. 惡性腫瘤患者。 6. 心智不正常或無法長期配合藥物治療者。 7. 少年型或胰導素依賴型糖尿病患者。 8. ABO血型與捐贈者不相容者。 9. 嚴重肺高血壓，經治療仍大於6 Wood Unit者，不得做正位心臟移植(異位心臟移植者不得大於12 Wood Unit)。 10. 肝硬化或GPT在正常兩倍以上，且有凝血異常者。 11. 中度以上腎功能不全者(Creatinine >3.0mg/dl 或 Ccr<20ml/min)。 12. 嚴重的慢性阻塞性肺病患者(FEVI<50% of predicted 或 FEVI/FVC<40% of predicted)。 13. 活動性消化性潰瘍患者。 14. 嚴重的腦血管或周邊血管病變，使日常生活無法自理，且無法接受重建手術者。 15. 免疫系統不全或其他全身性疾病，雖經治療仍預後不良者。 16. 藥癮患者。 17. INTERMACS 1及INTERMACS 2之患者。 18. 再次開心手術。 三、支付規範： 1. 醫院條件： (1)須為「中華民國心臟醫學會」及「中華民國胸腔及心臟血管外科學會」所認定之專科醫師訓練醫院。 (2)應有專任具臨床藥理、病理、移植免疫、感染症及血液學專長之醫師。 2. 醫師條件： (1)手術主持醫師須有主持開心手術五百例以上之經驗。 (2)執行本項手術之醫院及醫師條件應向保險人申請核備。 3. 醫院及醫師必須經衛福部核定具心臟移植資格者。 四、每人終身給付1組。 五、需事前審查且完成個案登錄系統。 六、個案完成植入手術後，須定期登入系統追蹤狀況，直到病人完成心臟移植手術出院或死亡。	

報告案 5

有關增修部分「全民健康保險自付差額特材類別」之
中文名稱案。

報告事項

第 5 案

案由：有關增修部分「全民健康保險自付差額特材類別」之中文名稱案。

說明：

- 一、依全民健康保險法第 45 條及全民健康保險辦理自付差額特殊材料之作業原則第 5 條規定辦理(詳附件 1)。
- 二、目前健保已收載之自付差額特材類別共計 11 類(12 項目)，相關類別名稱及實施日期等資料詳如附件，前述部分特材功能類別名稱中，與其衛福部核准之該產品仿單不一致，爰擬修正目前已實施自付差額特材類別名稱 5 項，刪除名稱 1 項及新增名稱 2 項共計 6 類(8 項)(詳修正草案對照表)。

全民健康保險自付差額特材類別名稱

修正草案對照表

項目	項次	原項目名稱	實施日期	擬增修項目名稱	說明	備註
1	1	義肢	84/3/1	不修正	同仿單登載名稱。	
2	2	新增功能類別人工心律調節器	84/8/3	特殊功能人工心律調節器	符合仿單登載：雙腔心律調節器(具速率調整及核磁共振相容之附加功能)訂定。	修正
3	3	塗藥或特殊塗層血管支架	95/12/1	冠狀動脈塗藥支架	依仿單登載名稱訂定。	修正
4	4	特殊材質人工髖關節	96/1/1	不修正		
	4.1	陶瓷人工髖關節	96/1/1	不修正	同仿單登載之材質訂定。	
	4.2	金屬對金屬介面人工髖關節	97/5/1	金屬對金屬介面人工髖關節	1. 依仿單登載襯墊材質為鈷鉻鉬合金，經過特殊之加工製造。 2. 依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第31次(107年3月)會議決議及107年4月18日健保審字第1070035175號公告辦理，自107年10月1日起取消健保給付。	刪除
	4.3	—	預計 107/10/1	添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯全髖白內襯	依仿單登載之材質說明訂定。	新增
5	5	特殊功能人工水晶體	96/10/1	不修正	同仿單登載之材質功能說明訂定。	

全民健康保險自付差額特材類別名稱

修正草案對照表

項目	項次	原項目名稱	實施日期	擬增修項目名稱	說明	備註
6	6	耐久性生物組織心臟瓣膜	103/6/1	特殊材質生物組織心臟瓣膜	符合仿單登載之材質說明：「牛心包膜、牛心+豬心包膜、具有特殊抗礦化處理之豬心瓣膜」訂定。	修正
7	7	調控式腦室腹腔引流系統	104/6/1	不修正	同仿單登載之功能訂定。	
8	8	治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置	105/5/1	不修正	依仿單登載之適用部位訂定。	
9	9	客製化電腦輔助型顱顏骨固定系統	106/8/1	不修正	依仿單登載之適用部位訂定。	
10	10	治療心房顫動之冷凍消融導管	106/11/1	治療複雜性心臟不整脈消融導管	心導管消融術適用之導管分為「熱電燒紀錄導管」及「冷凍消融導管」，為利日後類似功能新申請品項納入給付，故修正類別名稱，以附加功能再做細項分類。	修正
	10.1	—	依衛生福利部核定公告日	治療心房顫動之冷凍消融導管		新增
11	11	鈦合金加長型伽瑪髓內釘組(長度 180mm 以上)	107/6/1	特殊材質加長型伽瑪髓內釘組	依仿單登載之材質說明訂定。嗣後再有特殊材質或長度規格之類似品項，往下加即可。	修正

報告案 6

全民健保收載自付差額特材申報情形及其檢討。

全民健保收載自付差額特材申報情形 及其檢討

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第34次(107年9月)會議
107年09月20日

報-6

1

大綱

- 自付差額特材類別
- 自付差額特材申報情形
- 自付差額上限執行情形

報-6

2

各類自付差額特材實施一覽表

類別 序號	類別	實施起日	實施迄日	107年健保 給付點數	107年健保 收載品項數
1	義肢	84年3月1日		依裝置部位： 4,800-68,000點	17
2	新增功能類別人工心律調節器	84年8月3日		93,833點	50
3	塗藥或特殊塗層血管支架	95年12月1日		14,099點	31
4	陶瓷人工髖關節	96年1月1日		依核價類別： 35,195-70,099點	94
	金屬對金屬介面人工髖關節	97年5月1日	107年9月30日	依核價類別： 39,396-49,319點	
5	特殊功能人工水晶體	96年10月1日		2,744點	92
6	生物組織心臟瓣膜	103年6月1日		43,613點	12
7	調控式腦室腹腔引流系統	104年6月1日		7,127點	15
8	淺股動脈狹窄之塗藥裝置	105年5月1日		28,773點	11
9	客製化電腦輔助型顱顏骨固定系統	106年8月1日		26,239點	9
10	治療心房顫動之冷凍消融導管	106年11月1日		70,200點	1
11	鈦合金加長型伽瑪髓內釘組(長度180mm以上)	107年6月1日		19,036點	2
總計					334

報-6

3

各類自付差額特材 申報情形

1.義肢申報情形

	104年		105年		106年	
	申報數量 (單位)	申報點數 (百萬點)	申報數量 (單位)	申報點數 (百萬點)	申報數量 (單位)	申報點數 (百萬點)
自付差額(A)	28	1	39	1.5	28	1
全額給付(B)	1,339	43	1,345	43.4	1,176	37
合計(A+B)	1,367	44	1,384	44.9	1,204	38
占率(A/A+B)	2.0%	2.2%	2.8%	3.4%	2.3%	2.9%

◎全額給付：指相同功能用途之健保全額給付特材。

2.新增功能類別人工心律調節器申報情形

	104年		105年		106年	
	申報數量 (單位)	申報點數 (百萬點)	申報數量 (單位)	申報點數 (百萬點)	申報數量 (單位)	申報點數 (百萬點)
自付差額(A)	2,964	278	3,177	295.9	3,203	301
全額給付(B)	3,518	291	3,231	272.8	3,085	265
合計(A+B)	6,482	569	6,408	568.8	6,288	566
占率(A/A+B)	45.7%	48.9%	49.6%	52.0%	50.9%	53.1%

◎全額給付：指相同功能用途之健保全額給付特材。

3. 塗藥或特殊塗層血管支架申報情形

	104年		105年		106年	
	申報數量 (單位)	申報點數 (百萬點)	申報數量 (單位)	申報點數 (百萬點)	申報數量 (單位)	申報點數 (百萬點)
自付差額(A)	28,778	492	33,385	494.6	40,168	594
全額給付(B)	23,820	407	24,200	359.1	25,449	377
合計(A+B)	52,598	899	57,585	853.8	65,617	971
占率(A/A+B)	54.7%	54.7%	58.0%	57.9%	61.2%	61.2%

◎全額給付：指相同功能用途之健保全額給付特材。

◎於105年1月1日訂定自付差額上限

報-6

7

4. 陶瓷、金屬對金屬人工髖關節申報情形

	104年		105年		106年	
	申報數量 (單位)	申報點數 (百萬點)	申報數量 (單位)	申報點數 (百萬點)	申報數量 (單位)	申報點數 (百萬點)
自付差額(A)	3,673	153	4,071	168.7	4,645	191
全額給付(B)	12,973	499	13,312	509.1	13,382	510
合計(A+B)	16,646	652	17,383	677.8	18,027	701
占率(A/A+B)	22.1%	23.5%	23.4%	24.9%	25.8%	27.3%

◎金屬對金屬人工髖關節，依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第31次（107年3月）會議決議取消健保給付並於107年4月18日公告自107年10月1日生效。

◎全額給付：指相同功能用途之健保全額給付特材。

◎以整組關節作為申報數量及點數之計算單位

報-6

8

5.特殊功能人工水晶體申報情形

	104年		105年		106年	
	申報數量 (單位)	申報點數 (百萬點)	申報數量 (單位)	申報點數 (百萬點)	申報數量 (單位)	申報點數 (百萬點)
自付差額(A)	66,771	190	72,740	207.6	79,677	227
全額給付(B)	130,305	355	133,600	367.8	137,707	384
合計(A+B)	197,076	545	206,340	575.5	217,384	611
占率(A/A+B)	33.9%	34.9%	35.3%	36.1%	36.7%	37.2%

◎全額給付：指相同功能用途之健保全額給付特材。

◎分別於104年1月1日及105年1月1日訂定自付差額上限

6.生物組織心臟瓣膜申報情形

	104年		105年		106年	
	申報數量 (單位)	申報點數 (百萬點)	申報數量 (單位)	申報點數 (百萬點)	申報數量 (單位)	申報點數 (百萬點)
自付差額(A)	798	35	943	41.1	1,079	47
全額給付(B)	1,668	75	1,627	73.3	1,495	67
合計(A+B)	2,466	110	2,570	114.5	2,574	114
占率(A/A+B)	32.4%	31.7%	36.7%	35.9%	41.9%	41.1%

◎全額給付：指相同功能用途之健保全額給付特材。

7. 調控式腦室腹腔引流系統申報情形

	104年6月至12月		105年		106年	
	申報數量 (單位)	申報點數 (百萬點)	申報數量 (單位)	申報點數 (百萬點)	申報數量 (單位)	申報點數 (百萬點)
自付差額(A)	1,040	8	2,115	15.8	2,332	17
全額給付(B)	485	4	755	5.6	735	6
合計(A+B)	1,525	11	2,870	21.4	3,067	23
占率(A/A+B)	68.2%	68.1%	73.7%	73.6%	76.0%	76.0%

◎自付差額「調控式腦室腹腔引流系統」自104年6月起生效。

◎全額給付：指相同功能用途之健保全額給付特材。

8. 淺股動脈狹窄之塗藥裝置申報情形

	104年		105年5月至12月		106年	
	申報數量 (單位)	申報點數 (百萬點)	申報數量 (單位)	申報點數 (百萬點)	申報數量 (單位)	申報點數 (百萬點)
自付差額(A)	-		492	14.9	1,258	38
全額給付(B)	1,752	61	1,123	39.1	1,996	69
合計(A+B)	1,752	61	1,615	53.9	3,254	107
占率(A/A+B)			30.5%	27.5%	38.7%	35.6%

◎自付差額「淺股動脈狹窄之塗藥裝置」自105年5月起生效。

◎全額給付：指相同功能用途之健保全額給付特材。

9.客製化電腦輔助型顱顏骨固定系統申報情形

	104年		105年		106年8月至11月	
	申報數量 (單位)	申報點數 (百萬點)	申報數量 (單位)	申報點數 (百萬點)	申報數量 (單位)	申報點數 (百萬點)
自付差額(A)	-		-		111	3
全額給付(B)	51	1	34	0.4	13	0
合計(A+B)	51	1	34	0.4	124	3
占率(A/A+B)					89.5%	95.4%

◎自付差額「客製化電腦輔助型顱顏骨固定系統」自106年8月起生效。

◎全額給付：指相同功能用途之健保全額給付特材。

◎107年已編列預算納入健保全額給付，刻研議中。

10.治療心房顫動之冷凍消融導管申報情形

	104年		105年		106年11月-12月	
	申報數量 (單位)	申報點數 (百萬點)	申報數量 (單位)	申報點數 (百萬點)	申報數量 (單位)	申報點數 (百萬點)
自付差額(A)	-		-		46	3
全額給付(B)	846	61	1,110	77.9	270	19
合計(A+B)	846	61	1,110	77.9	316	22
占率(A/A+B)					14.6%	14.6%

◎自付差額「治療心房顫動之冷凍消融導管」自106年11月起生效。

◎全額給付：指相同功能用途之健保全額給付特材。

自付差額上限執行情形

15

自付差額上限訂定原則(1/2)

- 以特約醫事機構登錄於VPN-醫事機構收取特材自費申報檔(即自費醫材比價網)之資料，為訂定自付差額特材差額上限之依據。
- 「特殊功能人工水晶體」及「塗藥或特殊塗層血管支架」特材品項，於104年12月31日實施生效達1年以上者，則訂定差額上限。
- 採「品項別」之比價網所登錄收費金額標準分布之70百分位訂定之。
- 未於VPN登錄收費標準者，則暫以同功能特材品項收費標準上限值之最低價為收取金額上限值。

自付差額上限訂定原則(2/2)

- 自付差額品項收載後，由保險人每年對自付差額品項監控其收費情形，有以下情形之一，保險人得訂定差額上限：
 - ✓ 同功能類別自付差額品項，於各保險醫事服務機構間自付差額之差異範圍較大(差異範圍以變異係數計算)，優先訂定。
 - ✓ 民眾反映之品項，經查證其同功能類別自付差額品項之健保支付點數加上自付差額之和，高出國際價格且顯有不合理者。
 - ✓ 民眾反映之品項，經查證保險醫事服務機構收費標準，違反醫療法第二十二條第二項之規定者。

報-6

17

107年有效品項自付差額上限訂定情形

	上限定 訂時程	107年有 效品項數	訂有上限 品項數	未訂定上 限-滿1年 品項數	未訂定上 限-未滿1 年品項數
塗藥或特殊塗 層血管支架	105年1月1日	33	18	13	2
特殊功能人工 水晶體	104年1月1日 105年1月1日	99	43	44	12


註：

- 已訂定自付差額上限品項詳附表1、2
- 以107年12月31日作為實施生效是否達1年之標準

報-6

18

醫院平均收費標準於訂定上限前後之改變

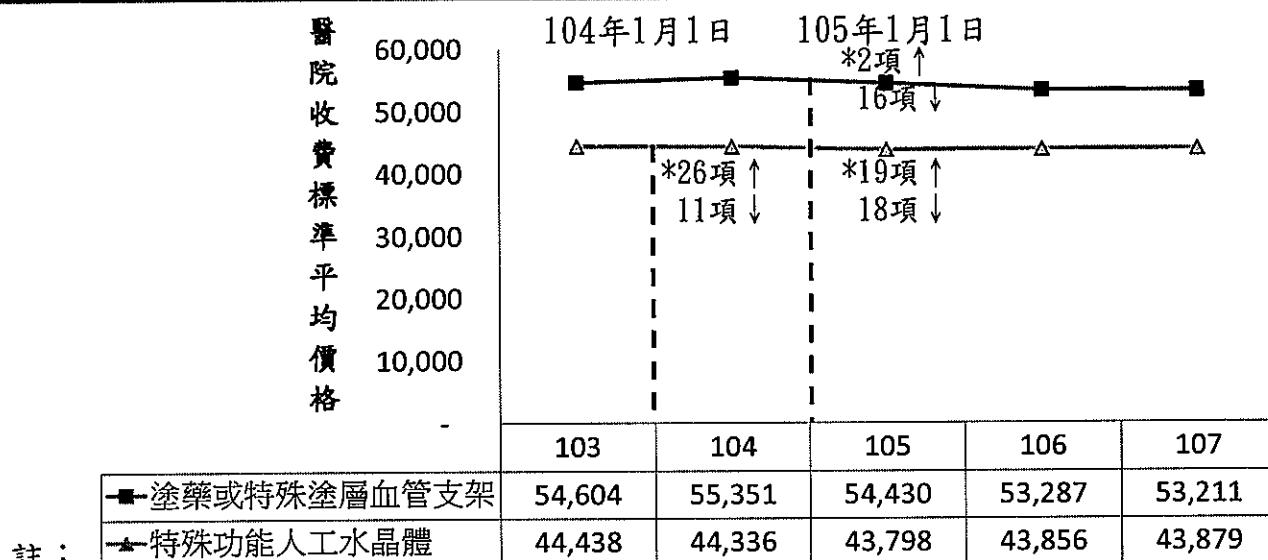


註：

- 為呈現整體價格實際狀況，以現有效且已訂定自付差額上限之品項計算，非針對該年有訂定自付差額上限或每年皆有收費標準者。
- 平均值計算係依品項取各院收費標準平均，再將各品項之平均取整體平均
- *訂定上限前後平均價格上升或下降之品項數(107年有效共18及43項)

報-6

19

醫院平均收費標準與自付差額上限之整體概況-塗藥或特殊塗層血管支架

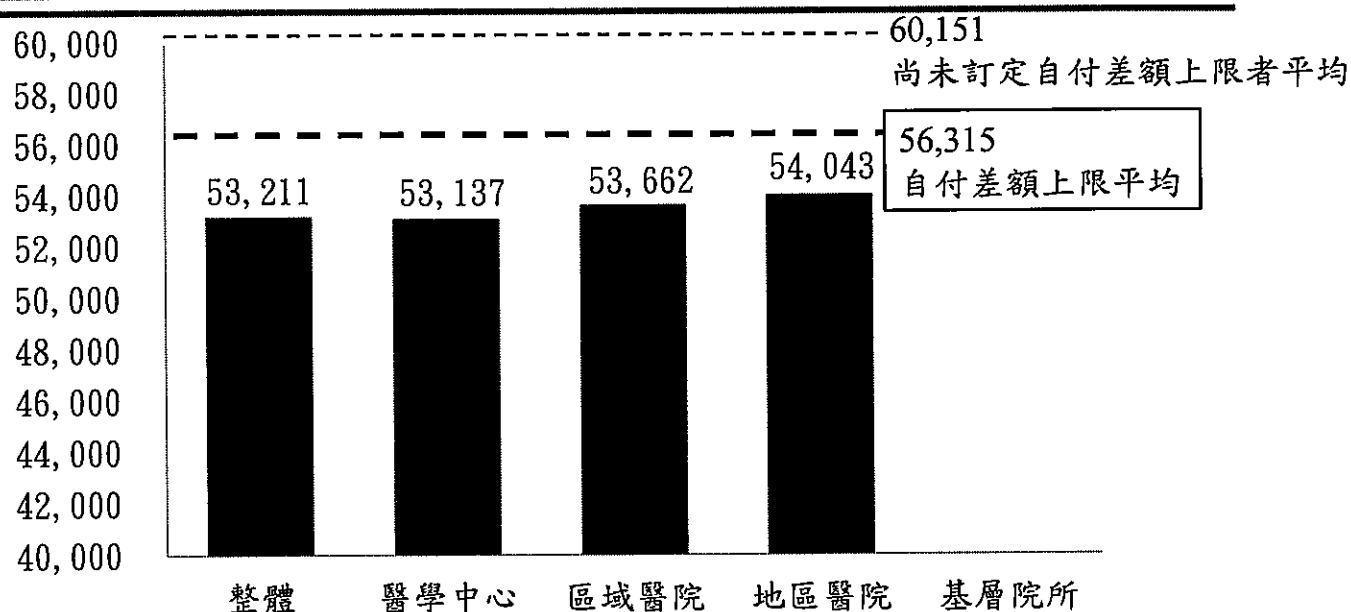


註：

- 以107年有效品項醫院收費標準與105年1月1日上限值比較，未考量品項功能差異。
- 平均值計算係依品項取各院收費標準平均，再將各品項之平均取整體平均
- 106年申報量：醫學中心20,868 (52%)；區域醫院17,785 (44%)；地區醫院1,516 (4%)。

報-6

20

醫院平均收費標準與自付差額上限之整體概況-特殊功能人工水晶體

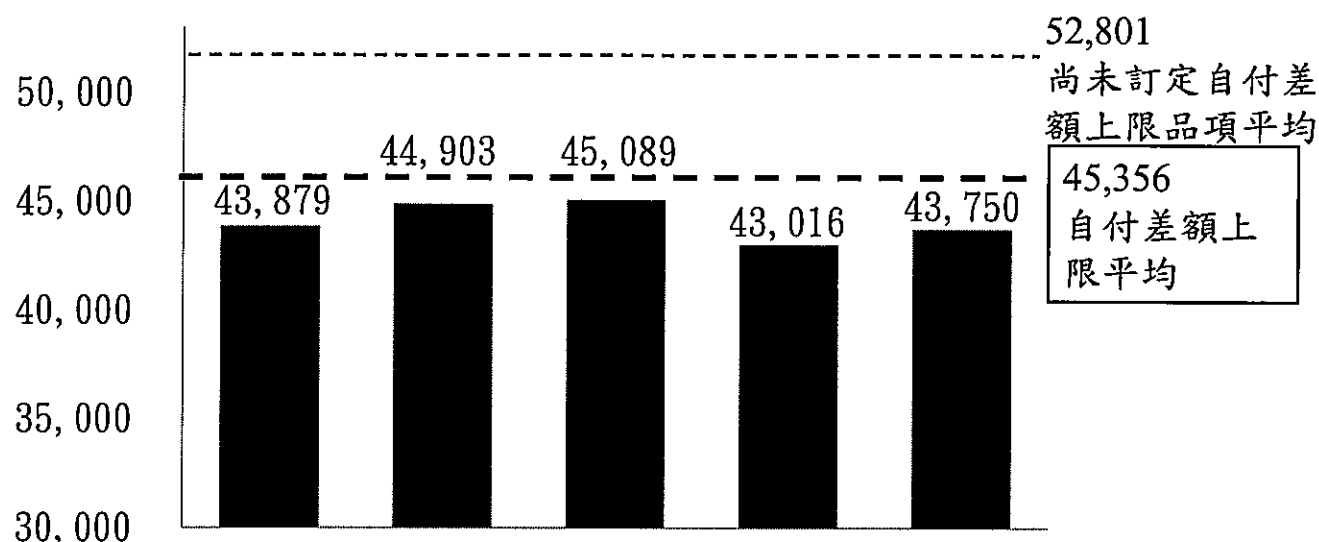

- 註：
- 1.以107年有效品項醫院收費標準與105年1月1日上限值比較，未考量品項功能差異。
 - 2.平均值計算係依品項取各院收費標準平均，再將各品項之平均取整體平均
 - 3.106年申報量：醫學中心19,535(25%)；區域醫院15,632(20%)；地區醫院3,716(5%)；基層院所40,798 (51%)。

報-6

21

醫院收費標準超過自付差額上限情形

● 特殊功能人工水晶體

	整體	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層院所
院所數	24	1	3	6	14
品項數	13	1	2	6	11
超過上限筆數	29	1	3	6	19

- 註：
- 1.以107年有效品項醫院收費標準與105年1月1日上限值比較
 - 2.塗藥或特殊塗層血管支架醫院收費標準皆小於或等於自付差額上限

結論

- 針對塗藥或特殊塗層血管支架及特殊功能人工水晶體新收載品項，至107年12月31日實施生效達1年且尚未訂定上限者(分別13項及44項)，已刻正辦理訂定上限作業，並將公開於本署全球資訊網。
- 針對醫療院所收費標準超過自付差額上限者，近期函請院所於期限內完成修正自付差額收費標準，並請本署各分區業務組加強輔導。

表1「特殊功能人工水晶體」之各特材品項收取自付差額上限金額明細表

項次	功能類別	特材代碼	中文品名	英文品名	90百分位 (104.1.1生效)	70百分位 (105.1.1生效)	備註
1	01非球面	FALSNWAVE11D	"史密舒"單片型軟式人工水晶體:非球面軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"DR.SCHMIDT"ACRYLIC INTRAOCULAR LENS MICROCRYL	29,256	29,256	已刪除
2	01非球面	FALSNWAVE11E	"愛銳"單片型抗紫外線親水性丙烯酸脂後房人工水晶體:非球面軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"AAREN"SINGLE-PIECE HYDROPHILIC ACRYLIC POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH U.V. ABSORBER	27,656	27,656	已刪除
3	01非球面	FALSNWAVE11K	"艾瑟樂視"人工水晶體:非球面軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"XCELENS"IDEA INTRAOCULAR LENS(ASPHERIC)	32,000	29,300	已刪除
4	01非球面	FALSNWAVE11W	千禧力視單片軟式人工水晶體:非球面軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	MBI PRECISAL ONE PIECE SOFT HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS	-	30,000	
5	01非球面	FALSNWAVE11X	"克洛瑪"植入器預載式人工水晶體:非球面軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"CROMA"PRELOADED ACRYLIC INTRAOCULAR LENS IN A SINGLE-USE INJECTOR	29,300	27,256	
6	01非球面	FALSNWAVE13Q	"麥德仁"屑特視人工水晶體:非球面變色(自付差額品項)	"MEDENNIUM" MATRIX ACRYLIC (AURIUM) INTRAOCULAR LENS	-	37,556	
7	01非球面	FALSNWAVE1A1	"愛爾康"可舒愛視明智型非球面單片型軟式人工水晶體(可濾部分藍光):非球面軟式+黃色人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"ALCON"ACRYSOFT ASPHERIC NATURAL IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS	30,000	30,000	
8	01非球面	FALSNWAVE1B9	"博士倫"舒博人工水晶體:非球面軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"BAUSCH+LOMB"SOFTPORT INTRAOCULAR LENS	22,256	17,000	
9	01非球面	FALSNWAVE1HY	"豪雅"植入器預載式人工水晶體:非球面軟式人工水晶體(過濾藍光)※自付差額品項,超過部分由病患自付	"HOYA"HOYA-PS AF-I(UY)INTRAOCULAR LENS	30,619	29,256	
10	01非球面	FALSNWAVE1LS	"蘭斯特克"人工水晶體:非球面軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"LENSTEC"INTRAOCULAR LENS	30,000	28,000	
11	01非球面	FALSNWAVE1RQ	"樂敦"新視非球面人工水晶體:非球面軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"ROHTO"NEO EYE ASPHERIC FOLDABLE LENS	-	30,000	
12	01非球面	FALSNWAVE1RY	"銳能"非球面推注式人工水晶體系統:非球面軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"RAYNER"ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS INJECTION SYSTEM	30,000	29,150	
13	01非球面	FALSNWAVE21D	"史密舒"單片型軟式人工水晶體:非球面軟式人工水晶體(藍光防護)※自付差額品項,超過部分由病患自付	"DR.SCHMIDT"ACRYLIC INTRAOCULAR LENS MICROCRYL	29,256	29,256	已刪除
14	01非球面	FALSNWAVE21E	"愛銳"單片型抗紫外線疏水性丙烯酸脂後房人工水晶體:非球面軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"AAREN"SINGLE-PIECE HYDROPHOBIC ACRYLIC POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH U.V. ABSORBER	19,356	19,356	已刪除
15	01非球面	FALSNWAVE21X	"克洛瑪"植入器預載式非球面人工水晶體:非球面軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"CROMA"BARRETT ACRYLIC INTRAOCULAR LENS IN A SINGLE-USE INJECTOR ASPHERIC	19,356	17,000	
16	01非球面	FALSNWAVE2A2	"眼力健"添視明折疊式人工水晶體:非球面軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"AMO"TECNIS FOLDABLE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS	28,456	27,256	
17	01非球面	FALSNWAVE2HY	"豪雅"植入器預載單片式非球面黃色人工水晶體:非球面軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"HOYA"ISERT PRELOADED IOL	32,256	30,000	
18	01非球面	FALSNWAVE2LS	"蘭斯特克"人工水晶體:非球面軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"LENSTEC"INTRAOCULAR LENS	19,356	17,000	
19	01非球面	FALSNWAVE2RY	"銳能"視飛克斯人工水晶體:非球面軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"RAYNER"SULCOFLEX HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENSES	30,856	30,856	
20	01非球面	FALSNWAVE3A1	"愛爾康"可舒愛視明智型非球面單片型軟式人工水晶體(可濾部份藍光):非球面軟式+黃色人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"ALCON"ACRYSOFT IQ ASPHERIC NATURAL SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS	35,000	30,000	
21	01非球面	FALSNWAVE3RY	"銳能"進階推注式非球面人工水晶體系統(自付差額品項)	"RAYNER"ADVANCE PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOL INJECTION SYSTEM	-	35,656	
22	01非球面	FALSNWAVE4A2	"眼力健"添視明單片型摺疊式人工水晶體:非球面軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"AMO"TECNIS 1 PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS	30,000	30,000	

表1「特殊功能人工水晶體」之各特材品項收取自付差額上限金額明細表

項次	功能類別	特材代碼	中文品名	英文品名	90百分位 (104.1.1生效)	70百分位 (105.1.1生效)	備註
23	01非球面	FALSNWAVE4B9	"博士倫"優視微切口人工水晶體:非球面軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"BAUSCH ? LOMB CHAUVIN OPSIA"AKREOS AO MICRO INCISION LENS	42,256	42,000	
24	01非球面	FALSNWAVE5B9	"博士倫"優視非球面人工水晶體:非球面軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"BAUSCH ? LOMB"AKREOS INTRAOCULAR LENS	29,157	27,256	
25	01非球面	FALSNWAVE6B9	"博士倫"優視微切口人工水晶體:非球面軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"BAUSCH ? LOMB"AKREOS AO MICRO INCISION LENS	45,000	45,000	
26	01非球面	FALSNWAVE7B9	"博士倫"恩視非球面人工水晶體:非球面軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"BAUSCH?LOMB"ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS	35,000	33,826	
27	02多焦點	FALSNMULT1A2	"眼力健"回視明多焦點人工水晶體:多焦點軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"AMO"REZOOM ACRYLIC MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS (IOL)	60,256	60,157	已刪除
28	02多焦點	FALSNMULT1LS	"蘭斯特克"福來視人工水晶體:多焦點軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"LENSTEC"TETRAFLEX INTRAOCULAR LENS	50,098	45,256	
29	02多焦點	FALSNMULT1RY	"銳能"敏視多焦點推注式人工水晶體系統:多焦點軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"RAYNER"R-M-FLEX MULTIFOCAL INJECTABLE ACRYLIC LENS INJECTION SYSTEM	60,000	60,000	
30	02多焦點	FALSNMULT2A1	"愛爾康"可舒銳視安智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體(可濾部分藍光):(非球面軟式+多焦點+黃色)※自付差額品項,超過部分由病患自付	"ALCON"ACRYSOFT IQ RESTOR MULTI FOCAL INTRAOCULAR LENS	62,256	60,000	
31	02多焦點	FALSNMULT2RY	"銳能"視飛克斯人工水晶體:多焦點軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"RAYNER"SULCOFLEX HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENSES	59,656	59,656	
32	02多焦點	FALSNMULT3A2	"眼力健"添視明單片型多焦點人工水晶體:多焦點軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"AMO"TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR	62,256	60,000	
33	03散光	FALSNTO1RC1A1	"愛爾康"可舒安瑞明散光矯正單片型軟式人工水晶體(可濾部分藍光):散光功能軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	ACRYSOFT TORIC SINGLE-PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS	45,000	44,307	
34	03散光	FALSNTO1RC1RY	"銳能"環明散光推注式人工水晶體系統包:散光功能軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"RAYNER"R-T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS INJECTION SYSTEM PACK	45,000	42,256	
35	03散光	FALSNTO1RC2A1	"愛爾康"可舒智慧型安瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體(可濾部分藍光)※自付差額品項,超過部分由病患自付	ACRYSOFT IQ TORIC SINGLE-PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS	45,000	44,256	
36	03散光	FALSNTO1RC2RY	"銳能"視飛克斯人工水晶體:散光功能軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"RAYNER"SULCOFLEX HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENSES	45,256	45,256	
37	03散光	FALSNTO1RTU1D	"史密舒"散光人工水晶體:散光功能軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"DR.SCHMIDT"SILICONE INTRAOCULAR LENS MICROSIL TORIC	45,000	42,256	已刪除
38	03散光	FALSNTO1RTY1D	"史密舒"散光人工水晶體:散光功能軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"DR.SCHMIDT"SILICONE INTRAOCULAR LENS MICROSIL TORIC	45,000	42,256	已刪除
39	04黃色	FALSNNU1A1	"愛爾康"可舒視然單片型軟式人工水晶體(可濾部份藍光):黃色軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"ALCON"ACRYSOFT MATURAL STERILE UV-ABSORBING ACRYLIC FOLDABLE SINGLE PIECE POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS	19,200	16,250	
40	04黃色	FALSNNU2A1	"愛爾康愛爾蘭廠"可舒視然單片型軟式人工水晶體(可過濾部分藍光):黃色軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	ACRYSOFT NATURAL SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS	25,000	19,000	
41	05非球面軟式+多焦點+黃色	FALSNMULT0A1	"愛爾康"可舒銳視安智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體※自付差額品項,超過部分由病患自付	"ALCON"ACRYSOFT IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS	-	60,000	
42	05非球面軟式+多焦點+黃色	FALSNWAVE2A1	"愛爾康"可舒銳視安智慧型非球面多焦點單片型軟式人工水晶體(可濾部份藍光)※自付差額品項,超過部分由病患自付	ACRYSOFT IQ RESTOR MULTIFOCAL IOL	62,256	60,000	
43	06散光非球面軟式	FALSNTO1RC1A2	"眼力健"添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體:散光非球面軟式人工水晶體(自付差額)	"AMO"TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS	45,136	45,000	

表1「特殊功能人工水晶體」之各特材品項收取自付差額上限金額明細表

項次	功能類別	特材代碼	中文品名	英文品名	90百分位 (104.1.1生效)	70百分位 (105.1.1生效)	備註
44	06散光非球面軟式	FALSNT0RCARY	"銳能"散光非球面人工水晶體※自付差額品項，超過部分由病患自付	"RAYNER" T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENSES	47,956	45,000	
45	07調節式	FALSNCRYA0B9	"博士倫"晶鑽非球面調節式人工水晶體※自付差額品項，超過部分由病患自付	"BAUSCH ? LOMB" CRYSTALENS ASPHERIC OPTIC ACCOMMODATING INTRAOCULAR LENS	90,856	89,256	
46	07調節式	FALSNCRYHDB9	"博士倫"晶鑽調節式人工水晶體※自付差額品項，超過部分由病患自付	"BAUSCH ? LOMB" CRYSTALENS ACCOMMODATING INTRAOCULAR LENS	95,000	95,000	
47	08非球面軟式+多焦點+散光+黃色	FALSNMULTTA1	"愛爾康"可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體(可濾部分藍光)(自付差額)	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS	95,000	92,000	
48	08非球面軟式+多焦點+散光+黃色	FALSNMULTVA1	"愛爾康"可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體(自付差額)	"ALCON" ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS	-	89,256	
49	09多焦點+散光	FALSNMULT3RY	"銳能"多焦點散光推注式人工水晶體※自付差額品項，超過部分由病患自付	"RAYNER" M-FLEX TORIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENSES	82,256	82,256	
50	09多焦點+散光	FALSNMULT4RY	"銳能"視飛克斯人工水晶體:多焦點散光型※自付差額品項，超過部分由病患自付	"RAYNER" SULCOFLEX HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENSES	82,256	82,256	
51	10非球面軟式+多焦點+散光	FALSNMULT4A2	"眼力健"添視明多焦點散光矯正單片型一片式人工水晶體(自付差額品項)	"AMO" TECNIS TORIC MULTIFOCAL 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS	92,256	90,000	

1. 資料來源:至103年9月23日及104年9月8日醫事服務機構收取自費特材申報檔。

2. 105年1月1日公告之各特材品項以已實施生效達1年以上者，納入訂定差額上限。

3. 收取金額上限值:依醫事服務機構申報自費特材申報檔之各特材品項收費標準分布之90及70百分位值為訂定差額上限值。

表2「塗藥或特殊塗層血管支架」之各特材品項收取自付差額上限金額明細表

項次	功能類別	特材代碼	中文名稱	英文名稱	收取自付差額上限值 (105年1月1日生效)	備註
1	塗藥或特殊塗層血管支架	CBP06ELUT1AB	"亞培"艾諾莉萊斯冠狀動脈塗藥支架系統(自付差額)	"ABBOTT"XIENCE V EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM	60860	107年刪除
2	塗藥或特殊塗層血管支架	CBP06ELUT1BB	"柏朗"普利斯萊斯冠狀動脈塗藥支架系統(自付差額)	"B.BRAUN"COROFLEX PLEASE PACLITAXEL-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM	50363	107年刪除
3	塗藥或特殊塗層血管支架	CBP06ELUT1BK	"百多力"歐德樂西羅莫司冠狀動脈塗藥支架系統(自付差額)	"BIOTRONIK"ORSIRO SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM	55167	
4	塗藥或特殊塗層血管支架	CBP06ELUT1QR	漢瑞爾拜歐邁冠狀動脈塗藥支架系統(自付差額)	MERILBIOMIME SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM	56860	
5	塗藥或特殊塗層血管支架	CBP06ELUT1TM	"泰爾茂"諾博樂冠狀動脈塗藥支架系統(自付差額)	"TERUMO"NOBORI DRUG ELUTING STENT SYSTEM	57467	
6	塗藥或特殊塗層血管支架	CBP06ELUT1YV	"喜安汀"真神奧普帝馬塗藥冠狀動脈血管支撐架(自付差額)	"CID"JANUS OPTIMA CARBOSTENT WITH DELIVERY SYSTEM	59767	已刪除
7	塗藥或特殊塗層血管支架	CBP06ELUT2BS	"柏盛"拜美翠弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統(自付差額)	"BIOSENSORS"BIOMATRIX FLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM	57817	
8	塗藥或特殊塗層血管支架	CBP06ELUT2SB	"波士頓科技"塔克斯萊斯冠狀動脈塗藥支架系統(自付差額)	"BOSTON SCIENTIFIC"LIBERTE MONORAIL PACLITAXEL-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM	55952	
9	塗藥或特殊塗層血管支架	CBP06ELUT3AB	"亞培"賽恩斯優艾諾莉萊斯冠狀動脈塗藥支架系統(自付差額)	"ABBOTT"XIENCE PRIME EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM	60687	
10	塗藥或特殊塗層血管支架	CBP06ELUT3M4	"美敦力"苗得美律動釋放型冠狀動脈支架系統(自付差額)	"MEDTRONIC"ENDEAVOR RESOLUTE ZOTAROLIMUS- ELUTING CORONARY STENT SYSTEM	56952	
11	塗藥或特殊塗層血管支架	CBP06ELUT4AB	"亞培"賽恩斯征艾諾莉萊斯冠狀動脈塗藥支架系統(自付差額)	"ABBOTT"XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM	59192	
12	塗藥或特殊塗層血管支架	CBP06ELUT4M4	"美敦力"苗得美律動釋放型冠狀動脈支架系統(自付差額)	"MEDTRONIC"ENDEAVOR RESOLUTE ZOTAROLIMUS- ELUTING CORONARY STENT SYSTEM	61214	
13	塗藥或特殊塗層血管支架	CBP06ELUT4SB	"波士頓科技"塔克斯艾勒門萊斯冠狀動脈塗藥支架系統(自付差額)	"BOSTON SCIENTIFIC"LIBERTE MONORAIL PACLITAXEL-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM	48877	
14	塗藥或特殊塗層血管支架	CBP06ELUT5AB	亞培賽恩斯征長型艾諾莉萊斯冠狀動脈塗藥支架系統(自付差額)	"ABBOTT"XIENCE XPEDITION 48 EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM	66752	
15	塗藥或特殊塗層血管支架	CBP06ELUT5M4	"美敦力"律動英泰爾釋放型冠狀動脈支架系統(自付差額)	"MEDTRONIC"ENDEAVOR RESOLUTE ZOTAROLIMUS- ELUTING CORONARY STENT SYSTEM	59313	
16	塗藥或特殊塗層血管支架	CBP06ELUT5SB	"波士頓科技"博謀邁艾勒門萊斯冠狀動脈塗藥支架系統(自付差額)	"BOSTON SCIENTIFIC"LIBERTE MONORAIL PACLITAXEL-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM	58420	
17	塗藥或特殊塗層血管支架	CBP06ELUT6SB	"波士頓科技"博謀邁艾勒門萊斯冠狀動脈塗藥支架系統(自付差額)	"BOSTON SCIENTIFIC"LIBERTE MONORAIL PACLITAXEL-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM	35002	已刪除
18	塗藥或特殊塗層血管支架	CBP06ELUT7SB	波士頓科技"博謀邁帕米爾艾諾莉萊斯冠狀動脈塗藥支架系統(自付差額)	"BOSTON SCIENTIFIC"LIBERTE MONORAIL PACLITAXEL-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM	60917	
19	塗藥或特殊塗層血管支架	CBP06ELUT1HC	"海斯凱"泰坦2冠狀動脈血管支架(自付差額)	"HEXACATH"PREMOUNTED CORONARY STENT HELISTENT TITAN2	35002	
20	塗藥或特殊塗層血管支架	CBP06ELUT1RB	"奧爾"傑納斯冠狀動脈血管輸送系統(自付差額)	"ORBUS"GENOUS R STENT	51860	107年刪除

-
1. 資料來源:至104年9月8日醫事服務機構收取自費特材申報檔。
 2. 各特材品項以已實施生效達1年以上者，納入訂定差額上限
 3. 收取金額上限值:依醫事服務機構申報自費特材申報檔之各特材品項收費標準分布之70百分位值為訂定差額上限值。

討論案 1

有關「台灣曲克股份有限公司」建議將用於急重症病童急救時之必要特材「"曲克"拋棄式骨內注射針」納入健保給付案，提請討論。

用於急重症病童急救時 之骨內注射特材

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第34次(107年9月)會議
107年09月20日

提案摘要(1)

案由：有關「臺灣曲克股份有限公司」建議將用於急重症病童急救時之必要特材「”曲克”拋棄式骨內注射針」納入健保給付案。

依據：按107年8月份特殊材料專家諮詢會議結論辦理。

說明：

- 本案原由台灣兒童急診醫學會於107年2月22日函請衛生福利部將「拋棄式骨內注射針」納為健保醫療服務給付項目暨各醫療院所兒童急重症單位應備之必要醫療器材。
- 本案特材為當兒童在心跳停止、呼吸停止、休克或癲癇重積狀態等緊急狀況下，無法立即建立靜脈輸液管道時，透過骨內注射針緊急建立骨髓輸液通道，以及時提供所需之急救藥物與輸液。

提案摘要(2)

說明：

- 美國心臟學會長期亦將「骨髓穿刺通路的建立」列為兒童高級生命支持(簡稱PALS)課程的必要學習項目，作為兒童生命瀕臨危險時重要的醫療急救訓練，以因應臨床緊急醫療需求。
- 骨內靜脈叢不會因休克或脫水塌陷，所以骨內注射是有效率替代靜脈注射的選擇。

建議：屬創新功能特材，建議納入健保給付。

討-1


3

治療方式簡介

□骨內注射(Intraosseous, IO route)

📖 骨內注射是最快建立輸液通道的方式；當一名病童需要補充輸液或藥物卻找不到良好的周邊靜脈輸注時，可轉向找適合的骨頭以建立骨內注射；骨內注射需於進行局部麻醉後，將針尖穿刺入骨頭骨髓腔中置入骨內注射導管；新生兒的骨髓富含血管，長骨的骨髓腔可快速吸收補充輸液或藥物。

📖 骨內注射的禁忌症包括長骨骨折、血管受傷的肢體、骨頭上方的皮膚感染、導管置入部位燒燙傷、已置入或嘗試置入多次，及骨骼脆弱(成骨不全症或骨質疏鬆)；然而，對大部分人而言骨內注射是非常安全的。

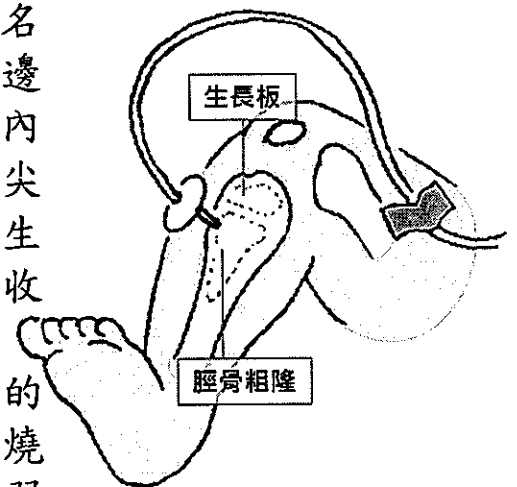



討-1

4

本案特材簡介(1)

□“曲克”拋棄式骨內注射針

- 當小孩緊急需要注射藥物或液體時，拋棄式骨內注射針可提供除了靜脈通道的額外選擇。
- 建議使用在24個月以下的孩童，不建議使用超過24小時。骨內注射針是針/把手組合，在針遠端1cm處有標記並帶有套針、穿刺針、或筆型尖端。

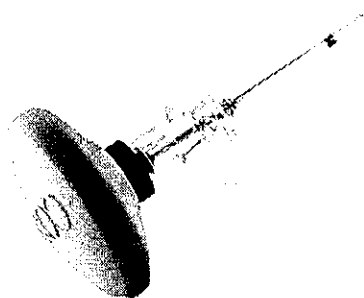

圖片出處：<https://www.cookmedical.com>
圖片出處：<https://www.sciencedirect.com>

5

本案特材簡介(2)

□ 本案特材與傳統治療方式之比較

比較項目	本案特材	傳統治療方式
	拋棄式骨內注射針	靜脈注射系統 (周邊靜脈 或 中央靜脈)
使用時機	如在3次嘗試或短時間內無法建立靜脈通道，就可以選擇替代性的骨內注射。	一般狀況會優先使用周邊靜脈注射或使用中央靜脈導管輸藥或輸液。
通道塌陷問題	骨內靜脈叢不會因休克或脫水而塌陷，能夠有效率替代靜脈注射。	靜脈血管可能因休克或脫水而塌陷導致無法輸注急救藥物。
其他	骨內注射可以拯救性命是因為操作簡單、安全快速。	如發生傳統方式無法進行緊急輸藥/輸液的狀況，病患很可能會失去生命。

資料出處：依廠商提供之建議書說明

廠商建議資料

品項	廠商建議價格	廠商預估	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
“曲克”拋棄式骨內注射針	3,000元	數量	90支	100支	110支	120支	130支
		特材費用	27萬元	30萬元	33萬元	36萬元	39萬元

註：廠商依公司歷年銷售量推估

討-1

7

公立醫院採購價及自費比價網價格彙整

品項	公立醫院採購價				自費醫材比價網			
	家數	中位數	平均數	最低價	家數	中位數	平均數	最低價
“曲克”拋棄式骨內注射針	5	3,200	3,160	3,000	--	查無資料		

註1：本案特材查無國際價格。

註2：本案特材未登載於本署全球資訊網「全民健保尚未納入給付特材品項表」，故無自費資料。

討-1

8

建議支付點數

□採計方式

📖 本案特材未登載於本署全球資訊網「全民健保尚未納入給付特材品項表」，故無自費資料；公立醫院採購價高於廠商建議價，故建議採廠商建議價格，以每支3,000點暫予支付。

討-1

9

財務預估

品項	暫核點數	項目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
“曲克”拋棄式 骨內注射針	3,000點	使用量	200支	200支	200支	200支	200支
		預估點數	60萬點	60萬點	60萬點	60萬點	60萬點

註：台灣兒童急診醫學會建議本案特材之使用量視病患狀況而定，通常每次約使用1~2支，依該學會推估年使用量約為200支。

討-1

10

特材基本資料

特材名稱	“曲克”拋棄式骨內注射針 “Cook” Disposable Intraosseous Infusion Needles		
許可證字號	衛署醫器輸字第016662號	發證日期	95/06/09
廠商名稱	台灣曲克股份有限公司		
製造廠名稱	Cook Incorporated	製造國別	美國
特材大類碼	針具類(N)	特材小類碼	留置針(D)
使用科別	急診醫學科。		
規格	14~18Gage；2.5~4cm。		
材質	Needle cannula, Stylet：Stainless Stell；Syringe Knob Polyamide Nylon 6；Luer lock, Bow Tie Baseplate：Brass。		
適應症	當小孩緊急需要注射藥物或液體時，拋棄式骨內注射針可提供一個除了靜脈通道的額外選擇。		
廠商建議價	3,000元/組		

107 年 8 月份特殊材料專家諮詢會議紀錄
(時間：107 年 8 月 23 日(星期四)上午 9 時 30 分)

六、案由：有關台灣曲克股份有限公司建議將用於急重症病童急救時之必要特材「"曲克"拋棄式骨內注射針」納入健保給付案。

說明：

- (一) 本案特材為當兒童在心跳停止、呼吸停止、休克或癲癇重積狀態等緊急狀況下，無法立即建立靜脈輸液管道時，透過骨內注射針緊急建立骨髓輸液通道，以及時提供所需之急救藥物與輸液，美國心臟學會長期亦將「骨髓穿刺通路的建立」列為兒童高級生命支持(簡稱 PALS)課程的必要學習項目，作為兒童生命瀕臨危險時重要的醫療急救訓練，以因應臨床緊急醫療需求。
- (二) 本案特材目前無正確相對應之診療項目，台灣兒童急診醫學會提供與旨揭醫材使用方式最近似之診療項目為「中央靜脈導管置入術(代碼為 47015B)」，另本署已函請該學會盡速向本保險提出新增醫療服務給付項目及支付標準診療項目之申請，以符合臨床實際提供醫療服務現況。
- (三) 台灣兒童急診醫學會建議本案特材之使用量視病患狀況而定，通常每次約使用 1~2 支，考量本案特材為急重症病童急救時必要之醫材，建議不須訂定給付規定。

結論：骨內注射在兒童可作為傳統靜脈輸液的首選替代途徑，是一種快速、安全、有效的給藥或輸液的血管通路，為兒童臨床急救上必要使用之特殊材料，建議納入健保給付。

- (一) 建議功能類別：創新功能特材。
- (二) 建議支付點數：本案特材未登載於本署全球資訊網「全

民健保尚未納入給付特材品項表」，故無自費資料；公立醫院採購價高於廠商建議價，故建議採廠商建議價格，以每支 3,000 點暫予支付。

(三) 預估年使用量：依台灣兒童急診醫學會推估年使用量為 200 支。

討論案 2

有關「巴德股份有限公司」建議將應用於股、髂及腎動脈之 PTA 治療特材「"巴德"康格斯特 40 經皮穿刺血管成形術導管」納入健保給付再提會案。

用於周邊動脈血管之經皮穿刺 血管成形術治療之特材

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第34次(107年9月)會議
107年09月20日

討-2

提案摘要(1)

案由：有關「巴德股份有限公司」建議將用於股、髂及腎動脈之PTA治療特材「“巴德”康格斯特40經皮穿刺血管成形術導管」納入健保給付再提會案。

依據：按107年8月特殊材料專家諮詢會議結論辦理。

說明：

- 本案經107年5月本會議討論，其會議決議：相較健保已給付之「周邊血管及微血管擴張/氣球擴張導管」，更具臨床療效，同意納入健保給付，惟考量本案特材並未定訂給付規定，為避免納入健保後有濫用之虞，請相關學會，訂定合宜之給付規定或使用量。
- 台灣胸腔及心臟血管外科學會及台灣血管外科學會分別於107年7月5日及7月17日回復本組，建議給付規定如下：

提案摘要(2)

說明：

(一)台灣胸腔及心臟血管外科學會：

- 1、自體或人工合成洗腎動靜脈流管的阻塞性病灶。
- 2、無法以一般順應性球囊擴張之病灶(包括股、髂、腎等其他周邊動脈或內臟血管系統之血管成形術或支架置放手術。

(二)台灣血管外科學會：

周邊血管或血液透析動靜脈瘻管通路之狹窄阻塞性病灶，無法以現有之超高壓球囊導管24-30大氣壓ATM完全擴張。

提案摘要(3)

說明：

- 本案特材簡介、治療方式、國際價格及採購價格等資料詳107年5月討論案第3案簡報檔(詳附件)。

建議：屬功能改善特材，建議納入健保支付。

建議支付點數

□採計方式

📖 依107年5月本會議建議支付方式，依既有功能類別「血管氣球導管(PTA*)/EA/周邊血管及微血管擴張」之支付點數(5,130點)，及更具臨床療效加算15% (5,130點*1.15=5,899點)，以每支5,899點暫予支付。

□建議給付規定

增修給付規定	原給付規定
周邊血管或血液透析動靜脈瘻管通路之狹窄阻塞性病灶，無法以一般球囊導管完全擴張(包括股、髂、腎等其他周邊動脈或內臟血管系統之血管成形術或支架置放手術)。	(無)

討-2

5

財務預估

品項	暫核點數	項目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
“巴德”康格斯特40經皮穿刺血管成形術導管	5,899點	使用量	1,000支	1,100支	1,210支	1,331支	1,464支
		預估點數	590萬點	649萬點	713萬點	784萬點	864萬點
		推估實際點數	【5,899*(1,000~1,464)】－【(5,130*1.75)*(1,000~1,464)】＝-307萬~-450萬點。				

註：1.依本案適用之診療項目「血管整形術(單純/複雜性)」及特材類別「周邊血管氣球導管(功能類別：CBB01;CBB03)」105年之人次與申報量分析，平均使用量：2.75支/人次(98,038支/35,600人)。

2.依專家建議，本案之病患在進行血管擴張時，有些狀況會先使用1支健保給付類似品(周邊氣球導管細管徑)進行探查，再依病情使用不同管徑之氣球導管(如本案特材)治療，爰本品納入支付後，將可取代1.75支健保支付之氣球導管，應不會影響健保財務。

3.使用量：考量現行周邊血管氣球擴張處置案件屬定額給付條件及設有給付規定下，推估將取代1%現有健保給付之「周邊血管氣球導管」，依105年及106年平均申報量計算，預估第1年使用量約為1,000支，第2至第5年再依成長率10%計算，預估2-5年使用量。

討-2

6

特材基本資料

特材名稱	“巴德”康格斯特40經皮穿刺血管成形術導管 “Bard” Conquest 40 PTA Dilatation Catheter		
許可證字號	衛部醫器輸字第027045 號	發證日期	104/03/11
廠商名稱	巴德股份有限公司		
製造廠名稱	BARD PERIPHERAL VASCULAR, INC.	製造國別	美國
特材大類碼	套管類 (C)	特材小類碼	氣球擴張導管(B)
使用科別	心臟內科、心臟外科、放射科。		
規格	氣球直徑：4-12mm，氣球長度：2-10cm，工作長度：50、75cm。		
材質	Balloon: Poly Ethylene Teraphalate		
適應症	本產品建議用於股(femoral)、髂(iliac)及腎(renal)動脈的經皮穿刺血管成形術(Percutaneous Transluminal Angioplasty)，並適合治療自體或人工合成洗腎動靜脈瘻管的阻塞性病灶。此裝置也建議用於支架(stent)及套膜支架(stent graft)植入後周邊脈管系統的擴張。此導管不得用於冠狀動脈。		
廠商建議價	8,000元	討-2	7

特殊材料 107 年 8 月份專家諮詢會議紀錄
(時間：107 年 8 月 23 日(星期四)上午 9 時 30 分)

三、案由：有關巴德股份有限公司建議將應用於股、髂及腎動脈之 PTA 治療特材「"巴德"康格斯特 40 經皮穿刺血管成形術導管」納入健保給付案。

說明：

- (一) 本案特材具有高壓(充氣到最大 40ATM)及非順應性球囊，可針對血管阻塞或狹窄進行擴張，按 107 年 5 月藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議結論相較健保已給付之「周邊血管及微血管擴張/氣球擴張導管」，更具臨床療效，同意納入健保給付，請相關學會，訂定合宜之給付規定或使用量。
- (二) 台灣胸腔及心臟血管外科學會及台灣血管外科學會建議給付規定如下：
 1. 周邊血管或血液透析動靜脈瘻管通路之狹窄阻塞性病灶。
 2. 無法以一般順應性球囊擴張之病灶(包括股、髂、腎等其他周邊動脈或內臟血管系統之血管成形術或支架置放手術)。
- (三) 使用量：
 1. 專家建議本案之病患在進行血管擴張時，有些狀況會先使用 1 支健保給付類似品(周邊氣球導管細管徑)進行探查，再依病情使用不同管徑之氣球導管(如本案特材)治療，爰本品納入支付後，將可取代 1.75 支健保支付之氣球導管，應不會影響健保財務。
 2. 考量現行周邊血管氣球擴張處置案件屬定額給付條件及

設有給付規定下，推估將取代 1%現有健保給付之「血管氣球導管」，依 105 年及 106 年平均申報量計算，預估第 1 年使用量為 1,000 支。

結論：

- (一) 建議功能類別：功能改善特材。
- (二) 建議支付點數：依既有功能類別「血管氣球導管(PTA*)/EA/周邊血管及微血管擴張」之支付點數 (5,130 點)，及更具臨床療效加算 15% ($5,130 \times 1.15 = 5,899$ 點)，以每支 5,899 點暫予支付。
- (三) 建議給付規定：周邊血管或血液透析動靜脈瘻管通路之狹窄阻塞性病灶，無法以一般球囊導管完全擴張 (包括股、髂、腎等其他周邊動脈或內臟血管系統之血管成形術或支架置放手術)。
- (四) 附帶結論：本案之臨床使用量較難預估，建議觀察納入健保給付 1 年後，再行評估檢討。

**全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第 32 次（107 年 5 月）會議紀錄**

第3案：有關「巴德股份有限公司」建議將應用於股、髂及腎動脈之 PTA 治療特材「"巴德"康格斯特40經皮穿刺血管成形術導管」納入健保給付案。

說明：詳附錄會議資料討論案第3案之報告內容。

決定：

- (一)本案特材屬功能改善特材，適用於周邊血管擴張治療，相較健保已給付之「周邊血管及微血管擴張/氣球擴張導管」，其超高壓（充氣到最大 40ATM）及非順應性球囊(Ultra non-compliant balloon)，可針對血管阻塞或狹窄進行擴張，更具臨床療效，同意納入健保給付。
- (二)為避免本案特材納入健保後有濫用之虞，建議請相關學會，訂定合宜之給付規定或使用量後再議。

用於周邊動脈血管之經皮穿刺 血管成形術治療之特材

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第32次(107年5月)會議
107年05月24日

提案摘要

案由：有關「巴德股份有限公司」建議將應用於股、髂及腎動脈之PTA治療特材「“巴德”康格斯特40經皮穿刺血管成形術導管」納入健保給付案。

依據：按107年1月份特殊材料專家諮詢會議結論辦理。

說明：

- 本案特材適用於周邊血管擴張治療，具有超高壓及非順應性球囊(Ultra non-compliant balloon)，可充氣到最大40ATM，。
- 本案特材相較健保已給付之「周邊血管及微血管擴張/氣球擴張導管」，其高壓特性，可針對嚴重血管阻塞或狹窄進行擴張，具臨床療效。


建議：屬功能改善特材，建議納入健保支付。

治療方式簡介

□血管整形術 (PTA)

📖 對於長期洗腎病人而言，動靜脈瘻管血管通路狹窄或阻塞容易影響洗腎的功效，進而影響生活品質。

📖 血管整形術是利用氣球將血管狹窄的部位撐開，使動靜脈瘻管的血流得以恢復正常。

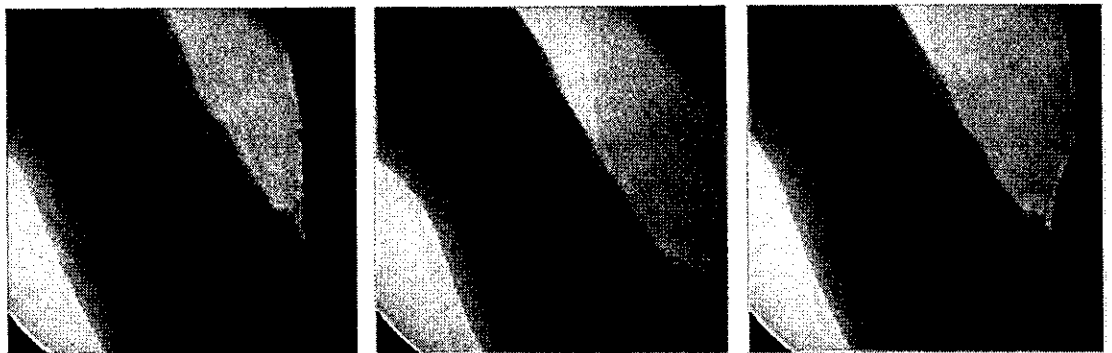


圖片出處：http://www.dachien.com.tw/center_cardiovascular/tuition_detail.php?id=48

本案特材簡介(1)

□“巴德”康格斯特40經皮穿刺血管成形術導管

📖 本產品包含沿導線推入的導管(over-the-wire catheter)以及固定在遠端的氣球。具有超高壓及非順應性球囊(ultra non-compliant low profile)，可不受高壓影響，其氣球最大充氣達40ATM，可擴張較硬或鈣化的狹窄血管。沿導線推入的導管與0.035”導線相容，有50 cm 75 cm 的工作長度可供選擇。

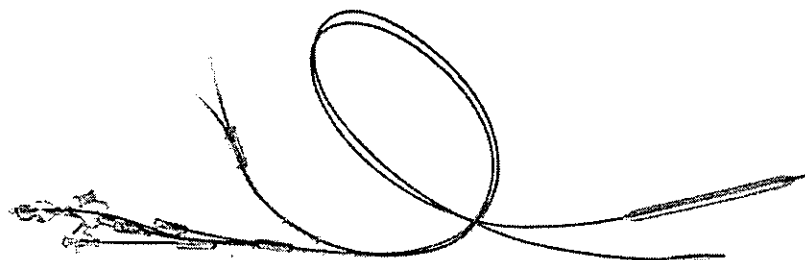

圖片出處：<https://www.crbard.com/Peripheral-Vascular/en-US/Products/CONQUEST-40-PTA-Dilatation-Catheters>

本案特材簡介(2)

□ 本案特材與健保已支付特材之比較

比較項目	本案特材	健保支付特材
	“巴德”康格斯特40經皮穿刺血管成形術導管	周邊血管及微血管治療導管
		支付點數：5,130點
爆破壓力	最大40ATM	14~16 ATM;部分產品可達30ATM
較硬或嚴重狹窄部位	可充氣到更高壓力且不會造成血管過度擴張，氣球不會呈現狗骨頭或壓扁狀。	高壓下，氣球易變形、對於狹窄部位需反覆使用球囊進行擴張。

5

廠商建議資料

品項	廠商建議價格	廠商預估	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
“巴德”康格斯特40經皮穿刺血管成形術導管	8,000元	數量	2,100支	2,250支	2,400支	2,550支	2,700支
		特材費用	1,680萬元	1,800萬元	1,920萬元	2,040萬元	2,160萬元

6

相關診療項目

診療項目代碼	中文項目名稱	英文項目名稱	支付點數
33074B	單純性血管整形術	P.T.A. (percutaneous transluminal angioplasty): simple	10,800
33115B	複雜性血管整形術	P.T.A. (percutaneous transluminal angioplasty): complex	20,250

7

國際價格

		新特材1	
國別	匯率 107.01-03	當地價格	“巴德”康格斯特40經皮穿 刺血管成形術導管
幣別		外幣	台幣
美國	30.44	--	--
日本	0.27	--	--
韓國	0.03	233,170	6,995
澳洲	23.34	--	--
中位數			6,995
國際最低價			6,995
廠商建議價			8,000

註：本案公立醫院採購價及自費比價網均查無資料。

8

建議支付點數

□採計方式

📖 建議依既有功能類別「血管氣球導管(PTA*)/EA/周邊血管及微血管擴張」之支付點數(5,130點)，及更具臨床療效加算15% ($5,130 \text{ 點} \times 1.15 = 5,899 \text{ 點}$)，以每支5,899點暫予支付。

9

財務預估

品項	暫核點數	項目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
“巴德”康格斯特40經皮穿刺血管成形術導管	5,899點	使用量	2,893支	3,375支	3,857支	4,339支	4,821支
		預估點數	1,706萬點	1,990萬點	2,275萬點	2,559萬點	2,843萬點
		實際點數	$5,899 \times (2,893 \sim 4,821) - [(5,130 \times 1.75) \times (2,893 \sim 4,821)]$ =-890萬~-1,483萬點。				

註：1.依本案適用之診療項目「血管整形術(單純/複雜性)」及特材類別「血管氣球導管(功能類別：CBB01;CBB03)」105年之人次與申報量分析，平均使用量：2.75支/人次(98,038支/35,600人)。

2.使用量：依專家建議，約有3~5%「血管氣球導管(功能類別：CBB01)」(106年申報量：96,439支)會使用本案特材，爰預估使用量為2,893支~4,821支。

3.另適用本案之病患在進行血管擴張時，會先使用1支健保給付類似品(周邊氣球導管細管徑)進行探查，再因病情;使用不同管徑之氣球導管(如本案特材)治療，爰本品納入支付後，應將可取代1.75支健保支付之氣球導管，故不會影響健保財務。

10

特材基本資料

特材名稱	“巴德”康格斯特40經皮穿刺血管成形術導管 “Bard” Conquest 40 PTA Dilatation Catheter		
許可證字號	衛部醫器輸字第027045 號	發證日期	104/03/11
廠商名稱	巴德股份有限公司		
製造廠名稱	BARD PERIPHERAL VASCULAR, INC.	製造國別	美國
特材大類碼	套管類 (C)	特材小類碼	氣球擴張導管(B)
使用科別	心臟內科、心臟外科、放射科。		
規格	氣球直徑：4-12mm，氣球長度：2-10cm，工作長度：50、75cm。		
材質	Balloon: Poly Ethylene Teraphalate		
適應症	本產品建議用於股(femoral)、髂(iliac)及腎(renal)動脈的經皮穿刺血管成形術(Percutaneous Transluminal Angioplasty)，並適合治療自體或人工合成洗腎動靜脈瘻管的阻塞性病灶。此裝置也建議用於支架(stent)及套膜支架(stent graft)植入後周邊脈管系統的擴張。此導管不得用於冠狀動脈。		
廠商建議價	8,000元		

107 年 1 月份特殊材料專家諮詢會議紀錄
(時間：107 年 1 月 25 日(星期四)上午 9 時)

(五)案由：有關「巴德股份有限公司」建議將應用於股、髂及腎動脈之 PTA 治療特材「"巴德"康格斯特 40 經皮穿刺血管成形術導管」納入健保給付案。

說明：

1. 本案特材之氣球為 PET (Dacron)材質，具有超高壓及非順應性球囊(Ultra non-compliant balloon)，可充氣到最大 40ATM。
2. 相較健保已給付之「周邊血管及微血管擴張/氣球擴張導管」，其高壓特性，可針對血管阻塞或狹窄進行擴張，更具臨床療效。

結論：

1. 屬功能改善特材，本案特材具超高壓特性，可擴張包括自體或人工合成洗腎動靜脈瘻管阻塞、支架及套膜支架植入後，周邊脈管系統再次狹窄等患者，建議納入健保給付。
2. 建議支付方式：建議依既有功能類別「血管氣球導管(PTA*) / EA / 周邊血管及微血管擴張」之支付點數(5,130 點)，及更具臨床療效加算 15% (5,130 點*1.15=5,899 點)，以每支 5,899 點暫予支付。

台灣胸腔及心臟血管外科學會 函

會址：241 新北市三重區五福街 18 號 5 樓

電話：(02)29871020 江麗雲

傳真：(02)29873126

電子郵件：tatcs10@yahoo.com.tw

受文者：衛生福利部中央健保署

發文日期：中華民國 107 年 7 月 5 日

發文字號：台胸心會（銘）字第 1070106 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：覆 貴署字號” 健保審字第 1070035503” 號，請查收。


說明：

貴署字號” 健保審字第 1070035503” 號，本會回覆意見如附件：

正本：衛生福利部中央健保署

副本：本學會秘書處

理事長 李章銘



學會建議給付規定

* "巴德"康格斯特40 經皮穿刺血管 成形術導管	"索倫"環狀成形術環
1. 自體或人工合成洗腎動靜脈瘤管的 阻塞性病灶。 2. 無法以一般順應性球囊擴張的病灶 （包括股、髂、腎等其他周邊動脈 或內臟血管系統之血管成形術或支 架置放手術）	1. 二尖瓣成形手術適用 及 2. 須使用成形固定二尖瓣環者可考慮使用 及 3. 須使用人工腱索重建二尖瓣者
1-5年使用量預估	1-5年使用量預估
一年：1000/yr 二年：1100/yr 三年：1200/yr 四年：1300/yr 五年：1400/yr	一年：100/yr 二年：120/yr 三年：150/yr 四年：250/yr 五年：250/yr

寄件者: TSVS台灣血管外科學會 <4tsvs@tsvs.org>
寄件日期: 2018年7月17日星期二下午 3:47
收件者: -----
副本: 1 送三軍總醫院主治醫師; 光醫院CVS主任
主旨: Re: 再麻煩學會幫忙
附件: 血管外科 1070035503 回覆建議20180717.docx

您好,

目前回覆經臨床主委、醫師及理事長、醫師整理如下, 請貴署參考, 若不需再增減的話, 我就發正式公文。

一、[☆]“巴德”康格斯特 40 經皮穿刺血管成形術導管

建議給付規定：

現行周邊血管氣球擴張處置中，約有 1-5% 的狹窄病兆無法以目前現有的球囊導管完全擴張，故該品項屬 Ultra High Pressure 球囊導管，球囊可以 40ATM 的壓力擴張狹窄病兆，預期可以增進醫療品質及病患福利。建議予以同意給付，然其單價較原有品項高昂，懇請貴屬幫忙議價。該品項若通過健保給付實施，在現行周邊血管氣球擴張處置案件屬定額給付條件下，應不會有濫用情事，建議尊重專科醫師專業判斷，觀察一年再討論是否需要制定特別使用條件。

使用條件：

周邊血管或血液透析動靜脈瘻管通路之狹窄阻塞性病灶，無法以現有之超高壓球囊導管 24-30 大氣壓 ATM 完全擴張。

二、“索倫”環狀成形術環

建議給付規定：

建議可比照現行二尖瓣環狀成形術環給付規定施行之，而建保差額(58000-20100=37900) 由病患自付而醫療服務給付代碼維持 68015B。

以二尖瓣膜成形手術治療二尖瓣膜逆流，需使用二尖瓣膜環固定成形及人工腱索重建者。

敬祝 時祺

台灣血管外科學會 秘書

=====

ADD: 111 台北市士林區文昌路 95 號 新光 B3 心臟外科辦公室
TEL:

02-28332211#2083

CELL:
0966-877552
OFFICE HOUR: 9 AM - 5 PM
E-mail: 4tsvs@tsvs.org
Website: www.tsvg.org

一、“巴德”康格斯特 40 經皮穿刺血管成形術導管

建議給付規定：

現行周邊血管氣球擴張處置中，約有 1-5% 的狹窄病兆無法以目前現有的球囊導管完全擴張，故該品項屬 Ultra High Pressure 球囊導管，球囊可以 40ATM 的壓力擴張狹窄病兆，預期可以增進醫療品質及病患福利。建議予以同意給付，然其單價較原有品項高昂，懇請貴屬幫忙議價。該品項若通過健保給付實施，在現行周邊血管氣球擴張處置案件屬定額給付條件下，應不會有濫用情事，建議尊重專科醫師專業判斷，觀察一年再討論是否需要制定特別使用條件。

使用條件：

周邊血管或血液透析動靜脈瘻管通路之狹窄阻塞性病灶，無法以現有之超高壓球囊導管 24-30 大氣壓 ATM 完全擴張。

二、“索倫”環狀成形術環

建議給付規定：

建議可比照現行二尖瓣環狀成形術環給付規定施行之，而建保差額 (58000-20100-37900) 由病患自付；而醫療服務給付代碼維持 68015B。

以二尖瓣膜成形手術治療二尖瓣膜逆流，需使用二尖瓣膜環固定成形及人工腱索重建者。

討論案 3

有關「中訊企業有限公司」建議將用於修復心臟二尖瓣閉鎖不全或狹窄之人工瓣膜環特材「"索倫"環狀成形術環」納入健保給付再提會案。

用於修復心臟二尖瓣閉鎖不全 或狹窄之人工瓣膜環特材

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第34次(107年9月)會議
107年09月20日

討-3

提案摘要(1)

案由：有關「中訊企業有限公司」建議將用於修復心臟二尖瓣閉鎖不全或狹窄之人工瓣膜環特材「"索倫"環狀成形術環」納入健保給付再提會案。

依據：按107年8月份特殊材料專家諮詢會議結論辦理。

說明：

- 本案經107年5月本會議討論，相較目前健保給付僅能修復原有瓣膜大小及形狀之「人工瓣膜輪/環」，可同時進行二尖瓣及人工鍵索修補手術，能簡化手術過程，同意納入健保全額給付，為求周延，建議請相關學會訂定合宜之給付規定。
- 台灣胸腔及心臟血管外科學會及台灣血管外科學會分別於107年7月5日及7月17日回復建議，相關內容如下：

提案摘要(2)

說明：

(一)台灣胸腔及心臟血管外科學會：

二尖瓣成形手術且需適用成形固定二尖瓣環及人工腱索重建者。

(二)台灣血管外科學會：

1.建議可比照現行二尖瓣環狀成形術環(診療項目：瓣膜成形術；代碼：68015B)給付規定施行之。

2.以二尖瓣膜成形手術治療二尖瓣膜逆流，需使用二尖瓣膜環固定成形及人工腱索重建者。

➤ 本案特材簡介、治療方式國際價格及採購價格等資料，詳107年5月討論案第4案簡報檔(詳附件)。

建議：屬創新功能特材，建議納入健保支付。

討-3

3

建議支付點數

□採計方式

📖 依107年5月本會議建議支付方式，採公立醫院採購決標價格之中位價，除以收載時最近四季(106年第1季至106年第4季)結算之醫院總額部門浮動點值之平均值，以每組45,372點(40,000/0.8816)暫予支付。

討-3

4

建議給付規定

- 經與會專家及學會代表討論，考量本案特材之材質為鎳鈦合金記憶金屬，且設計特點為進行腱索修補時可測量人工腱索的長度，因可同時執行二尖瓣及人工腱索修補，減少手術時間，故建議給付規定如下：

增修給付規定	原給付規定
1.建議可比照現行二尖瓣環狀成形術環(診療項目：瓣膜成形術；代碼：68015B)給付規定施行之。	(無)
2.以二尖瓣膜成形手術治療二尖瓣膜逆流，需使用二尖瓣膜環固定成形及人工腱索重建者。	

討-3

5

財務預估

品項	暫核點數	項目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
“索倫”環狀成形術環	45,372點	使用量	300個	330個	363個	400個	440個
		預估實際點數	759萬點	835萬點	918萬點	1,012萬點	1,113萬點

註：

1. 使用量：依心臟外科專家表示，本案依病人病情症狀不同及醫師執行方式，在設有給付訂下，以高推估將取代30%健保支付「人工瓣膜輪/硬式或彈性修補環(功能類別:FHVR1)」之使用量(105年及106年申報量分別為972及948個)，再依成長率10%計算，預估1-5年使用量:300~440個($1000 \times 30\% \times 1.1$)
2. 預估點數：扣除取代「人工瓣膜輪/彈性修補環」之支付點數20,100點*使用量，本案特材年增加費用約為759萬~1,113萬點。 $(45,413 - 20,100) \times 300 \sim 440$

討-3

6

特材基本資料

特材名稱	“索倫”環狀成形術環 “Sorin” Memo 3D Annuloplasty Ring – Memo 3D Rechord		
許可證字號	衛部醫器輸字第026000號	發證日期	103/03/12
廠商名稱	中訊企業有限公司		
製造廠名稱	Sorin Group Italia S.R.L.	製造國別	義大利
特材大類碼	人工機能代用類(F)	特材小類碼	心臟血管類(H)
使用科別	心臟血管外科。		
規格	24:38mm。		
材質	Nitinol alloy, Silicone, PET等。		
適應症	適用於修復二尖瓣閉鎖不全或狹窄。		
廠商建議價	58,000元/組		

特殊材料 107 年 8 月份專家諮詢會議紀錄
(時間：107 年 8 月 23 日(星期四)上午 9 時 30 分)

四、案由：有關「中訊企業有限公司」建議將用於修復心臟二尖瓣閉鎖不全或狹窄之人工瓣膜環特材「“索倫”環狀成形術環」納入健保給付案。

說明：

- (一) 本案按 107 年 5 月份藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議結論為相較目前健保給付僅能修復原有瓣膜大小及形狀之「人工瓣膜輪/環」，可同時進行二尖瓣及人工腱索修補手術，能簡化手術過程，同意納入健保全額給付，建議請相關學會訂定合宜之給付規定。
- (二) 經與會專家及學會代表討論，考量本案特材之材質為鎳鈦合金記憶金屬，且設計特點為進行腱索修補時可測量人工腱索的長度，另可同時執行二尖瓣及人工腱索修補，減少手術時間，故台灣胸腔及心臟血管外科學會及台灣血管外科學會建議給付規定如下：
 1. 建議可比照現行二尖瓣環狀成形術環(診療項目：瓣膜成形術；代碼：68015B)給付規定施行之。
 2. 二尖瓣膜成形手術且需適用二尖瓣膜環固定成形及人工腱索重建者。

結論：

- (一) 建議功能類別：創新功能特材。
- (二) 建議支付點數：採公立醫院採購決標價格之中位價 40,000 元，除以收載時最近四季結算(106 年第 1 季至 106 年第 4 季)之醫院總額部門浮動點值之平均值，以每組 45,372 點 $(40,000/0.8816)$ 點暫予支付。

(三) 建議給付規定：

- 1.建議可比照現行二尖瓣環狀成形術環(診療項目：瓣膜成形術；代碼：68015B)給付規定施行之。
- 2.以二尖瓣膜成形手術治療二尖瓣膜逆流，需使用二尖瓣膜環固定成形及人工腱索重建者。

全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議

特材部分第 32 次（107 年 5 月）會議紀錄

第4案：有關「中訊企業有限公司」建議將用於修復心臟二尖瓣閉鎖不全或狹窄之人工瓣膜環特材「"索倫"環狀成形術環」納入自付差額品項案。

說明：詳附錄會議資料討論案第4案之報告內容。

決定：

（一）本案特材屬創新功能特材，係金屬合金內芯、外包覆樹脂、滌綸針織環組成，該環後端弧線部分帶有多個由黃色單絲手術線圍成之線圈。相較目前健保給付僅能修復原有瓣膜大小及形狀之「人工瓣膜輪/環」，可同時進行二尖瓣及人工鏈索修補手術，能有效簡化手術過程並提高手術成功率，同意以全額給付方式納入健保給付。

（二）考量本案特材價格較健保給付之「人工瓣膜輪/環」昂貴，為求周延，建議請相關學會，訂定合宜之給付規定後再議。

用於修復心臟二尖瓣閉鎖不全 或狹窄之人工瓣膜環特材

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第32次(107年5月)會議
107年05月24日

提案摘要(1)

案由：有關「中訊企業有限公司」建議將用於修復心臟二尖瓣閉鎖不全或狹窄之人工瓣膜環特材「"索倫"環狀成形術環」納入自付差額品項案。

依據：按107年1月份特殊材料專家諮詢會議結論辦理。

說明：

- 本案特材係金屬合金內芯、外包覆樹脂、滌綸針織環組成，該環後端弧線部分帶有多個由黃色單絲手術線圍成之線圈。

提案摘要(2)

說明：

- 較目前健保支付僅能修復原有瓣膜大小及形狀之「人工瓣膜輪/環」，可同時進行二尖瓣及人工鏈索修補手術，能有效簡化手術過程並提高手術成功率；改善病患之長期預後，臨床使用效益佳。

建議：屬創新功能特材，建議以全額給付方式納入健保支付。


3

疾病簡介

□二尖瓣膜狹窄或閉鎖不全

📖二尖瓣位在左心室和左心房之間，控制著血液的供應，當任何一個瓣膜狹窄時，會妨礙血流由一個腔室流到另一個腔室；若二尖瓣在外觀上變厚、變長，會引起心臟收縮關閉時突向左心房，即是二尖瓣脫垂。

📖而如果二尖瓣鬆動嚴重到「關不住」使得血液逆流回心房，此時稱為「瓣膜閉鎖不全」。

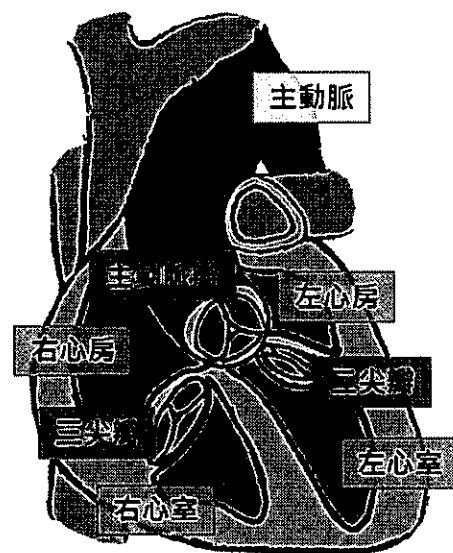

4

治療方式簡介

□瓣膜性心臟病之治療

📖 **藥物治療：**瓣膜一但損壞即無法靠藥物治癒，但藥物可減輕症狀降低心臟惡化程度，損壞程度嚴重時仍需施行外科手術，才可避免心臟衰竭。



📖 **手術治療：**瓣膜性心臟病主要以瓣膜置換或修補手術；瓣膜置換是將病變的瓣膜剪下，換上新的人工瓣膜；瓣膜修補是指將病變的瓣膜保留，只針對有問題的瓣膜結構加以修補。

5

本案特材簡介(1)

□“索倫”環狀成形術環

📖 本品特材為用於修復心臟二尖瓣之環狀成形術環，由金屬合金內芯及包裹金屬合金內芯之矽樹脂和滌綸針織縫合環所組成。滌綸外覆有Carbofilm，為一層很薄的熱解碳塗層；該環後端弧線部分帶有多個由黃色單絲手術線圍成之線圈；線圈由一條藍色單絲手術線固定在環上，共同組成一項可拆卸系統。醫師在植入環狀成形術環時若需要同時進行腱索置換術，則可利用該系統方便地測量人工腱索尺寸。

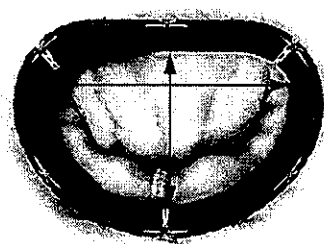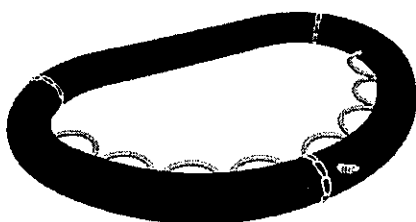

本案特材簡介(2)

□ 本案特材與健保已支付特材之比較

比較項目	本案特材	健保給付特材
	“索倫”環狀成形術環	人工瓣膜輪/彈性修補環，特殊矽膠包覆聚脂絲絨纖維 支付點數：20,100點
圈環造型	馬鞍型環，能延長修補環之壽命並較為貼合主動脈根部，另具有黃色線圈，可在進行腱索修補時作為長度參考工具。	馬鞍型環，能延長修補環之壽命並較為貼合主動脈根部。
材質	鎳鈦合金記憶金屬，受心臟收縮擠壓也能回復原型。Carbofilm(解熱碳塗層鍍膜)增加生物及血液相容性。	由多層(elgiloy)(鈷、鉻、鎳系)非磁性合金及針織聚酯纖維矽膠縫合環組成。

廠商建議資料

品項	廠商建議價格	廠商預估	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
“索倫”環狀成形術環	58,000元	數量	100組	120組	150組	200組	250組
		特材費用	580萬元	696萬元	870萬元	1,160萬元	1,450萬元

相關診療項目

診療項目代碼	中文項目名稱	英文項目名稱	支付點數
68015B	瓣膜成形術	Valvular and/or annuloplasty	46,285

9

國際價格

		新特材1	
國別	匯率 107.01-03	當地價格	“索倫”環狀成形術環
幣別		外幣	台幣
美國	30.44	--	--
日本	0.27	--	--
韓國	0.03	--	--
澳洲	23.34	2,400	56,016
中位數			56,016
國際最低價			56,016
廠商建議價			58,000

10

公立醫院採購價及自費比價網價格彙整

品項	公立醫院採購價				自費醫材比價網			
	家數	中位數	平均數	最低價	家數	中位數	平均數	最低價
“索倫” 環狀成形術環	6	40,000	41,067	40,000	13	55,000	54,269	46,000

11

建議支付點數

□採計方式

 建議採公立醫院採購決標價格之中位價，除以收載時最近四季(105年第4季至106年第3季)結算之醫院總額部門浮動點值之平均值，以每組45,413點(40,000/0.8808)點暫予支付。

12

財務預估

品項	暫核點數	項目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
“索倫” 環狀成形術環	45,413點	使用量	300個	330個	363個	400個	440個
		預估點數 (已扣除既有品項)	759萬點	835萬點	918萬點	1,012萬點	1,113萬點

註：

1. 使用量：依心臟外科專家表示，本案依病人病情症狀不同及醫師執行方式，預估將取代30%健保支付「人工瓣膜輪/硬式或彈性修補環(功能類別:FHVR1)」之使用量(105年及106年申報量分別為972及948個)，再依成長率10%計算，預估1-5年使用量:300~440個($1000 \times 30\% \times 1.1$)
2. 預估點數：扣除取代「人工瓣膜輪/彈性修補環」之支付點數20,100點*使用量，本案特材年增加費用約為759萬~1,113萬點。 $(45,413 - 20,100) \times 300 \sim 440$

13

特材基本資料

特材名稱	“索倫”環狀成形術環 “Sorin” Memo 3D Annuloplasty Ring – Memo 3D Rechorde		
許可證字號	衛部醫器輸字第026000號	發證日期	103/03/12
廠商名稱	中訊企業有限公司		
製造廠名稱	Sorin Group Italia S.R.L.	製造國別	義大利
特材大類碼	人工機能代用類(F)	特材小類碼	心臟血管類(H)
使用科別	心臟血管外科。		
規格	24:38mm。		
材質	Nitinol alloy, Silicone, PET等。		
適應症	適用於修復二尖瓣閉鎖不全或狹窄。		
廠商建議價	58,000元/組		

14

107 年 1 月份特殊材料專家諮詢會議紀錄
(時間：107 年 1 月 25 日(星期四)上午 9 時)

(四)案由：有關「中訊企業有限公司」建議將用於修復心臟二尖瓣閉鎖不全或狹窄之人工瓣膜環特材「"索倫"環狀成形術環」以自付差額品項納入健保給付案。

說明：

1. 本案特材係金屬合金內芯、外包覆樹脂、滌綸針織環組成，該環後端弧線部分帶有多個由黃色單絲手術線圍成之線圈。
2. 相較目前健保給付僅能修復原有瓣膜大小及形狀之「人工瓣膜輪/環」，可同時進行二尖瓣及人工鏈索修補手術，能有效簡化手術過程並提高手術成功率。
3. 可取代部分心臟瓣膜置換，改善病患之長期預後。

結論：

1. 屬創新功能特材，可提升手術成功率，且臨床使用效益佳，建議以全額給付方式納入健保給付。
2. 建議支付方式：建議採公立醫院採購決標價格之中位價，除以收載時最近四季結算之醫院總額部門浮動點值之平均值，以每組 45,361 點($40,000/0.8818$)點暫予支付。

台灣胸腔及心臟血管外科學會 函

會址：241 新北市三重區五福街 18 號 5 樓

電話：(02)29871020 江麗蓉

傳真：(02)29873126

電子郵件：tatcs10@yahoo.com.tw

受文者：衛生福利部中央健保署

發文日期：中華民國 107 年 7 月 5 日

發文字號：台胸心會（銘）字第 1070106 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：覆 貴署字號”健保審字第 1070035503”號，請查收。


說明：

貴署字號”健保審字第 1070035503”號，本會回覆意見如附件：

正本：衛生福利部中央健保署

副本：本學會秘書處

理事長 李章銘



學會建議給付規定

* "巴德"康格斯特40 經皮穿刺血管成形術導管	"索倫"環狀成形術環
1. 自體或人工合成洗腎動靜脈瘤管的阻塞性病灶。 2. 無法以一般順應性球囊擴張的病灶（包括股、髂、腎等其他周邊動脈或內臟血管系統之血管成形術或支架置放手術）	1. 二尖瓣成形手術適用 及 2. 須使用成形固定二尖瓣環者可考慮使用 及 3. 須使用人工腱索重建二尖瓣者
1-5年使用量預估	1-5年使用量預估
一年：1000/yr 二年：1100/yr 三年：1200/yr 四年：1300/yr 五年：1400/yr	一年：100/yr 二年：120/yr 三年：150/yr 四年：250/yr 五年：250/yr

寄件者: TSVS台灣血管外科學會 <4tsvs@tsvs.org>
寄件日期: 2018年7月17日星期二 下午 3:47
收件者: -----
副本: 送三軍總醫院主治醫師; 光醫院CVS主任
主旨: Re: 再麻煩學會幫忙
附件: 血管外科 1070035503 回覆建議20180717.docx

您好,

目前回覆經臨床主委、醫師及理事長、醫師整理如下,請貴署參考,若不需再增減的話,我就發正式公文。

一、[☆]“巴德”康格斯特 40 經皮穿刺血管成形術導管

建議給付規定:

現行周邊血管氣球擴張處置中,約有 1-5%的狹窄病兆無法以目前現有的球囊導管完全擴張,故該品項屬 Ultra High Pressure 球囊導管,球囊可以 40ATM 的壓力擴張狹窄病兆,預期可以增進醫療品質及病患福利。建議予以同意給付,然其單價較原有品項高昂,懇請貴屬幫忙議價。該品項若通過健保給付實施,在現行周邊血管氣球擴張處置案件屬定額給付條件下,應不會有濫用情事,建議尊重專科醫師專業判斷,觀察一年再討論是否需要制定特別使用條件。

使用條件:

周邊血管或血液透析動靜脈瘻管通路之狹窄阻塞性病灶,無法以現有之超高壓球囊導管 24-30 大氣壓 ATM 完全擴張。

二、“索倫”環狀成形術環

建議給付規定:

建議可比照現行二尖瓣環狀成形術環給付規定施行之,而建保差額(58000-20100=37900)由病患自付而醫療服務給付代碼維持 68015B。

以二尖瓣膜成形手術治療二尖瓣膜逆流,需使用二尖瓣膜環固定成形及人工腱索重建者。

敬祝 時祺

台灣血管外科學會 秘書

=====

ADD: 111 台北市士林區文昌路 85 號 新光 B3 心臟外科辦公室
TEL:

0-
2-28332211#2083

CELL
:
0966-877552
OFFICE HOUR: 9 AM - 5 PM
E-mail: 4tsvs@tsvs.org
Website: www.tsvg.org

一、“巴德”康格斯特 40 經皮穿刺血管成形術導管

建議給付規定：

現行周邊血管氣球擴張處置中，約有 1-5% 的狹窄病兆無法以目前現有的球囊導管完全擴張，故該品項屬 Ultra High Pressure 球囊導管，球囊可以 40ATM 的壓力擴張狹窄病兆，預期可以增進醫療品質及病患福利。建議予以同意給付，然其單價較原有品項高昂，懇請貴屬幫忙議價。該品項若通過健保給付實施，在現行周邊血管氣球擴張處置案件屬定額給付條件下，應不會有濫用情事，建議尊重專科醫師專業判斷，觀察一年再討論是否需要制定特別使用條件。

使用條件：

周邊血管或血液透析動靜脈瘻管通路之狹窄阻塞性病灶，無法以現有之超高壓球囊導管 24-30 大氣壓 ATM 完全擴張。

二、“索倫”環狀成形術環

建議給付規定：

建議可比照現行二尖瓣環狀成形術環給付規定施行之，而建保差額 (58000-20100-27900) 由病患自付；而醫療服務給付代碼維持 68015B。

以二尖瓣膜成形手術治療二尖瓣膜逆流，需使用二尖瓣膜環固定成形及人工腱索重建者。

討論案 4

有關適用於頷、顱顏面外科重建手術之特材「客製化電腦輔助型顱顏骨固定系統(TiMesh)」共 9 項自付差額品項納入全額給付。

用於頷、顱顏面外科重建手術之特材

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第34次(107年9月)會議
107年09月20日

討-4

提案摘要(1)

說明：有關適用於頷、顱顏面外科重建手術之特材「客製化電腦輔助型顱顏骨固定系統 (TiMesh)」共9項自付差額品項納入全額給付。

依據：

- 依據衛福部健保會公告「107年度全民健康保險醫療給付費用總額項目及分配方式總額核定費用及分配方式」，有關107年度醫院醫療給付費用總額及其分配方式，編列旨揭自付差額類別特材，納入全額給付之費用預算計2,400萬元辦理。
- 按107年6及8月份特殊材料專家諮詢會議結論辦理。

提案摘要(2)

說明：

- 本案自付差額類別特材為運用電腦輔助設計的技術，在手術前，將病人頭顱斷層掃描的數據輸入電腦軟體，再依據實際顱骨缺損的大小及部位，進行客製化塑型，於106年8月1日起納入健保自付差額特材項目，目前該類品項共9項，健保給付上限為26,239點。
- 本案特材106年8-12月使用量計111組，而健保全額給付近似之功能類別特材「顱顏骨網片固定系統(含微型顱顏骨網片*1及微型顱顏骨釘*12)」106年全年使用量計32組。

提案摘要(3)

說明：

- 考量本案自付差額特材品項間價格差異大，建議以「Mesh規格」分核價類別，以面積120mm*120mm、300mm*300mm為界線區分為3類規格。
- 因本案特材原為自付差額品項，屬功能改善類別特材，爰建議採公立醫院採購價之最低價，除以最近四季結算之醫院部門浮動點值平均計算，或以各層級醫療院所自費價格之最低價計算。
- 考量3D列印恐誘發原以自體顱骨執行頭顱成形術之個案，改使用本案特材，建議訂定給付規定及事前審查。

建議：納入全額給付，並訂定給付規定。

本案品項(1)

廠商	項次	品項	Mesh規格 (mm*mm)		廠商建議價(全額給付價格)
美敦力醫療產品股份有限公司	1	“美敦力”鈦密斯顱骨固定系統-顱骨網片*1+骨釘*12(電腦輔助型)(自付差額)	<u>200*200*0.6</u> <u>152*152*0.6</u> <u>120*120*0.6</u> 128*79*0.6 厚度0.6；1.0		125,000元
亞太醫療器材科技股份有限公司	2	“亞太醫療”網眼骨板骨釘-網眼骨板*1+骨釘*10(電腦輔助型)(自付差額)	40*60 60*80 70*90 80*120 100*120	100*150 <u>120*120</u> <u>120*150</u> <u>150*150</u> <u>150*200</u>	100,000元

討-4

本案品項(2)

廠商	項次	品項	Mesh規格 (mm*mm)	廠商建議價(全額給付價格)
普旌股份有限公司	3	“拜普雷”預成形固定系統-顱骨網片*1+骨釘*16(自付差額)	<u>200*200</u> 厚度0.58	174,544元
	4	“拜普雷”預成形固定系統-顱骨網片*1+骨釘*12(自付差額)	<u>127*131</u> 厚度0.58	113,656元
	5	“拜普雷”預成形固定系統-顱骨網片*1+骨釘*8(自付差額)	90*92 厚度0.58	68,768元
	6	“拜普雷”預成形固定系統-顱骨網片*1+骨釘*8(自付差額)	65*65 厚度0.58	58,168元
	7	“拜普雷”預成形固定系統-顱骨網片*1+骨釘*8(自付差額)	36*52 厚度0.58	52,768元

討-4

本案品項(3)

廠商	項次	品項	Mesh規格 (mm*mm)	廠商建議價 (全額給付價格)
合碩生技 股份有限公司	8	“合碩”顱顏骨固定系統- 骨網(預成形,等厚)*1+骨 釘*12(自付差額)	D=300±299 H=60±59 厚度0.6；1.0	150,000元
	9	“合碩”顱顏骨固定系統- 骨網(預成形,不等厚)*1+ 骨釘*12(自付差額)	D=300±299 H=60±59	200,000元


討-4

疾病治療簡介

□ 頤、顱顏面外科重建手術

📖 顱顏手術對於因先天畸形(顎裂、半邊小臉症、顱縫早閉、顱顏纖維異生、眼距過寬、顏面裂或先天性五官異常...等)、外傷或腫瘤造成之顱顏面骨骼缺損進行重建。

📖 透過手術以改善缺損部位無法提供腦組織有效保護、供血障礙、腦脊液循環異常等問題，以及相關需要外形修復的問題。

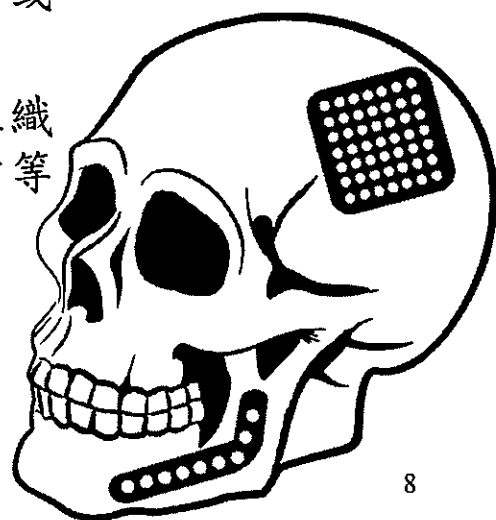


討-4

本案特材簡介(1)(品項1)

□“美敦力”鈦密斯顱骨固定系統

📖 本品特材包含各種大小與形狀的鈦金屬網片及骨螺絲；使用於口-頷-顱-顏外科重建手術，不論是顎骨矯正或創傷治療，利用剛性或半剛性的內部固定裝置，將骨骼碎片固定在一起。

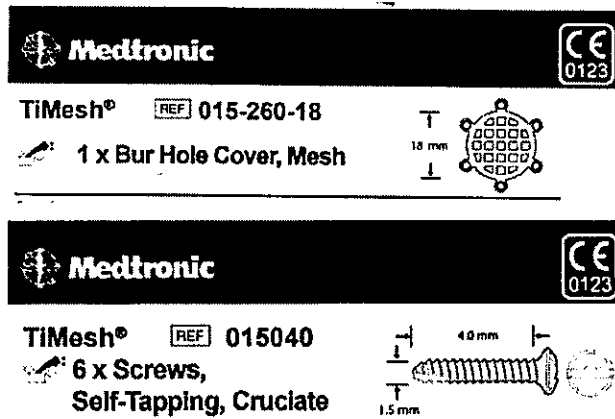

圖片出處 醫藥器材仿單

9


本案特材簡介(2)(品項2)

□“亞太醫療”網眼骨板骨釘

📖 本品特材之骨板骨釘是用以固定顱顏面骨骨折，促進骨折癒合以及患者功能恢復；適用於眼眶孔、側處骨折，竇壁骨折，顱骨骨折，顏面骨折，下頷骨骨折及其它用途輔助性使用。



大圓孔型網眼骨板



菱型網眼骨板




圓孔型網眼骨板



SYNTEC
Scientific Corporation



人字型網眼骨板



田字型網眼骨板



矩型網眼骨板


圖片出處 醫藥器材仿單

10

本案特材簡介(3)(品項3-7)

□“拜普雷”預成形固定系統

📖 本品特材具有多種鈦組件，包含自鑽和自攻微型骨釘(micro screws)、微型骨板(micro plates)；適用於需要以金屬內固定器來對齊及固定顱顏骨組織，包含但不限於顱骨重建及顱骨創傷骨折的修補。

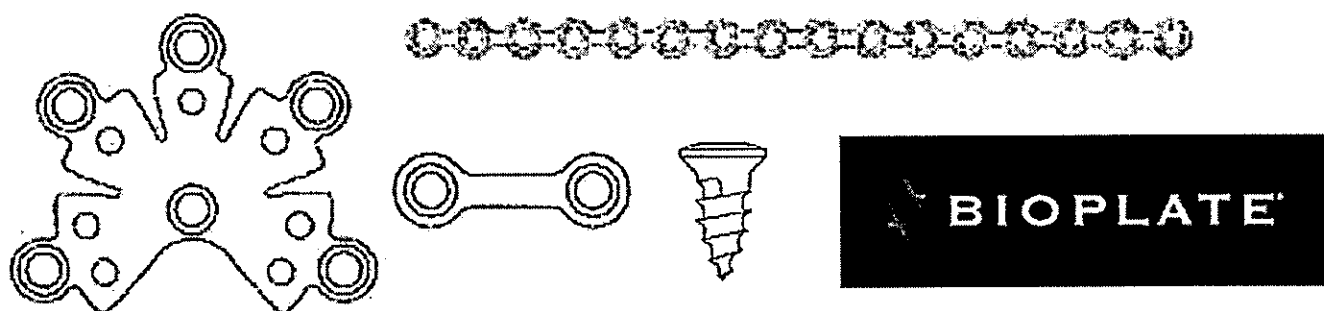


圖片出處 醫器品特材仿單

11

本案特材簡介(4)(品項8-9)

□“合碩”顱顏骨固定系統

📖 本品特材用以固定顱顏面骨骨折，促進骨折癒合，內含顱骨固定夾、顱顏骨固定骨釘、顱顏骨固定骨板、顱骨鑽孔蓋、顱顏骨固定網片...等組件。

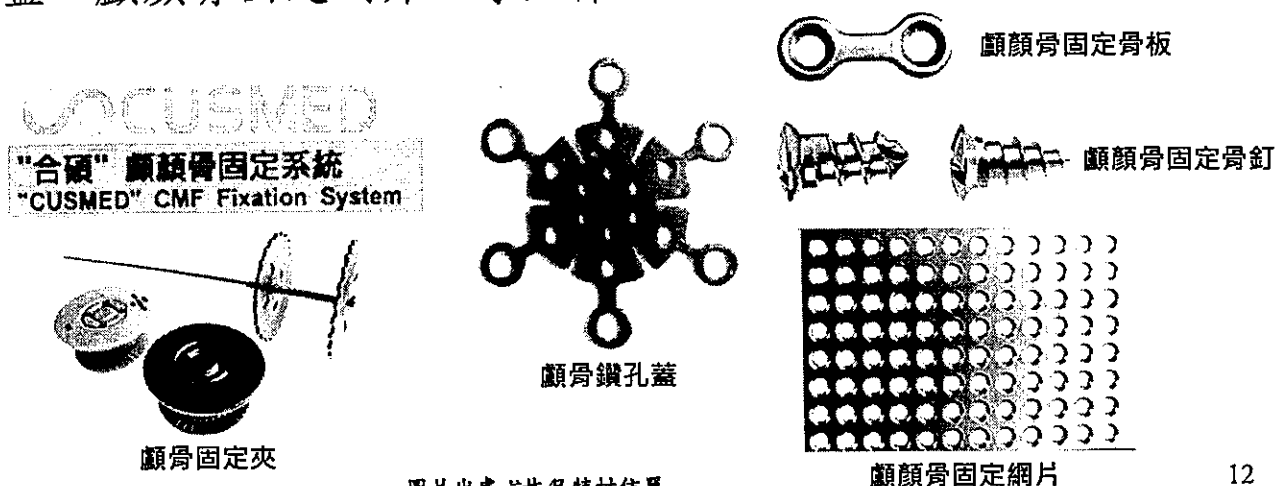

圖片出處 醫器品特材仿單

顱顏骨固定網片

12

國際價格

		新特材1	
國別	匯率 107.7-9	當地價格	“美敦力”鈦密斯顱骨固定系統 -顱骨網片*1+骨釘*12(電腦輔助型) 121mmx72mm-152mmx152mm
幣別		外幣	台幣
美國	30.86	--	--
日本	0.28	--	--
韓國	0.03	--	--
澳洲	23.51	10,185	235,986
中位數			235,986
國際最低價			235,986
健保支付點數			自付差額健保支付上限 26,239

註：本案品項2~9查無國際藥價。

討-4

13

自費比價網價格及公立醫院採購價彙整(1)

項次	中文名稱	規格(mm)		核價類別 「客製化電腦 輔助型顱骨 固定系統-骨網 片+骨釘」	各層級醫療院所收取自費價格 (扣除健保支付上限)				公立醫院採購價格 (扣除健保支付上限)			
					家數	中位數	平均價	最低價	家數	中位數	平均價	最低價
1	"美敦力"鈦密斯顱骨固定系統-顱骨網片*1+骨釘*12(電腦輔助型)(自付差額)	200*200*0.6 152*152*0.6 120*120*0.6 128*79*0.6 厚度0.6；1.0		骨網片： 大於等於 120*120 小於300*300	32	90,905	94,256	79,331	10	71,261	70,441	65,561
2	"亞太醫療"網眼骨板骨釘-網眼骨板*1+骨釘*10(電腦輔助型)(自付差額)	40*60 60*80 70*90 80*120 100*120	100*150 120*120 120*150 150*150 150*200		1	61,961	61,961	61,961	1	63,761	63,761	63,761
3	"拜普雷"預成形固定系統-顱骨網片*1+骨釘*16(自付差額)	200*200 厚度0.58			1	95,326	95,326	95,326	1	72,094	72,094	72,094
4	"拜普雷"預成形固定系統-顱骨網片*1+骨釘*12(自付差額)	127*131 厚度0.58			9	88,174	86,775	80,461	4	65,261	64,011	53,761

討-4

14

自費比價網價格及公立醫院採購價彙整(2)

項次	中文名稱	規格(mm)	核價類別 「客製化電腦輔助型顱顏骨固定系統-骨網片+骨釘」	各層級醫療院所收取自費價格(扣除健保支付上限)				公立醫院採購價格(扣除健保支付上限)			
				家數	中位數	平均價	最低價	家數	中位數	平均價	最低價
5	"拜普雷"預成形固定系統-顱骨網片*1+骨釘*8(自付差額)	90*92 厚度0.58	骨網片： 小於 120*120	9	59,561	66,565	58,761	2	50,761	50,761	39,761
6	"拜普雷"預成形固定系統-顱骨網片*1+骨釘*8(自付差額)	65*65 厚度0.58		1	55,250	55,250	55,250	1	23,761	23,761	23,761
7	"拜普雷"預成形固定系統-顱骨網片*1+骨釘*8(自付差額)	36*52 厚度0.58		2	26,895	26,895	26,895	-	-	-	-

討-4

15

自費比價網價格及公立醫院採購價彙整(3)

項次	中文名稱	規格(mm)	核價類別 「客製化電腦輔助型顱顏骨固定系統-骨網片+骨釘」	各層級醫療院所收取自費價格(扣除健保支付上限)				公立醫院採購價格(扣除健保支付上限)			
				家數	中位數	平均價	最低價	家數	中位數	平均價	最低價
8	"合碩"顱顏骨固定系統-骨網(預成形,等厚)*1+骨釘*12(自付差額)	D=300±299 H=60±59 厚度0.6; 1.0	骨網片： 大於等於 300*300	3	100,895	100,895	100,895	-	-	-	-
6	"合碩"顱顏骨固定系統-骨網(預成形,不等厚)*1+骨釘*12(自付差額)	D=300±299 H=60±59		7	169,139	166,239	153,695	-	-	-	-

註：醫事機構收取特材自費申報系統作業之規定，登錄自付差額項目之院所提供之收費標準，須扣除健保支付金額(資料彙整時間：107.04.16)。

討-4

16

建議支付點數

建議核價類別 【依骨網片規格分類】 客製化電腦輔助型顱顏骨 固定系統-骨網片+骨釘 (mm*mm)	健保支付 上限 (A)	建議支付點數			採計方式說明
		差額點數 (B)	全額給付 支付點數 ①C=(A+B)/ 0.8816 ②C=A+B		
小於 120*120	26,239	23,761	56,715	①	1.核價類別之差額點數，係以該類品項之自費價格或公立醫院採購價(扣除健保支付上限)最低價計算。 2.因以採購價最低價計，故全額給付支付點數，係以健保支付上限(26,239點)+差額點數(23,761點/53,761點)，再除以最近四季結算之醫院部門浮動點值平均(0.8816)計算。
大於等於 120*120 小於 300*300	26,239	53,761	90,744	①	1.核價類別之差額點數，係以該類品項之自費價格最低價計算。 2.因以自費價最低價計，故全額給付支付點數，係以健保支付上限(26,239點)+差額點數(100,895點)計算。
大於等於 300*300	26,239	100,895	127,134	②	1.核價類別之差額點數，係以該類品項之自費價格最低價計算。 2.因以自費價最低價計，故全額給付支付點數，係以健保支付上限(26,239點)+差額點數(100,895點)計算。

討-4

17

建議給付規定

- 限使用於頭部顱顏骨、顎顏骨固定，但不可與 Miniplate 併用，每次限用1片。
- 限自體頭骨不堪使用(如有感染疑慮者、自體頭骨植入後吸收者等)。
- 需事前審查，檢附頭顱X光、3D CT影像、敘明使用理由及使用特材規格。

討-4 討-3

18

財務預估

建議核價類別 【依骨網片規格分類】 客製化電腦輔助型顱 顱骨固定系統-骨網片 +骨釘 (mm*mm)	健保支付 上限 (A)	建議支付點數			推估年使用量		財務評估 [F=(C-A)*D+C*(E-D)]
		差額點數 (B)	全額給付 支付點數 ①C=(A+B)/0.8816 ②C=A+B		自付差額 (D)	全額給付 (E)	
小於 120*120	26,239	23,761	56,715	①	5	14	662,815
大於等於 120*120 小於 300*300	26,239	53,761	90,744	①	255	764	62,637,549
大於等於 300*300	26,239	100,895	127,134	②	8	21	2,459,902
總計					268	800	65,760,266

- 註：
- 1.建議支付點數係以最近4季(106年第1季至106年第4季)結算之醫院部門浮動點值平均(0.8816)計算。
 - 2.自付差額之推估年使用量，係以106年8~12月申報量推估106年全年使用量；全額給付之推估年使用量，係以107年8月專家諮詢會議預估年使用量800組計算，並以106年全年使用量作等比例換算各類使用量。

討-4

19

特材基本資料(1)

特材名稱	“美敦力”鈦密斯顱骨固定系統 -顱骨網片*1+骨釘*12(電腦輔助型)(自付差額) “Medtronic”TiMesh Cranial Fixation System-Cranial Mesh+Screw		
許可證字號	衛署醫器輸字第020434號	發證日期	98/11/25
廠商名稱	美敦力醫療產品股份有限公司		
製造廠名稱	Medtronic Neurosurgery	製造國別	美國
特材大類碼	人工機能代用類(F)	特材小類碼	整型外科類(P)
使用科別	神經外科。		
規格	200*200*0.6/152*152*0.6/120*120*0.6/128*79*0.6;厚度0.6/1.0。		
材質	醫療級鈦金屬或醫療級鈦合金		
適應症	本產品使用於口-頷-顱-顏外科重建手術，不論是顎骨矯正或創傷治療，利用剛性或半剛性的內部固定裝置，將骨骼碎片固定在一起。另一方面本產品也適用於骨科手術，用以強化脆弱的骨組織，例如骨盆重建、髌臼重建與骨水泥固定。本產品不適合使用於脊椎。		
健保支付點數	自付差額健保支付上限26,239點/組		

20

特材基本資料(2)

特材名稱	“亞太醫療”網眼骨板骨釘 -網眼骨板*1+骨釘*10(電腦輔助型)(自付差額) “Syntec” Mesh Plate and Screw-Mesh Plate+Screw*10		
許可證字號	衛署醫器製字第002392號	發證日期	97/01/21
廠商名稱	亞太醫療器材科技股份有限公司		
製造廠名稱	亞太醫療器材科技股份有限公司	製造國別	臺灣
特材大類碼	人工機能代用類(F)	特材小類碼	整型外科類(P)
使用科別	神經外科。		
規格	(Mesh Plate:421760:69;421780:89)+(Screw:420281:288)。		
材質	鈦合金		
適應症	1.眼框(Orbital)孔、側處骨折；2.竇壁(Sinus wall)骨折；3.顱骨(Cranium)骨折；4.顏面(Midfacial)骨折；5.下頷骨(Mandibular)骨折；6.其它用途輔助性使用。		
健保支付點數	自付差額健保支付上限26,239點/組		

討-4

21

特材基本資料(3)

特材名稱	“拜普雷”預成形固定系統 -顱骨網片*1+骨釘*16(自付差額) “Bioplate” Preformed Fixation System-mesh+Screw*16(200*200mm)		
許可證字號	衛部醫器輸字第028985號 衛部醫器輸字第027415號	發證日期	105/10/17 104/06/09
廠商名稱	普旌股份有限公司		
製造廠名稱	Bioplate, Inc.	製造國別	美國
特材大類碼	人工機能代用類(F)	特材小類碼	整型外科類(P)
使用科別	神經外科。		
規格	(Mesh:81-3142)+(Screw:81-2069;81-2070)		
材質	骨板：純鈦；微型骨釘：鈦合金		
適應症	本產品適用於需要以金屬內固定器來對齊及固定顱顏骨組織，包含但不限於顱骨重建及顱骨創傷骨折的修補。		
健保支付點數	自付差額健保支付上限26,239點/組		

討-4

22

特材基本資料(4)

特材名稱	“拜普雷”預成形固定系統 -顱骨網片*1+骨釘*12(自付差額) “Bioplate” Preformed Fixation System-mesh+Screw*12(127*131mm)		
許可證字號	衛部醫器輸字第028985號 衛部醫器輸字第027415號	發證日期	105/10/17 104/06/09
廠商名稱	普旌股份有限公司		
製造廠名稱	Bioplate, Inc.	製造國別	美國
特材大類碼	人工機能代用類(F)	特材小類碼	整型外科類(P)
使用科別	神經外科。		
規格	(Mesh:81-3142)+(Screw:81-2069;81-2070)		
材質	骨板：純鈦；微型骨釘：鈦合金		
適應症	本產品適用於需要以金屬內固定器來對齊及固定顱顏骨組織，包含但不限於顱骨重建及顱骨創傷骨折的修補。		
健保支付點數	自付差額健保支付上限26,239點/組		

討-4

23

特材基本資料(5)

特材名稱	“拜普雷”預成形固定系統 -顱骨網片*1+骨釘*8(自付差額) “Bioplate” Preformed Fixation System-mesh+Screw*8(90*92mm)		
許可證字號	衛部醫器輸字第028985號 衛部醫器輸字第027415號	發證日期	105/10/17 104/06/09
廠商名稱	普旌股份有限公司		
製造廠名稱	Bioplate, Inc.	製造國別	美國
特材大類碼	人工機能代用類(F)	特材小類碼	整型外科類(P)
使用科別	神經外科。		
規格	(Mesh:81-3142)+(Screw:81-2069;81-2070)		
材質	骨板：純鈦；微型骨釘：鈦合金		
適應症	本產品適用於需要以金屬內固定器來對齊及固定顱顏骨組織，包含但不限於顱骨重建及顱骨創傷骨折的修補。		
健保支付點數	自付差額健保支付上限26,239點/組		

討-4

24

特材基本資料(6)

特材名稱	“拜普雷”預成形固定系統 -顱骨網片*1+骨釘*8(自付差額) “Bioplate” Preformed Fixation System-mesh+Screw*8(65*65mm)		
許可證字號	衛部醫器輸字第028985號 衛部醫器輸字第027415號	發證日期	105/10/17 104/06/09
廠商名稱	普旌股份有限公司		
製造廠名稱	Bioplate, Inc.	製造國別	美國
特材大類碼	人工機能代用類(F)	特材小類碼	整型外科類(P)
使用科別	神經外科。		
規格	(Mesh:81-3142)+(Screw:81-2069;81-2070)		
材質	骨板：純鈦；微型骨釘：鈦合金		
適應症	本產品適用於需要以金屬內固定器來對齊及固定顱顏骨組織，包含但不限於顱骨重建及顱骨創傷骨折的修補。		
健保支付點數	自付差額健保支付上限26,239點/組		

討-4

25

特材基本資料(7)

特材名稱	“拜普雷”預成形固定系統 -顱骨網片*1+骨釘*8(自付差額) “Bioplate” Preformed Fixation System-mesh+Screw*8(36*52mm)		
許可證字號	衛部醫器輸字第028985號 衛部醫器輸字第027415號	發證日期	105/10/17 104/06/09
廠商名稱	普旌股份有限公司		
製造廠名稱	Bioplate, Inc.	製造國別	美國
特材大類碼	人工機能代用類(F)	特材小類碼	整型外科類(P)
使用科別	神經外科。		
規格	(Mesh:81-3142)+(Screw:81-2069;81-2070)		
材質	骨板：純鈦；微型骨釘：鈦合金		
適應症	本產品適用於需要以金屬內固定器來對齊及固定顱顏骨組織，包含但不限於顱骨重建及顱骨創傷骨折的修補。		
健保支付點數	自付差額健保支付上限26,239點/組		

討-4

26

特材基本資料(8)

特材名稱	“合碩”顱顏骨固定系統 -骨網(預成形,等厚)*1+骨釘*12(自付差額) “Cusmed”CMF Fixation System-(Contour CMF Mesh,Preformed)+Screw*12		
許可證字號	衛署醫器製字第004002號	發證日期	102/03/11
廠商名稱	合碩生技股份有限公司		
製造廠名稱	合碩生技股份有限公司	製造國別	臺灣
特材大類碼	人工機能代用類(F)	特材小類碼	整型外科類(P)
使用科別	神經外科。		
規格	(Mesh:9500.2101.06 : 2106.06 ; 9500.2201.10 : 2206.10 ; 9500.2101.06S : 2106.06S ; 9500.2201.10S : 2206.10S)+(Screw:FPS013025EXU;FPS013015LXU;FPS013125PXU)		
材質	顱骨固定夾：Ti6Al4V或TiCP2，顱顏骨固定骨釘：Ti6Al4V， 顱顏骨固定骨板、顱骨鑽孔蓋：TiCP2，顱顏骨固定網片：Ti6Al4V或TiCP2		
適應症	本產品用以固定顱顏面骨骨折，促進骨折癒合。		
健保支付點數	自付差額健保支付上限26,239點/組		

討-4

27

特材基本資料(9)

特材名稱	“合碩”顱顏骨固定系統 -骨網(預成形,不等厚)*1+骨釘*12(自付差額) “Cusmed”CMF Fixation System-(Contour CMF Mesh,Preformed,PSI)+Screw*12		
許可證字號	衛署醫器製字第004002號	發證日期	102/03/11
廠商名稱	合碩生技股份有限公司		
製造廠名稱	合碩生技股份有限公司	製造國別	臺灣
特材大類碼	人工機能代用類(F)	特材小類碼	整型外科類(P)
使用科別	神經外科。		
規格	(Mesh:9500.2101.06 : 2106.06 ; 9500.2201.10 : 2206.10 ; 9500.2101.06S : 2106.06S ; 9500.2201.10S : 2206.10S)+(Screw:FPS013025EXU;FPS013015LXU;FPS013125PXU)		
材質	顱骨固定夾：Ti6Al4V或TiCP2，顱顏骨固定骨釘：Ti6Al4V， 顱顏骨固定骨板、顱骨鑽孔蓋：TiCP2，顱顏骨固定網片：Ti6Al4V或TiCP2		
適應症	本產品用以固定顱顏面骨骨折，促進骨折癒合。		
健保支付點數	自付差額健保支付上限26,239點/組		

討-4

28

107 年 8 月份特殊材料專家諮詢會議紀錄
(時間：107 年 8 月 23 日(星期四)上午 9 時 30 分)

六、案由：「客製化電腦輔助型顱顏骨固定系統」自付差額品項納入全額給付案。

說明：

(一) 本案按 107 年 6 月本會議結論為以「Mesh 規格」分核價類別，以規格 120mm*120mm、300mm*300mm 為界線區分為 3 類規格，建議採公立醫院採購價之最低價，除以最近四季結算之醫院部門浮動點值平均計算，或以各層級醫療院所自費價格之最低價計算。考量 3D 列印恐誘發原以自體顱骨執行頭顱成形術之個案，改使用本案特材，建議請台灣神經外科醫學會提供建議給付規定及預估年使用量。

(二) 台灣神經外科學會於 107 年 7 月 27 日函復意見如下：

1. 建議給付規定：限自體骨感染使用。
2. 預估年使用量：500 組。
3. 其他建議：Mesh 規格範圍以 120mm*120mm 為給付上限；DRG 以 Add on 支付本案特材。

(三) 專家及學會考量若給付規定僅限自體骨感染使用，恐影響部分特殊狀況顱骨不堪使用病患之權益，另為避免有濫用之虞及本案為客製化產品，建議給付規定修正為自體頭骨不堪使用者，且須事前審查，並檢附頭顱 X 光、3D CT 影像，應敘明使用之理由及特材規格。另專家建議台灣神經外科學會建議之年使用量 500 組恐有低估。

結論：

(一) 建議維持 107 年 6 月本會議結論之功能分類及支付點數(修

正最近四季(106年第1季至106年第4季)結算之醫院部門
浮動點值平均值為0.8816)如下：

功能類別 【依 mesh 規格分 類】	品 項 數	健保支 付上限 (A)	建議支付點數	
			差額點數 (B)	全額給付支付點數
				①C=A+B ②C=(A+B)/0.8816
大於等於 300*300	2	26,239	100,895	127,134 ①
大於等於 <u>120*120</u> 小於 300*300	4	26,239	41,822	77,201 ②
小於 120*120	3	26,239	23,761	56,715 ②

(二) 建議給付規定：

1. 限使用於頭部顱顏骨、顎顏骨固定，但不可與 Miniplate 併用，每次限用 1 片。
2. 限自體頭骨不堪使用(如有感染疑慮者、自體頭骨植入後吸收者等)。
3. 需事前審查，檢附頭顱 X 光、3D CT 影像、敘明使用理由及使用特材規格。

(三) 預估年使用量：經專家與學會討論後取得共識，建議修正為 800 組。

107 年 6 月份特殊材料專家諮詢會議紀錄
(時間：107 年 6 月 14 日(星期四)上午 9 時 30 分)

六、案由：「客製化電腦輔助型顱顏骨固定系統」自付差額品項納入全額給付案。

說明：

- (一) 本案係依「107 年度醫院醫療費用總額及其分配方式，其中新醫療科技項目預算編列 24 百萬元，用於『客製化電腦輔助型顱顏骨固定系統』自付差額品項納入全額給付」之政策辦理。
- (二) 本案特材適用於頷、顱顏面外科重建手術，可替代傳統使用自體骨重建或健保給付之骨水泥、骨網等方式，106 年 8-12 月使用量計 111 組，近似功能特材 106 年全年使用量計 32 組。
- (三) 考量本案特材品項間價格差異大，建議以「Mesh 規格」分功能類別，以面積 120mm*120mm、300mm*300mm 為界線區分為 3 類規格，另考量臨床不等厚的規格使用較少，不建議另列。
- (四) 因本案特材原為自付差額品項，屬功能改善類別特材，爰建議採公立醫院採購價之最低價，除以最近四季(105 年第 4 季至 106 年第 3 季)結算之醫院部門浮動點值平均(0.8808)計算，或以各層級醫療院所自費價格之最低價計算。
- (五) 考量目前 3D 列印上路，恐誘發原以自體顱骨執行頭顱成形術之個案，改使用本案特材，使用量恐非原預估之 500 組(推估健保增加支出約 3 千多萬)，建議台灣神經外科醫學會研議訂定嚴謹且明確之給付規定。

結論：

(一) 建議功能類別：功能改善特材。

(二) 建議給付規定、預估年使用量：請台灣神經外科醫學會提供。

(三) 建議功能類別及支付點數：

功能類別 【依 mesh 規格分類】	品 項 數	健保支 付上限 (A)	建議支付點數	
			差額點數 (B)	全額給付支付點數 ①C=A+B ②C=(A+B)/0.8808
大於等於 300*300	2	26,239	100,895	127,134 ①
大於等於 <u>120*120</u> 小於 300*300	4	26,239	41,822	77,272 ②
小於 120*120	3	26,239	23,761	56,767 ②

(四) 財務評估：俟學會提供預估年使用量再評估。

討論案 5

有關元銘企業有限公司及嘉杏股份有限公司，再次提
會將適用於心臟停止之低溫療法特材納入健保給付
案。

討論案第 5 案

案由:有關元銘企業有限公司及嘉杏股份有限公司,再次提會將適用於心臟停止之低溫療法特材納入健保給付案。

說明:

一、本案依本會議特材部分第 31 次(107 年 3 月)會議紀錄辦理。結論略以:體外包覆式:「"沙貝雷歐" 布蘭克體溫調節機及其附件」、「"沙貝雷歐"庫歐全身包覆式溫控傳遞墊組」及「"美翠" 體溫調節系統」,有重複使用之慮,暫不同意納入健保支付(詳附件 1)。並於 107 年 4 月 30 日以健保審字第 1070054423A 號函通知廠商(詳附件 2)。

二、廠商來函申覆且附有相關證明資料如下:

(一) 元銘企業有限公司 107 年字 1070509 號函附許可證仿單,於警告及注意事項中,為單一病人使用之配件,請勿重複使用或消毒。

(二) 嘉杏股份有限公司 107 年 5 月 18 日嘉杏字第 B80518-01 號函,附許可證仿單之產品包裝標籤,皆有標示限單次使用,不得重複使用之符號。另附有 TFDA 第 388 期藥品食品安全週報,中公告國際通用標誌符號,也有標示限單次使用之符號與該公司相同。

三、本署於 107 年 6 月 27 日為釐清旨揭特材適用範圍之疑慮,函請食品藥物管理署協助認定;經回復該等特材皆屬單一病患使用,不得重複使用。(詳附件 3)

四、本案特材,依 107 年 3 月份本會議資料,再提會報告。

(一) 比照同功能特材「體外貼片式」、「體內導管組」(107 年 6 月 1 日納入健保給付),另列核價類別為「體外包覆式」納入給付。

(二) 支付點數:依據 107 年 3 月共同擬訂會議資料:「體外包覆式溫控傳遞墊」,以每組 25,000 點暫予支付。(詳附件 4)

(三) 給付規定:同 107 年 6 月 1 日公告納入給付之「體外貼片式」及「體內導管組」給付規定如下:

1、按本保險醫療服務給付項目「心跳停止之低溫療法」(編碼 47094B~47096B)及「週產期新生兒低溫療法」(編碼 47097B~47100B)所列給付規定辦理。

2、每一病患住院擇一項特材品項,使用量以一組為限。

(四) 財務預估:因每一病患住院擇一項同功能特材品項使用,且本案特材支付點數低於原 107 年 6 月 1 日公告品項;故不影響健保財務支出。相關簡報檔如附件 4。

擬辦:本案經討論後如獲同意,擬另列功能核價類別「體外包覆式」納入健保給付。

**全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第31次（107年3月）會議紀錄**

第3案：有關「元銘企業有限公司」、「鐸甦企業有限公司」、「巴德股份有限公司」及「嘉杏股份有限公司」建議將用於心臟停止之低溫療法之特材「“沙貝雷歐”布蘭克體溫調節機及其附件」納入健保支付案。

說明：詳附錄會議資料討論案第3案之報告內容。

決定：

（一） 本案特材屬創新功能特材，適用於心臟停止之低溫療法，搭配體溫調節系統，以監測和控制患者中樞體溫，相較於傳統的冰毯，可精準且快速地達到降溫效果，以提高存活率及降低腦部缺氧，並可設定回溫之溫度及時間，以維持穩定的低溫狀態達到治療效果，分3類功能類別特材，說明如下：

1. 體外貼片式：「"美德凡司"北極日溫控傳遞墊-傳遞墊（成人及嬰孩童）」計2項，同意納入健保支付。
2. 植入式體內導管組：「“卓邇”溫度調節系統及其附件」（啟動組及愛導管組）計2項，同意納入健保支付。
3. 體外包覆式：「"沙貝雷歐"布蘭克體溫調節機及其附件」、「"沙貝雷歐"庫歐全身包覆式溫控傳遞墊組」及「"美翠"體溫調節系統」計9項，考量特材使用之緊密度、醫材仿單無法證明單次拋棄式特材，有重複使用之慮，暫不同意納入健保支付。

（二） 支付點數：

1. 體外貼片式：「"美德凡司"北極日溫控傳遞墊-傳遞墊（成人及嬰孩童）」計2項，因查無國際價格，各層級醫療院所收取自費價格及公立醫院採購價均高於廠商建議價，故採廠商建議價格成人50,000點、嬰孩童30,000點暫予支付。
2. 植入式體內導管組：「“卓邇”溫度調節系統及其附件-（啟動組及愛導管組）」計2項，採公立醫院採購決標價格之中位數，除

以收載時最近四季(105 年第 3 季至 106 年第 2 季)結算之醫院總額部門浮動點值之平均值(0.8818)，啟動組及愛導管組分別以每組 24,948 點及 39,464 點暫予支付。【 $(22,000/0.8818=24,948)$ ； $(34,800/0.8818=39,464)$ 】。

(三) 給付規定：

1. 按本保險醫療服務給付項目「心跳停止之低溫療法」(編碼 47094B~47096B)及「週
2. 產期新生兒低溫療法」(編碼 47097B~47100B)所列給付規定辦理。
3. 每一病患住院擇一項特材品項，使用量以一組為限。

衛生福利部中央健康保險署 函

機關地址：臺北市信義路3段140號
傳真：(02)27026324
承辦人及電話：
電子信箱：

受文者：

發文日期：中華民國107年4月30日
發文字號：健保審字第1070054423A號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無

主旨：有關貴公司建議納入健保支付之「心跳停止後之低溫療法」特材一案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第31次（107年3月）會議紀錄辦理。
- 二、本次會議討論案第3案決定(一)3. 體外包覆式：「"沙貝雷歐" 布蘭克體溫調節機及其附件」、「"沙貝雷歐"庫歐全身包覆式溫控傳遞墊組」及「"美翠" 體溫調節系統」計9項，考量特材使用之緊密度、醫材仿單無法證明單次拋棄式特材，有重複使用之慮，暫不同意納入健保支付。本署將107年6月1日起，於本署全球資訊網尚未納入健保給付之過程面醫材品項表中刪除，待有新事證請貴公司再重新來函建議。

正本：元銘企業有限公司、嘉杏股份有限公司
副本：

衛生福利部單位請辦單

速別：普通件

收文單位：

■食品藥物管理署

請辦事由：

有關元銘企業有限公司建議將「"沙貝雷歐"布蘭克體溫調節機及其附件（衛部醫器輸字第025660號）」、「"沙貝雷歐"庫歐全身包覆式溫控傳遞墊組（衛部醫器輸字第027752號）」及嘉杏股份有限公司建議將「"美翠"體溫調節系統（衛部醫器輸字第027026號）」醫材適用範圍一案，說明如下，請惠示卓見。

- 一、全民健康保險收載醫療器材納入健保特材給付或內含於醫療診療項目中，以醫療器材許可證仿單述明單次拋棄式使用之醫材為判斷原則之一，合先敘明。
- 二、依旨揭2家廠商提供之仿單資料說明：(一)元銘企業有限公司附許可證仿單，為單一病人使用之配件，請勿重複使用或消毒（詳如附件1）。(二)嘉杏股份有限公司附許可證仿單之產品未述明單一病人使用（詳如附件2），惟其所附之標籤仿單黏貼表標有②之標示。
- 三、爰請貴署協助提供旨揭特材是否為單一病患使用且不可重複使用。敬請惠示卓見，並於107年7月13日前回復。

※請惠予107年07月13日前回復資料。

發文日期：中華民國107年6月27日
 發文字號：健保審字第1070035545號
 發文單位：衛生福利部中央健康保險署
 承辦人：
 電話：(02)27065866轉

檔 號：TE0499

保存年限：3年

併案文號：

衛生福利部單位請辦單

- | | | |
|---|-------------------------------------|---|
| ☐ 部長室 | ☐ 主任秘書室 | ☐ 綜合規劃司 |
| ☐ 社會保險司 | ☐ 社會救助及社工司 | ☐ 保護服務司 |
| ☐ 護理及健康照護司 | ☐ 醫事司 | ☐ 心理及口腔健康司 |
| ☐ 中醫藥司 | ☐ 秘書處 | ☐ 人事處 |
| ☐ 政風處 | ☐ 會計處 | ☐ 統計處 |
| ☐ 資訊處 | ☐ 法規會 | ☐ 國際合作組 |
| ☐ 附屬醫療及社會福利機構管理會 | ☐ 全民健康保險會 | ☐ 全民健康保險爭議審議會 |
| ☐ 健康服務品質政策發展辦公室 | ☐ 衛生福利人員訓練中心 | ☐ 國民年金監理會 |
| ☐ 科技發展組 | ☐ 公共關係室 | ☐ 國會聯絡組 |
| ☐ 疾病管制署 | ☐ 國民健康署 | ☒ 中央健康保險署 |
| ☐ 食品藥物管理署 | ☐ 社會及家庭署 | ☐ 國家中醫藥研究所 |
| ☐ 國家衛生研究院 | | |

請辦事由：


有關貴署請辦衛部醫器輸字第025660號'''沙貝雷歐'布蘭克體溫調節機及其附件等3件許可證案內產品是否屬單次拋棄使用醫材，復說明如附件，請查照。

發文單位：食品藥物管理署

發文日期：

承辦人：

電話：0227877551

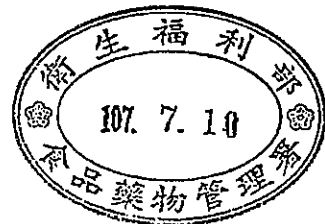

擬辦：

批示：

校對	用印	發文	歸檔頁數	

第一頁（共一頁）

附件

有關貴署請辦衛部醫器輸字第 025660 號"沙貝雷歐"布蘭克體溫調節機及其附件等 3 件許可證案內產品是否屬單次拋棄使用醫材，復說明如下：

- 一、醫療器材是否屬單次使用產品，應依其核定之中文仿單核定本及產品包裝標籤加以判斷，先予敘明。
- 二、衛部醫器輸字第 027752 號"沙貝雷歐"庫歐全身包覆式溫控傳遞墊組，案內型號 900 等 5 個型號，依仿單說明皆屬限單一病患使用，不得重複使用。
- 三、衛部醫器輸字第 025660 號"沙貝雷歐"布蘭克體溫調節機及其附件，依仿單說明，2 型號主機非屬單次使用當無疑義，其配件中 PlastiPad 溫毯墊(Polyurethane)及 Gelli-Roll 重覆使用溫毯為可重覆使用，Maxi-Therm 單一病人使用溫毯墊、Maxi-Therm Lite 單人使用溫毯墊及 KOOL KIT 單一病人使用溫毯墊組皆屬單一病患使用，不得重複使用。
- 四、衛部醫器輸字第 027026 號"美翠"體溫調節系統，2 型號產品主機非屬單次使用當無疑義，而其案內之各項配件包覆墊(衣)，依其產品包裝標籤皆標示有禁止 2 次使用之符號，故應屬單次使用，不得重複使用。另仿單中有註明 Thermo Wrap 熱包覆墊(衣)可使用 28 小時，Cure Warp 治療包覆墊(衣)可使用 72 小時，應遵循仿單指示進行操作。
- 五、以上資訊供貴署參酌。

用於心臟停止之低溫療法特材

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第31次(107年3月)會議
107年03月15日

提案摘要

案由：有關「元銘企業有限公司」等4家廠商建議將用於心臟停止之低溫療法之特材「”沙貝雷歐”布蘭克體溫調節機及其附件」等共計16項納入健保支付。

說明：

- 本案特材適用於心臟停止之低溫療法，搭配體溫調節系統，以監測和控制患者中樞體溫。
- 相較於傳統的冰毯更可精準快速達到降溫效果，且可設定回溫溫度及時間。


建議：屬創新功能特材，建議納入健保支付。

治療方式簡介

□心臟停止之低溫療法

臨床「心跳停止」時，心臟無法輸出血液，造成身體各器官組織及腦部組織嚴重缺氧以致腦細胞壞死，造成日後嚴重失能；對於急救後的病患採「低溫治療(將病患中樞體溫降低至32-34℃，持續12-24小時)，能改善心跳停止且具可電擊復律心律(shockable rhythm)病患的存活率和神經學預後。

降溫的方法分為體外降溫法和體內降溫法。

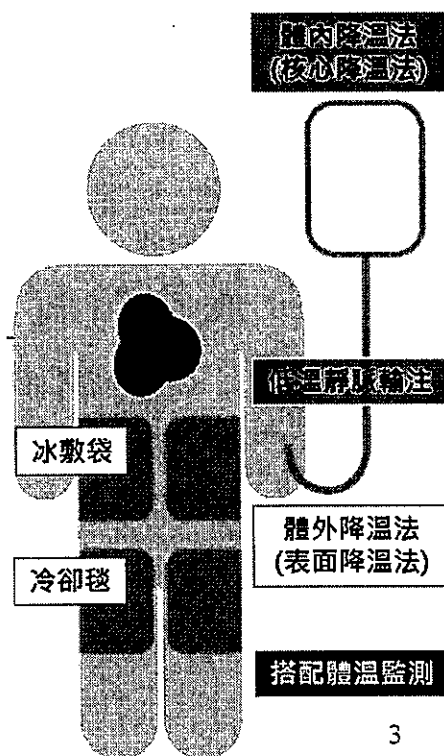

3

本案特材品項表

項次	中英文品名	分類	說明	用途	廠商建議價	備註
1	"沙貝雷歐"布蘭克體溫調節機及其附件-溫毯墊組(900 Kool Kit組)	體外包覆式	溫毯墊	成人	55,000	
2	"沙貝雷歐"布蘭克體溫調節機及其附件-溫毯墊組(910頭套組920背心組)	體外包覆式	溫毯墊	成人	40,000	
3	"沙貝雷歐"布蘭克體溫調節機及其附件-溫毯墊組(950 Kool Kit嬰兒組)	體外包覆式	溫毯墊	嬰孩童	25,000	
4	"沙貝雷歐"庫歐全身包覆式溫控傳遞墊組 "Cincinnati Sub-Zero" Kool-Kit Pads (900;930)	體外包覆式	全身傳遞墊	成人	55,000	
5	"沙貝雷歐"庫歐全身包覆式溫控傳遞墊組 "Cincinnati Sub-Zero" Kool-Kit Pads (910;920)	體外包覆式	全身傳遞墊	成人	40,000	
6	"沙貝雷歐"庫歐全身包覆式溫控傳遞墊組 "Cincinnati Sub-Zero" Kool-Kit Pads (950)	體外包覆式	全身傳遞墊	嬰孩童	25,000	
7	"美翠"體溫調節系統-治療包覆墊	體外包覆式	治療包覆墊	成人	40,000	
8	"美翠"體溫調節系統-小孩熱包覆墊	體外包覆式	治療包覆墊	嬰孩童	40,000	
9	"美翠"體溫調節系統-嬰兒熱包覆墊	體外包覆式	治療包覆墊	嬰孩童	40,000	
10	"美德凡司"北極日溫控傳遞墊-傳遞墊(超超小型、超小型、小型、中型、大型)	體外貼片式	傳遞墊	成人	50,000	1070601已納入健保
11	"美德凡司"北極日溫控傳遞墊-傳遞墊(通用型、通用型小、新生兒型)	體外貼片式	傳遞墊	嬰孩童	30,000	1070601已納入健保
13	"卓適"溫度調節系統及其附件-愛導管組	體內導管組	愛導管	成人	45,000	1070601已納入健保
16	"卓適"溫度調節系統及其附件-啟動組件	體內導管組	啟動組	成人	30,000	1070601已納入健保

備註: 1. 體外包覆式(溫毯墊、溫控傳遞墊、包覆墊)

2. 體外貼片式(溫控傳遞墊)

3. 體內導管組(啟動組件、愛導管)。

另酷、快及速導管組等3項，因不符合心臟停止之低溫療法給付規定及變更許可證等原因，106年11月23日來函建議刪除品項。

4


本案特材簡介(1)(項次1~6)

□“沙貝雷歐”布蘭克體溫調節機及其附件、庫歐全身包覆式溫控傳遞墊組(體外包覆式)

📖 本品特材利用傳遞墊穿戴於病人身上以包覆其全身，搭配體溫調節系統控制溫度，覆蓋面積大於65%以上，可快速有效調節病患體溫。

CSZ
A GENTHERM COMPANY

圖片出處：<https://www.cszmedical.com>


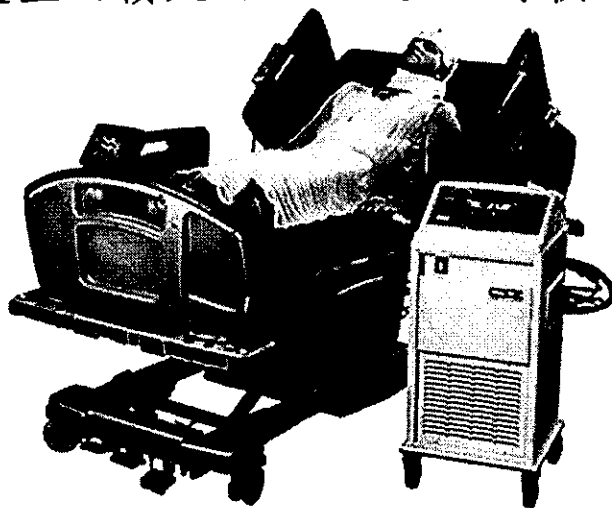


5

本案特材簡介(2)(項次7~9)

□“美翠”體溫調節系統-包覆墊(體外包覆式)

📖 本品特材需搭配CritiCool體溫調節系統使用，經由水的循環，機器能夠監測病人核心溫度並利用水溫來調節達到預想的溫度。

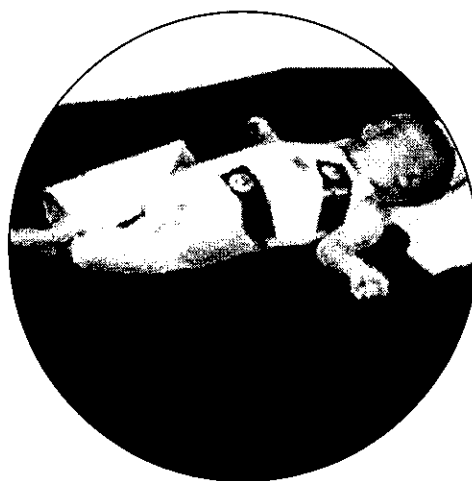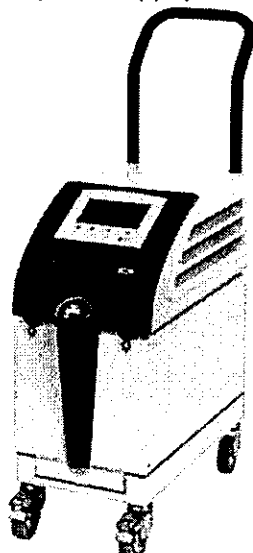

圖片出處：newmedical.com.au

6

廠商建議資料(1)

項次	品項	廠商建議價格	廠商預估	第一年	第二年	第三年
1	“沙貝雷歐”布蘭克體溫調節機及其附件-溫毯墊組(900)	55,000元	數量	300組	300組	300組
			特材費用	1,650萬元	1,650萬元	1,650萬元
2	“沙貝雷歐”布蘭克體溫調節機及其附件-溫毯墊組(910;920)	40,000元	數量	300組	300組	300組
			特材費用	1,200萬元	1,200萬元	1,200萬元
3	“沙貝雷歐”布蘭克體溫調節機及其附件-溫毯墊組(950)	25,000元	數量	80組	80組	80組
			特材費用	200萬元	200萬元	200萬元

7

廠商建議資料(2)

項次	品項	廠商建議價格	廠商預估	第一年	第二年	第三年
4	“沙貝雷歐”庫歐全身包覆式溫控傳遞墊組(900;930)	55,000元	數量	300組	300組	300組
			特材費用	1,650萬元	1,650萬元	1,650萬元
5	“沙貝雷歐”庫歐全身包覆式溫控傳遞墊組(910;920)	40,000元	數量	300組	300組	300組
			特材費用	1,200萬元	1,200萬元	1,200萬元
6	“沙貝雷歐”庫歐全身包覆式溫控傳遞墊組(950)	25,000元	數量	80組	80組	80組
			特材費用	200萬元	200萬元	200萬元

8

廠商建議資料(3)

項次	品項	廠商建議價格	廠商預估	第一年	第二年	第三年
7	“美翠”體溫調節系統-治療包覆墊	40,000元	大人數量	540組	567組	594組
			特材費用	2,160萬元	2,268萬元	2,376萬元
8	“美翠”體溫調節系統-小孩熱包覆墊		新生兒數量	100組	105組	110組
			特材費用	400萬元	420萬元	440萬元
9	“美翠”體溫調節系統-嬰兒熱包覆墊		總特材費用	2,560萬元	2,688萬元	2,816萬元

9

相關診療項目

診療項目代碼	中文項目名稱	支付點數
47094B	心跳停止之低溫療法－第一天(≤24小時)	9,068
47095B	心跳停止之低溫療法－第二天(>24小時~≤48小時)	1,500
47096B	心跳停止之低溫療法－第三天(>48小時)	1,500
47097B	週產期新生兒低溫療法－第一天(≤24小時)	10,000
47098B	週產期新生兒低溫療法－(>24小時~≤48小時)	3,994
47099B	週產期新生兒低溫療法－(>48小時~≤72小時)	3,000
47100B	週產期新生兒低溫療法－第四天(>72小時)	3,000

105-106年低溫療法使用人數				
年度	心跳停止之低溫療法	成長率	週產期新生兒低溫療法	成長率
105年	216		77	
106年	355	64%	93	20%
推估107年	582		111	

註：
 1.資料來源：本署倉儲門住診樓(擷取日期：107.02.21)。
 2.資料範圍：心跳停止之低溫療法(醫令代碼47094B、47095B、47096B)；週產期新生兒低溫療法(醫令代碼47097B、47098B、47099B、47100B)。
 3.人數係以ID+生日歸戶計算。

10

診療項目給付規定

● 心跳停止之低溫療法(47094B~47096B)

1. 適應症：心跳停止患者，進行復甦急救後意識仍不清者(GCS<8)或無遵循口頭醫囑 (motor<6)。
2. 排除條件：(1)恢復自發性循環大於12小時。(2)腦出血。(3)收縮血壓<90mmHg。(4)大量活動性出血。(5)無法終止的致命性心律不整。(6)在心跳停止前即有失智或長期意識障礙。(7)末期疾病。
3. 支付規範：(1)總治療療程為3天。(2)不得同時申報項目：47037B「冰毯-12小時以內」、47038B「冰毯-12-24小時以內」、47049B「自動體溫控制床使用費」。(3)特殊材料費另計。

● 週產期新生兒低溫療法(47097B~47100B)

1. 適應症，須符合下列三項：(1)出生週數≥36週。(2)事件發生後6小時內實施。(3)出生後有「中等嚴重度」至「重度」腦病變之證據，且有下列任一項之情形：I.出生後一小時內嚴重酸血症(severe acidosis)，血液PH值≤7或base deficit≥16mmol/L(採血來源：動脈血或靜脈血均可)。II.出生10分鐘時的Apgar分數≤5分。III.出生後持續急救至少10分鐘。
2. 支付規範：(1)總治療療程為4天。(2)不得同時申報47037B「冰毯-12小時以內」、47038B「冰毯-12-24小時以內」、47049B「自動體溫控制床使用費」。(3)特殊材料費另計。

11

本案建議納入健保支付(1)

□ 依據特殊材料106年7、9、11月份專家諮詢會議結論辦理。

□ 理由說明：

📖 本案特材為配合健保自104年12月1日起給付心跳停止之低溫療法及週產期新生兒低溫療法(編號：47094B-47100B，支付點數：1,500~10,000點)所使用之特材。適用於心臟停止之低溫療法，搭配體溫調節系統，以監測和控制患者中樞體溫，相較於傳統的冰毯，可精準且快速地達到降溫效果，以提高存活率及降低腦部缺氧，並可設定回溫之溫度及時間，以維持穩定的低溫狀態達到治療效果。

📖 建議功能類別分為：1. 體外包覆式(溫毯墊、溫控傳遞墊、治療包覆墊)。2. 體外貼片式(溫控傳遞墊)；分成人及嬰孩童。3. 體內溫控導管等3項。

12

本案建議納入健保支付(2)

📖 給付規定：依本保險醫療服務給付項目：「心跳停止之低溫療法」(編碼47094B~ 47096B)及「週產期新生兒低溫療法」(編碼47097B~47100B)所列之適應症。

📖 屬創新功能特材。

13

國際價格

		新特材13		新特材16	
國別	匯率 106.07-09	當地價格	“卓邇”體度調節系統及其附件-愛導管組	當地價格	“卓邇”體度調節系統及其附件-啟動組件
幣別		外幣	台幣	外幣	台幣
美國	31.22	682	21,292	275	8,586
日本	0.29	89,100	25,839	--	--
韓國	0.03	--	--	--	--
澳洲	23.91	--	--	--	--
中位數			23,566		8,586
國際最低價			21,292		8,586
廠商建議價			45,000		30,000

註：新特材1~11查無國際價格。

14

公立醫院採購價及自費比價網價格彙整

項次	品項	公立醫院採購價				自費醫材比價網			
		家數	中位數	平均數	最低價	家數	中位數	平均數	最低價
1-6	“沙貝雷歐”布蘭克體溫調節機及其附件	--	查無資料			1	40,000	40,000	40,000
7-9	“美翠”體溫調節系統	--	查無資料			2	24,100	24,100	20,700
10	“美德凡司”北極日溫控傳遞墊	4	59,841	60,633	59,841	14	64,000	63,692	56,000
11	“美翠”體溫調節系統	--	查無資料			6	36,600	40,575	26,400
13	“卓邇”體度調節系統及其附件	4	34,800	34,800	34,800	19	52,500	51,187	43,500
16	“卓邇”體度調節系統及其附件	4	22,000	22,000	22,000	19	29,700	28,773	23,940

15

建議支付點數

● 採計方式如下：

項次	產品名稱	分類	採計方式	暫核點數
1-3	“沙貝雷歐”布蘭克體溫調節機及其附件	體外包覆式溫控傳遞墊-成人用及嬰孩童用	因查無國際價格，自費醫材比價網之筆數少於5筆，故建議依廠商建議支付點數之最低價。	25,000點
4-6	“沙貝雷歐”庫歐全身包覆式溫控傳遞墊組			
7-9	“美翠”體溫調節系統			
10	“美德凡司”北極日溫控傳遞墊-傳遞墊(超超小型、超小型、小型、中型、大型)	體外貼片式溫控傳遞墊-成人用	以體重30公斤區分為成人用或兒童用；因查無國際價格，自費醫材比價網及公立醫院採購決標價格均高於廠商建議價，故建議採廠商建議支付點數	50,000點
11	“美德凡司”北極日溫控傳遞墊-傳遞墊(通用型、通用型小、新生兒型)	體外貼片式溫控傳遞墊-兒童用		30,000點
13	“卓邇”溫度調節系統及其附件-愛導管組	體內溫控導管	愛導管組需搭配啟動組件使用，建議此2項均採公立醫院採購決標價格之中位數，除以收載(提案至藥物擬訂會議)時最近四季結算之醫院總額部門浮動點值之平均值暫予支付。	34,800點
16	“卓邇”溫度調節系統及其附件-啟動組件			22,000點

16

財務預估

項次	產品名稱	分類	暫核點數	項目	佔率(註2)	第一年	第二年	第三年
1~3	"沙貝雷歐"布蘭克體溫調節機及其附件	體外包覆式溫控傳遞墊-成人用	25,000點	使用量(註1)	3.91%	582	640	704
4~6	"沙貝雷歐"庫歐全身包覆式溫控傳遞墊組	體外包覆式溫控傳遞墊-成人用	25,000點	預估點數		56	62	68
7~9	"美翠"體溫調節系統	體外包覆式溫控傳遞墊-嬰孩童用		使用量	0.78%	111	122	134
				預估點數		2.1	2.3	2.6
10	"美德凡司"北極日溫控傳遞墊-傳遞墊(超超小型、超小型、小型、中型、大型)	體外貼片式溫控傳遞墊-成人用	50,000點	使用量	75.78%	582	640	704
				預估點數		2,205	2,424	2,667
11	"美德凡司"北極日溫控傳遞墊-傳遞墊(通用型、通用型小、新生兒型)	體外貼片式溫控傳遞墊-嬰孩童用	30,000點	使用量	2.34%	111	122	134
				預估點數		7.8	8.5	9.4
13	"卓通"溫度調節系統及其附件-愛導管組	體內溫控導管	39,464點	使用量	17.19%	582	640	704
16	"卓通"溫度調節系統及其附件-啟動組件	體內溫控導管	24,948點	預估點數(註3)		644	708	778

註：

(萬點)

1. 使用量：以本案特材之106年相關診療項目47094B-47096B申報量355(成長率64%)及47097B-47100B申報量93(成長率20%)，推估第一年使用量成人為582件及新生兒111件，第二年級第三年以10%成長率推估。
2. 佔率：依105年及106年度自費醫材比價網之渠等申報數量共128件，計算各項特材使用佔率。
3. 卓通"溫度調節系統及其附件-愛導管組須搭配啟動組使用，故價格併同計算。
4. 預估點數：以暫核點數X使用量X佔率，合計第一年約2,914萬點，第二年約3,318萬點，到第三年約3,525萬點。

17

特材基本資料(1)

特材名稱	"沙貝雷歐"布蘭克體溫調節機及其附件-傳遞墊900 "Cincinnati Sub-zero" Blanketrol Hypo/Hyperthermia System With Accessories-PADS 900		
許可證字號	衛部醫器輸字第025660號	發證日期	102/12/11
廠商名稱	元銘企業有限公司		
製造廠名稱	Cincinnati Sub-Zero Products	製造國別	美國
醫器主類別	E心臟血管用裝置	醫器次類別	E5900熱調節系統
使用科別	內科加護病房，外科加護病房，急診，兒科加護病房。		
規格	型號900 Kool-Kit 全身包覆型。		
材質	Nonwoven Poly Fabric，Velcro(不織布，維可牢)。		
適應症	適用於心跳停止之低溫療法。		
廠商建議價	55,000元/組		

特材基本資料(2)

特材名稱	“沙貝雷歐”布蘭克體溫調節機及其附件-傳遞墊910,920 “Cincinnati Sub-zero” Blanketrol Hypo/Hyperthermia System With Accessories-PADS 910,920		
許可證字號	衛部醫器輸字第025660號	發證日期	102/12/11
廠商名稱	元銘企業有限公司		
製造廠名稱	Cincinnati Sub-Zero Products	製造國別	美國
醫器主類別	E心臟血管用裝置	醫器次類別	E5900熱調節系統
使用科別	內科加護病房，外科加護病房，急診，兒科加護病房。		
規格	型號910 Kool-Kit Head Wrap 頭頸包覆型， 型號920 Kool-Kit Patient Vest 胸背包覆型。		
材質	Nonwoven Poly Fabric，Velcro (不織布，維可牢)。		
適應症	適用於心跳停止之低溫療法。		
廠商建議價	40,000元/組		

19

特材基本資料(3)

特材名稱	“沙貝雷歐”布蘭克體溫調節機及其附件-傳遞墊950 “Cincinnati Sub-zero” Blanketrol Hypo/Hyperthermia System With Accessories-PADS 950		
許可證字號	衛部醫器輸字第025660號	發證日期	102/12/11
廠商名稱	元銘企業有限公司		
製造廠名稱	Cincinnati Sub-Zero Products	製造國別	美國
醫器主類別	E心臟血管用裝置	醫器次類別	E5900熱調節系統
使用科別	急診，新生兒科加護病房，兒科加護病房。		
規格	型號950 Kool-Kit Neonat 嬰兒組。		
材質	Nonwoven Poly Fabric (不織布)。		
適應症	適用於週產期新生兒低溫療法。		
廠商建議價	25,000元/組		

20

特材基本資料(4)

特材名稱	“沙貝雷歐”庫歐全身包覆式溫控傳遞墊組900,930 “Cincinnati Sub-zero” Kool-Kit Pads 900,930		
許可證字號	衛部醫器輸字第027752號	發證日期	104/10/08
廠商名稱	元銘企業有限公司		
製造廠名稱	Cincinnati Sub-Zero Products	製造國別	美國
醫器主類別	E心臟血管用裝置	醫器次類別	E5900熱調節系統
使用科別	內科加護病房，外科加護病房，急診，兒科加護病房。		
規格	型號900 Kool-Kit 全身包覆型， 型號930 Bariatric Kool-Kit 超大全身包覆型，。		
材質	Nonwoven Poly Fabric，Velcro (不織布，維可牢)。		
適應症	適用於心跳停止之低溫療法。		
廠商建議價	55,000元/組		

21

特材基本資料(5)

特材名稱	“沙貝雷歐”庫歐全身包覆式溫控傳遞墊組910,920 “Cincinnati Sub-zero” Kool-Kit Pads 910,920		
許可證字號	衛部醫器輸字第027752號	發證日期	104/10/08
廠商名稱	元銘企業有限公司		
製造廠名稱	Cincinnati Sub-Zero Products	製造國別	美國
醫器主類別	E心臟血管用裝置	醫器次類別	E5900熱調節系統
使用科別	內科加護病房，外科加護病房，急診，兒科加護病房。		
規格	型號910 Kool-Kit Head Wrap頭頸包覆型， 型號920 Kool-Kit Patient Vest胸背包覆型，。		
材質	Nonwoven Poly Fabric，Velcro (不織布，維可牢)。		
適應症	適用於心跳停止之低溫療法。		
廠商建議價	40,000元/組		

22

特材基本資料(6)

特材名稱	“沙貝雷歐”庫歐全身包覆式溫控傳遞墊組950 “Cincinnati Sub-zero” Kool-Kit Pads 950		
許可證字號	衛部醫器輸字第027752號	發證日期	104/10/08
廠商名稱	元銘企業有限公司		
製造廠名稱	Cincinnati Sub-Zero Products	製造國別	美國
醫器主類別	E心臟血管用裝置	醫器次類別	E5900熱調節系統
使用科別	急診，新生兒科加護病房，兒科加護病房。		
規格	型號950 Kool-Kit Neonat 嬰兒組。		
材質	Nonwoven Poly Fabric (不織布)。		
適應症	適用於週產期新生兒低溫療法。		
廠商建議價	25,000元/組		

23

特材基本資料(7)

特材名稱	“美翠”體溫調節系統-治療包覆墊 “MTRE” Thermo Regulation System-CureWraps		
許可證字號	衛部醫器輸字第027026號	發證日期	104/02/25
廠商名稱	嘉杏股份有限公司		
製造廠名稱	MTRE Advanced Technologies Ltd.	製造國別	以色列
醫器主類別	E心臟血管用裝置	醫器次類別	E5900熱調節系統
使用科別	心臟科，神經科，新生兒科，急診科。		
規格	Curewrap。		
材質	熱塑合成織物與聚乙烯薄膜。		
適應症	適用於心跳停止之低溫治療法，心跳停止患者，進行復甦急救後意識仍不清者或無遵循口頭醫囑；週產期新生兒低溫治療法：(1)出生週數 ≥ 36 週。(2)事件發生後6小時內實施。(3)出生後有「中等嚴重度」且「重度」腦病變之證據，且有下列任一項之情形：1.出生後一小時內嚴重酸血症。2.出生10分鐘時的Apgar分數 ≤ 5 分。3.出生後持續急救至少10分鐘。		
廠商建議價	40,000元/組		

24

特材基本資料(8)

特材名稱	“美翠”體溫調節系統-小孩包覆墊 “MTRE” Thermo Regulation System-Pediatric Thermo Wraps		
許可證字號	衛部醫器輸字第027026號	發證日期	104/02/25
廠商名稱	嘉杏股份有限公司		
製造廠名稱	MTRE Advanced Technologies Ltd.	製造國別	以色列
醫器主類別	E心臟血管用裝置	醫器次類別	E5900熱調節系統
使用科別	心臟科，神經科，新生兒科，急診科。		
規格	Pediatric Thermo Wraps。		
材質	熱塑合成織物與聚乙烯薄膜。		
適應症	適用於心跳停止之低溫治療法，心跳停止患者，進行復甦急救後意識仍不清者或無遵循口頭醫囑；週產期新生兒低溫治療法：(1)出生週數 ≥ 36 週。(2)事件發生後6小時內實施。(3)出生後有「中等嚴重度」且「重度」腦病變之證據，且有下列任一項之情形：1.出生後一小時內嚴重酸血症。2.出生10分鐘時的Apgar分數 ≤ 5 分。3.出生後持續急救至少10分鐘。		
廠商建議價	40,000元/組		

25

特材基本資料(9)

特材名稱	“美翠”體溫調節系統-嬰兒包覆墊 “MTRE” Thermo Regulation System-Infant Thermo Wraps		
許可證字號	衛部醫器輸字第027026號	發證日期	104/02/25
廠商名稱	嘉杏股份有限公司		
製造廠名稱	MTRE Advanced Technologies Ltd.	製造國別	以色列
醫器主類別	E心臟血管用裝置	醫器次類別	E5900熱調節系統
使用科別	心臟科，神經科，新生兒科，急診科。		
規格	Infant Thermo Wraps。		
材質	熱塑合成織物與聚乙烯薄膜。		
適應症	適用於心跳停止之低溫治療法，心跳停止患者，進行復甦急救後意識仍不清者或無遵循口頭醫囑；週產期新生兒低溫治療法：(1)出生週數 ≥ 36 週。(2)事件發生後6小時內實施。(3)出生後有「中等嚴重度」且「重度」腦病變之證據，且有下列任一項之情形：1.出生後一小時內嚴重酸血症。2.出生10分鐘時的Apgar分數 ≤ 5 分。3.出生後持續急救至少10分鐘。		
廠商建議價	40,000元/組		

26

106 年 11 月份特殊材料專家諮詢會議紀錄 (時間：106 年 11 月 23 日上午 9 時)

(七)案由：有關「元銘企業有限公司」、「鐸蛙企業有限公司」、「巴德股份有限公司」及「嘉杏股份有限公司」建議將用於心臟停止之低溫療法之特材「“卓邇”溫度調節系統及其附件」等共計 16 項納入健保給付再提會案。

說明：

1. 本案特材業經 106 年 7 月份及 9 月份本會議討論，結論略以：建議納入健保給付，屬創新功能特材，依功能類別分為 3 類(詳附件)：
 - (1)項次 1-9 為包覆式溫控傳遞墊，採廠商建議支付點數之最低價，以每組 25,000 點暫予支付。
 - (2)貼片式溫控傳遞墊，以體重 30 公斤區分為成人用(項次 10)及兒童用(項次 11)，採廠商建議支付點數，成人用以每組 50,000 點，孩童用以每組 30,000 點暫予支付。
 - (3)項次 12~16 為體內溫控導管及啟動組，因國際價格與廠商建議價格差距大，建議廠商提供成本分析資料後，再提會討論。
2. 另鐸蛙公司於 106 年 11 月 22 日以電子郵寄(106 年 11 月 23 日補來函)通知，針對項次 12、14 及 15「酷、快及速導管組」等 3 項，因不符心臟停止之低溫療法之給付規定及變更許可證等原因，建議刪除品項。

結論：

1. 項次 13「“卓邇”溫度調節系統及其附件－愛導管組」需搭配項次 16 啟動組件使用，其核價方式建議此 2 項均採公立醫院採購決標價格之中位數，愛導管組以每組

34,800 點，啟動組件以每組 22,000 點，除以收載(提案至藥物擬訂會議)時最近四季結算之醫院總額部門浮動點值之平均值暫予支付。

2. 本案特材之給付規定：依本保險醫療服務給付項目：「心跳停止之低溫療法」(編碼 47094B~47096B)及「週產期新生兒低溫療法」(編碼 47097B~47100B)所列之適應症。

106 年 9 月份特殊材料專家諮詢會議紀錄
(時間：106 年 9 月 14 日(星期四)上午 9 時)

(一)案由：有關「元銘企業有限公司」等 4 家公司建議將用於心臟停止之低溫療法之特材「“沙貝雷歐”布蘭克體溫調節機及其附件」等共計 16 項納入健保給付再提會案。

說明：本案特材前經提案於 106 年 7 月份本會議討論，結論為除「“卓邇”溫度調節系統及其附件-酷及愛導管組」等 2 項外，其餘 14 項建議納入健保給付。會後經通知廠商初核結果，廠商建議應將原決議不納入健保給付之前述 2 項納入給付、調高包覆式溫控傳遞墊及體內溫控導管等 2 項功能特材之支付點數，以及使用於成人與孩童之包覆式溫控傳遞墊及貼片式溫控傳遞墊應如何定義分類(如公斤)等，故再提會討論。

結論：

1. 為提供臨床多種使用選項，建議將原不同意給付之「“卓邇”溫度調節系統及其附件-酷及愛導管組」等 2 項，納入健保給付。
2. 核價方式如下：
 - (1) 包覆式溫控傳遞墊：維持原議以每組 25,000 點暫予支付。
 - (2) 貼片式溫控傳遞墊：成人用以每組 50,000 點，孩童用以每組 30,000 點暫予支付。
 - (3) 體內溫控導管：因國際價格與廠商建議價格差距大，建議廠商提供成本分析資料後，再提會討論。
3. 考量包覆式溫控傳遞墊及貼片式溫控傳遞墊等 2 類功能特材，是依公斤數之分布，分屬於不同的產品規格，建議以 30 公斤為分界，區分 2 種特材功能類別。

特殊材料 106 年 7 月份專家諮詢會議紀錄
(時間：106 年 7 月 27 日(星期四)上午 9 時)

(二)案由：有關「元銘企業有限公司」等 4 家公司建議將用於心臟停止之低溫療法之特材「“沙貝雷歐”布蘭克體溫調節機及其附件」等共計 16 項納入健保給付案。

結論：

1. 本案特材為配合健保自 104 年 12 月 1 日起給付心跳停止之低溫療法及週產期新生兒低溫療法（編號：47094B-47100B，支付點數：1,500~10,000 點）所使用之特材。適用於心臟停止之低溫療法，搭配體溫調節系統，以監測和控制患者中樞體溫，相較於傳統的冰毯，可精準且快速地達到降溫效果，以提高存活率及降低腦部缺氧，並可設定回溫之溫度及時間，以維持穩定的低溫狀態而達到治療效果，屬創新功能特材。建議功能類別分為：包覆式溫控傳遞墊、貼片式溫控傳遞墊及體內溫控導管等 3 項。
2. 另特材「“卓邇”溫度調節系統及其附件-酷/愛導管組」等 2 項，因臨床較少使用於心臟停止之低溫療法，故建議暫不納入健保給付。
3. 核價方式如下：
 1. 包覆式溫控傳遞墊：因查無國際價格，自費醫材比價網之筆數少於 5 筆，故依廠商建議支付點數之最低價，以每組 25,000 點暫予支付。
 2. 貼片式溫控傳遞墊：因查無國際價格而自費醫材比價網及公立醫院採購價皆高於廠商建議價，依廠商建議支付點數，成人用以每組 50,000 點，孩童用以每組 30,000 點暫予支付。
 3. 體內溫控導管：依國際價格之中位數，「啟動組件」每組以 8,586 點暫予支付；「快/速導管組」則依國際價格之中位數最低價，每組以 21,292 點暫予支付。